



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE
TË PROCEDURËS SË HAPUR

MALLRA

Viti 2018

MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

“Furnizim vendosje pajisje mjekësore dhe hotelerie për godinën e maternitetit të Spitalit Korçë dhe për kirurgjinë e re dhe patologjinë e spitalit Sarandë” fondi limit në total 133,324,394 (njëqind e tridhjetë e tre milion e treqind e njëzet e katër e mijë e katërqind e nëntëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH i ndarë në lote si më poshtë:

Lot 1: “Furnizim vendosje pajisje mobilimi spitalor” me fond limit 18,052,899 (tetëmbëdhjetë milion e pesëdhjetë e dy mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH;

Lot 2: “Furnizim vendosje pajisje salle operatore” me fond limit 57,683,710 (pesëdhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dhjetë) lekë pa TVSH;

Lot. 3: “Furnizim vendosje pajisje biomjekësore dhe pediatrike” me fond limit 57,587,785 (pesëdhjetë e shtatë milion e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

REF-62169-04-12-2018

2.4 Lloji i Marreveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: _____ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	
-----	--	--

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: Spitali Korçë dhe Spitali Sarandë

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

Public Health Sector

1. Fondi limit 133,324,394 (njëqind e tridhjetë e tre milion e treqind e njëzet e katër e mijë e katërqind e nëntëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH
2. Burimi i Financimit Buxheti i shtetit/investime
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Furnizim vendosje pajisje mjekësore dhe hotelerie për godinën e maternitetit të Spitalit Korçë dhe për për kirurgjinë e re dhe patologjinë e spitalit Sarandë” i ndarë në lote si më poshtë:

Lot 1: “Furnizim vendosje pajisje mobilimi spitalor” me fond limit 18,052,899 (tetëmbëdhjetë milion e pesëdhjetë e dy mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH;

Lot 2: “Furnizim vendosje pajisje salle operatore” me fond limit 57,683,710 (pesëdhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dhjetë) lekë pa TVSH;

Lot. 3: “Furnizim vendosje pajisje biomjekësore dhe pediatrike” me fond limit 57,587,785 (pesëdhjetë e shtatë milion e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë **45 dite**

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)
Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv)
Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:

Spitali Korçë dhe Spitali Sarandë

2.11 Ndarja në LOTE:



Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

Lot 1: “Furnizim vendosje pajisje mobilimi spitalor” me fond limit 18,052,899 (tetëmbëdhjetë milion e pesëdhjetë e dy mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH;

Lot 2: “Furnizim vendosje pajisje salle operatore” me fond limit 57,683,710 (pesëdhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dhjetë) lekë pa TVSH;

Lot. 3: “Furnizim vendosje pajisje biomjekësore dhe pediatrike” me fond limit 57,587,785 (pesëdhjetë e shtatë milion e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): **jo**

Ose: nga në

Dokumentat Standarde të Tenderit

Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 **Procedura**

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po Jo **x**

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **çmimi më i ulët** **x** për lot _____

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

Ose

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme**

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **07/05/2018/** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: _____

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **07/05/2018/** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: _____

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:



Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

	Po	Jo	x
Nëse Po			
	Monedha _____	Çmimi _____	

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **13/04/2018**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Adresa	Rruga e Kavajës, nr. 1001, Tiranë
Tel/Fax	+355 4 2376178
E-mail	_____
Faqja në Internet	www.shendetesia.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: e hapur me mjete elektronike-mallra

3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-62169-04-12-2018

Lot1 - REF-62175-04-12-2018

Lot2 - REF-62177-04-12-2018

Lot3 - REF-62181-04-12-2018

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Furnizim vendosje pajisje mjekësore dhe hotelerie për godinën e maternitetit të Spitalit Korçë dhe për për kirurgjinë e re dhe patologjinë e spitalit Sarandë” i ndarë në lote:

Lot 1: “Furnizim vendosje pajisje mobilimi spitalor” me fond limit 18,052,899 (tetëmbëdhjetë milion e pesëdhjetë e dy mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH;

Lot 2: “Furnizim vendosje pajisje salle operatore” me fond limit 57,683,710 (pesëdhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dhjetë) lekë pa TVSH;

Lot. 3: “Furnizim vendosje pajisje biomjekësore dhe pediatrike” me fond limit 57,587,785 (pesëdhjetë e shtatë milion e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

5. Fondi limit në total: 133,324,394 (njëqind e tridhjetë e tre milion e treqind e njëzet e katër e mijë e katërqind e nëntëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Brenda 45 diteve nga data e lidhjes së kontrates.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Date 07.05.2018,

Ora: 10:00

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Date 07.05.2018, Ora: 10:00

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
- 1.5 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
 - a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
 - b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
_____,
_____,
_____.
 - c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.
 - ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.
- 1.6 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.

- 1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit _
**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv
_____ orës _____”**

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: “**MODIFIKIM OFERTE**” ose “**TËRHEQJE OFERTE**”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasinë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të

afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.

2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare
- b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëminë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe

karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

P_o - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$ - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{min k1} \times P_{max k1} / O_{k1}$$

P_{k1} _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{min k1}$	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
$P_{max k1}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k1}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e

njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korigjohet. Shumat e korigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta
M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
n – Numri i Ofertave të vlefshme
Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_o$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet <ZM..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
i. garanci bankare
ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një

njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Deklaratë mbi përbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaratë mbi përbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 9: Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit

Shtojca 10: Specifikimet teknike

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anullimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE per LOT 1

Emri i Ofertuesit _____


Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

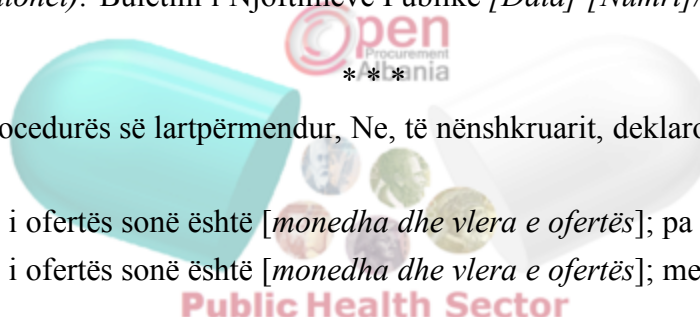

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Njesia	Çmim i Njësi	Çmimi Total	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
1	Barrele Spitalore	3	cope					
2	Dollap pacienti	50	cope					
3	Komodine Pacienti	80	cope					
4	Krevat Neonatal per femije te porsalindur	10	cope					
5	Shtrat Pacienti	80	cope					
6	Shtrat reanimacioni	7	cope					
7	Shtrat Vizitash mjekesore	8	cope					
8	Shtrat Ekzaminimi Gjinekologjik	3	cope					
9	Shtrat Lindje Elektrik	3	cope					
Çmimi Neto)								
TVSH (%)								
Çmimi Total								

Dokumentat Standarde të Tenderit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE per LOT 2

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Njesia	Çmim i Njësi	Çmimi Total	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
1	Aspirator kirurgjikal	6	cope					
2	Defibrilator	2	cope					
3	Elektrobisturi	5	cope					
4	Gjenerator Kirurgjikal	1	cope					
5	Karrel Instrumentash kirurgjikale	6	cope					
6	Komplet proktologjie	1	cope					
7	Llambe Baktericidi	6	cope					
8	Llampe Ekzaminimi	6	cope					
9	Llampe Mobile	8	cope					
10	Llampe Operatore	5	cope					
11	Makine Anestezie (Set)	5	set					
12	Mikroskop operator	1	cope					

Dokumentat Standarde të Tenderit

	okulistik							
13	Sistem trapanacioni	1	cope					
14	Tavoline Mayo	3	cope					
15	Tavoline Operatore- Kirurgji e perhershme	2	cope					
16	Tavoline Operatore- Ortopedike	1	cope					
17	Tavoline Operatore- Obstetrike-Gjinekologjike	2	cope					
18	C ARM	1	cope					
Çmimi Neto)								
TVSH (%)								
Çmimi Total								

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (kërkuar në dokumentat e tenderit)



Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE per LOT 3

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës] _____

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Njesia	Çmim i Njësi	Çmimi Total	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
1	Aparat Kolposkopie	2	cope					
2	Aspirator per neonate	3	cope					
3	Sistem Histeroskopie	1	cope					
4	Peshore Dixhitale per bebe	2	cope					
5	Puls oksimeter per femije	5	cope					
6	Puls oksimeter per adult	10	cope					
7	Inkubator per neonate me servo kontroll	1	cope					
8	Kardiotohograf	3	cope					
9	FRH per rrahjet e zemres	3	cope					
10	Eko obstetrike gjinekologjike	1	cope					
11	Eko Portabel	1	cope					

Dokumentat Standarde të Tenderit

12	Panel gazrash mjekesore dopjo (per kokat krevateve)	13	cope				
13	Panel gazrash mjekesore teke (per kokat krevateve)	12	cope				
14	Ngrohës Intravenoz	6	cope				
15	Panel per Reanimacionin Adult	7	cope				
16	Shiringe elektrike	9	cope				
17	Ambu per neonate	5	cope				
18	Aparature CPAP per neonate me lageshtues	1	cope				
19	Dyshek Fototerapie	1	cope				
20	Fluksometer dhe perzieres gazrash Neonatal	3	cope				
21	Laringoskop Adult	3	cope				
22	Laringoskop Pediatrik	2	cope				
23	Llambe Ngrohese per neonate (Radiant)	2	cope				
24	Llambe Ngrohese per neonate (Radiant) me njesi reanimimi	1	cope				
25	Mates transkutan per bilirubinen	1	cope				
26	Monitor Pacienti Neonatal	3	cope				
27	Pajisje Fototerapie	2	cope				
28	Modul Sedatimi	2	cope				
29	Monitor Pacienti	7	cope				
30	Monitor Pacienti me kapnografi	2	cope				
31	Sistem mjekesor me krah per salla	5	cope				
32	Sistem mjekesor mural per salla	5	cope				
33	Pompe infuzioni	6	cope				
34	Ventilator Pacienti	6	cope				
35	Panel per Reanimacionin Neonatal	3	cope				
36	Nebulizator	4	cope				
Çmimi Neto)							
TVSH (%)							
Çmimi Total							

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] _____

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës] _____

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti] _____

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] _____

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

Public Health Sector

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrimit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 3

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet _____

[Jep adresën e saktë]

Përpara

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

Shtojca 4.

[*Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve*]

[*Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor*]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[*Data*]

Për: [*Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor*]

Në emër të: [*Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar*]

Procedura e prokurimit [*lloji i procedurës*]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [*objekti*]

Publikimi (*nëse zbatohet*): Buletini i Njoftimeve Publike [*Data*] [*Numri*]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [*emri i ofertuesit të siguruar*] ka derdhur një depozitë pranë [*emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit*] me një vlerë prej [*monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra*] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [*emri i autoritetit kontraktor*] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se: **Public Health Sector**

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejta ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësisë të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejta ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e

Dokumentat Standarde të Tenderit

qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:


Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula _____

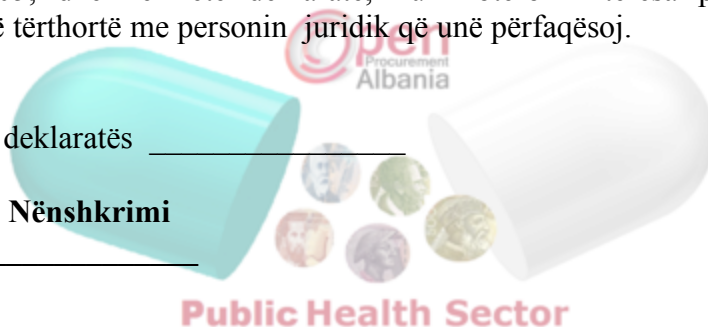

Shtojca 8

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale,
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv),
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatorit ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

- ✓ **Lot 1: “Furnizim vendosje pajisje mobilimi spitalor” me fond limit 18,052,899 (tetëmbëdhjetë milion e pesëdhjetë e dy mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH;**

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;JO
- b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- ç. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. (të jetë përfshirë muaji Mars 2018)

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

- sipas Kritereve të Përgjithshme të Kualifikimit

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Vërtetim nga Dega e tatim taksave për xhiron vjetore të realizuar në secilin nga tre vitet e fundit (2015-2016-2017).

Vlera e kërkuar: Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve, duhet të jetë sa 40 % e vlerës së fondit limit të këtij loti.

2.3. Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

2.3.1 Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë sa 40% e fondit limit të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku

të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe)

2.3.4 Ofertuesi duhet të ketë në stafin e tij jo më pak se 2(dy) inxhinierë të trajnuar për servis pasisjesh mjekësore.

Per kete duhet te paraqese:

- Diplomat perkatese dhe
- Listepagesat sipas formatit te miratuar ESIG025 per periudhen Dhjetor 2017-Shkurt 2018, ku duhet te figurojne emrat e tyre.

2.3.5 Deklarate per permbushjen e afatit te garancise. (1 vit garanci, perfshirë blerjen dhe zevendesimin e pjesëve të difektuara me pjesë këmbimi të reja dhe origjinale).

2.3.6 Vetëdeklaratë:

- që pajisjet e ofruara janë të reja, të një prodhimi original dhe të deklarohet viti i prodhimit,
- për përmbushjen e afatit të garancisë sipas përcaktimeve në specifikimet teknike të DST (një vit garanci përfshirë blerjen dhe zëvendësimin e pjesëve të difektuara me pjesë këmbimi të reja dhe origjinale) dhe
- që merr përsipër trajnimin e dy personave (mjekë dhe teknikë) për çdo pajisje.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të paraqese autorizim (të vlefshëm për vitin 2018) nga kompania prodhuese për tregëtimin e artikujve të ofruar apo nga distributori i autorizuar nga prodhuesi ku në çdo rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin.

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim për tregëtim të pajisjeve mjekësore, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, sipas ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

2.3.9 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001 ose ISO 13485, të vlefshme, për prodhuesit e artikujve të ofruar, të përkthyer dhe të noterizuar.

2.3.10 Ofertuesi duhet të jete i certifikuar me ISO 9001 për import, tregëtim, instalim dhe mirëmbajtje të pajisjeve mjekësore. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse brenda afatit të vlefshmërisë, të përkthyer dhe të noterizuar.

2.3.11 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata CE 93/42 MDD (ose sipas kategorizimit të tyre) të vlefshme, për të gjithë artikujt e ofruar, të përkthyer dhe të noterizuara.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

- ✓ Lot 2: “Furnizim vendosje pajisje salle operatore” me fond limit 57,683,710

(pesëdhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dhjetë) lekë pa TVSH;

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;JO

b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;

c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;

ç. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);

d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. (të jetë përfshirë muaji Mars 2018)

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

- sipas Kriteve të Përgjithshme të Kualifikimit

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Vërtetim nga Dega e tatim taksave për xhiron vjetore të realizuar në secilin nga tre vitet e fundit (2015-2016-2017).

Vlera e kërkuar: Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve, duhet të jetë sa 40 % e vlerës së fondit limit të këtij loti.

Public Health Sector

2.3. Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

2.3.1 Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë sa 40% e fondit limit të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të**

ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe)

2.3.4 Ofertuesi duhet te kete ne stafin e tij jo me pak se 3 (tre) inxhiniere te trajnuar per servis pasisjesh mjekesore.

Per kete duhet te paraqese:

Diplomat perkatese dhe

- Certifikata/ose deshmi trajnimi te tyre per pajisjet me poshte:

Elektrobisturi
Makina Anestezie
(CArm)
Defibrilatore

- Listepagesat sipas formatit te miratuar ESIG025 per periudhen Dhjetor 2017-Shkurt 2018, ku duhet te figurojne emrat e tyre.

2.3.5 Deklarate per permbushjen e afatit te garancise. (1 vit garanci, perfshirë blerjen dhe zevendesimin e pjesëve te difektuara me pjesë kembimi te reja dhe origjinale).

2.3.6 Vetëdeklaratë:

- që pajisjet e ofruara janë të reja, të një prodhimi original dhe të deklarohet viti i prodhimit,
- për përmbushjen e afatit të garancisë sipas përcaktimeve në specifikimet teknike të DST (një vit garanci përfshirë blerjen dhe zëvendësimin e pjesëve të difektuara me pjesë këmbimi të reja dhe origjinale) dhe
- që merr përsipër trajnimin e dy personave (mjekë dhe teknikë) për cdo pajisje.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të paraqese autorizim (të vlefshëm për vitin 2018) nga kompania prodhuese për tregëtimin e artikujve të ofruar apo nga distributori i autorizuar nga prodhuesi ku ne cdo rast te dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin.

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim për tregëtim të pajisjeve mjekësore, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, sipas ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

2.3.9 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001 ose ISO 13485, të vlefshme, për prodhuesit e artikujve të ofruar, të përkthyer dhe të noterizuar.

2.3.10 Ofertuesi duhet te jete i certifikuar me ISO 9001 për import, tregëtim, instalim dhe mirëmbajtje të pajisjeve mjekësore. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse brenda afatit të vlefshmërisë, të përkthyer dhe të noterizuar.

2.3.11 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata CE 93/42 MDD (ose sipas kategorizimit te tyre) të vlefshme, për të gjithë artikujt e ofruar, të përkthyer dhe të noterizuara.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

- ✓ **Lot. 3: “Furnizim vendosje pajisje biomjekësore dhe pediatrike” me fond limit 57,587,785 (pesëdhjetë e shtatë milion e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.**

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;JO
- b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- ç. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. (të jetë përfshirë muaji Mars 2018)

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

- sipas Kriteve të Përgjithshme të Kualifikimit

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Vërtetim nga Dega e tatim taksave për xhiron vjetore të realizuar në secilin nga tre vitet e fundit (2015-2016-2017).

Vlera e kërkuar: Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve, duhet të jetë sa 40 % e vlerës së fondit limit të këtij loti.

2.3. Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

2.3.1 Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë sa 40% e fondit limit të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat

tatimore te shitjes ku te shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe)

2.3.4 Ofertuesi duhet të ketë në stafin e tij jo më pak se 3 (tre) inxhinierë të trajnuar për servis pasisjesh mjekësore.

Per kete duhet te paraqese:

Diplomat perkatese dhe

- Certifikata/ose deshmi trajnimi te tyre per pajisjet me poshte:

Eko
Ventilatore
Monitor Pacienti

- Listepagesat sipas formatit të miratuar ESIG025 për periudhën Dhjetor 2017-Shkurt 2018, ku duhet të figurojnë emrat e tyre.

2.3.5 Deklarate për përmbushjen e afatit të garancisë. (1 vit garanci, përfshirë blerjen dhe zëvendësimin e pjesëve të difektuara me pjesë këmbimi të reja dhe origjinale).

2.3.6 Vetëdeklarata:

- që pajisjet e ofruara janë të reja, të një prodhimi original dhe të deklarohet viti i prodhimit,
- për përmbushjen e afatit të garancisë sipas përcaktimeve në specifikimet teknike të DST (një vit garanci përfshirë blerjen dhe zëvendësimin e pjesëve të difektuara me pjesë këmbimi të reja dhe origjinale) dhe
- që merr përsipër trajnimin e dy personave (mjekë dhe teknikë) për cdo pajisje.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim (të vlefshëm për vitin 2018) nga kompania prodhuese për tregëtimin e artikujve të ofruar apo nga distributori i autorizuar nga prodhuesi ku në cdo rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin.

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim për tregëtim të pajisjeve mjekësore, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, sipas ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

2.3.9 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001 ose ISO 13485, të vlefshme, për prodhuesit e artikujve të ofruar, të përkthyer dhe të noterizuar.

2.3.10 Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar me ISO 9001 për import, tregëtim, instalim dhe

mirëmbajtje të pajisjeve mjekësore. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse brenda afatit të vlefshmërisë, të përkthyer dhe të noterizuar.

2.3.11 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata CE 93/42 MDD (ose sipas kategorizimit të tyre) të vlefshme, për të gjithë artikujt e ofruar, të përkthyer dhe të noterizuar.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

○ **PJESMARRJA NË MË SHUMË SE NJË LOT:**

- Nëse një operator ekonomik konkurren në më shumë se 1 lot të kësaj procedure prokurimi atëherë ai duhet të zotërojë kapacitetet teknike, ekonomike financiare dhe kualifikimin profesional për të realizuar objektin e procedurës së prokurimit, pra të gjitha lotetë së bashku. Në këtë kuptim edhe kriteret e veçanta për kualifikim (si psh. kontratat e ngjashme, xhiro., etj) duhet të plotësohen nga operatori ekonomik në varësi të lotetë që ai konkurren me përjashtim të kriterit sipas pikës 2.3.4 “Ofertuesi duhet të ketë në stafin e tij jo më pak se 3 (tre) inxhinierë të trajnuar për servis pasishesh mjekësorë”, që do të thotë se OE pjesëmarrës duhet të kenë minimalisht 3 (tre) inxhinierë pavarësisht se në sa lote do të konkurrojnë ose 2 (dy) inxhinierë nëse do të konkurrojnë vetëm të Loti i I.

○ **CERTIFIKATAT E CILËSISË**

- Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë.

○ **FONDET LIMIT PËR SEJCILIN AK**

- Ofertuesit në hartimin e ofertave duhet të marrin në konsideratë fondin limit për sejcilin AK sipas lotetë (i cili jepet në shtojcën 12 të DST). Në rast tejkalimi të këtij fondi oferta do të refuzohet.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

Dokumentat Standarde të Tenderit

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Specifikime teknike LOT 1

Nr.	Pajisja	Specifikimet
1	Barrele spitalore	<p>E pershtatshme per transport interspitalor, me rrota dhe mbajtese anesore ne te gjithe gjaatesine.</p> <p>Platforme dysheku me dy segmente. Segmenti i siperm i rregullueshem ne menyre pneumatike.</p> <p>Permasat rreth 210x70cm. Dysheku me material lehtesisht te pastrueshem</p> <p>Levizja shpinore 0-45 grade. Levizje tredelenburg te pakten 10 grade</p> <p>E pajisur me nje mbeshtetes teleskopik per fluide intra-venoze dhe me aksesore per montimin e qeseve te drenimit. Peshembajtja: deri ne 180Kg ± 10%</p>
2	Dollap pacienti	<p>Struktura te jete materjal druri</p> <p>Me 2 ndarje te pavarura</p> <p>Me dy dver</p>
3	Komodine Pacienti	<p>Komodina te kete sirtar, dere, tavoline qe zgjatet mbi krevat</p> <p>Struktura te jete materjal druri</p> <p>Pjesa e sipërme te jete material MDF</p> <p>Sirtar i rreshqitshem.</p> <p>Tavoline te rotullueshme, e zgjatshme me lartesi te rregullueshme ne lartesine afersisht 85/105 cm.</p> <p>Me kater rrota 2 prej te cilave me frena.</p>
4	Krevat Neonatal per femije te porsalindur	<p>Me skelet metalik, me rrota</p> <p>Krevati te jete material plastik transparent</p> <p>Te jene i pajisur me dyshek te holle per bebe</p>
5	Shtrat Pacienti	<p>Shtrat pacienti spitalor, me kater seksione me platforme ABS</p> <p>Me lartesi te rregullueshme afersisht 50-75 cm.</p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Pjesa e shpines dhe pjesa e kembeve te rregullueshme.</p> <p>Kendi I levizjes se pjeses se kokes te pakten nga 0 deri 65 grade</p> <p>Kendi I levizjes se pjeses se kembeve nga 0 deri min 25 grade</p> <p>Levizje Trendelenburg/Reverse Trendelenburg afersisht 10 grade</p> <p>Platforma e dyshekut: gjeresia min 80cm, gjatesia min. 190cm</p> <p>Te perfshihet dyshek me dimensione ne perputhje me platformen e mesiperme</p> <p>Te perfshihet nje mbajtës vertikal per medikamente</p> <p>Panele fundore te zmontueshem nga ana e kokes dhe kembeve</p> <p>Me kater rrota diam. min 125mm, te rrotullueshme, dy prej te cilave me frena</p> <p>Pesha mbajtese: 200 kg ± 10%</p>
6	Shtrat reanimacioni	
		<p>Rregullim elektronik i shpines, kembeve, lartesisë</p> <p>Rregullim elektronik i levizjeve Trendelenburg dhe Reverse Trendelenburg</p> <p>Panelet e kontrollit te pacientit dhe infermieres</p> <p>Sistem i kycjes se funksioneve</p> <p>Pozicioni i largimit te pacientit me buton tek</p> <p>Pozicioni i ekzaminimit me buton tek</p> <p>Pozicioni Reverse Trendelenburg me buton tek</p> <p>Panele plastike per pjesen e kokes dhe kembeve</p> <p>4 ndarje, platforme e levizshme ABS per dyshekun me permasa te pakten 195x90cm</p> <p>Dysheku anti-decubitis me mbulesë antibakteriale lehtesisht te pastrueshme.</p> <p>Me 4 mbajtese anesore me tregues Kendi.</p> <p>Struktura metalike e lyer me pluhur elektrostatik</p> <p>Pjesa e kembeve e rregullueshm ne menyre graduale</p> <p>Xhepa per vendosjen e tubit te serumeve ne 4 kendet e krevatit</p> <p>Lartesi e rregullueshme aftersisht 50 -75 cm</p> <p>Mbrojtese plastike kunder goditjeve</p> <p>Rrota 150mm me frena.</p> <p>Kendi I shpinores minimumi 0°-60°</p> <p>Kendi I pjeses se kembeve minimumi 0°-40°</p> <p>Kendi Trendelenburg minimumi 0°-12°</p> <p>Kendi Rev.Trend. minimumi 0°-12°</p> <p>E pajisur me bateri te integruar te karikueshme ne rast nderprerje te energjise.</p> <p>E pajisur me nje stativ per serumet.</p> <p>Pesha mbajtese e pacientit minimalisht 200Kg</p>
7	Shtrat Vizitash mjekesore	
		<p>Dimensione te peraferta 180cm x 60 cm. Lartesia 75-80cm.</p> <p>Siperfaqja e perbere nga nje segment fiks dhe nje segment me kend te rregullueshem.</p> <p>Pesha mbajtese deri ne 100Kg</p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

8	Shtrat Ekzaminimi Gjinekologjik	
		Shtrat Ekzaminimi gjinekologjik me 3 ndarje
		Mbeshletesja e kokes dhe kembeve te jete e rregullueshme
		Permasat afersisht 60x180x80cm
		Mbuluar me lekure sintetike ne pjesen e jashtme, lehtesisht e pastrueshme dhe qe duron nxehtesine
		Strukture metalike e kromuar ne te kater kembet
		Me mbajtese kembesh dhe bacinele
9	Shtrat Lindje Elektrik	
		Shtrat lindje dhe procedura obstetrikale
		E ndare ne tre seksione: shpina, ndenjjesja dhe kembet
		Me tre motore per rregullim elektronik te lartesisht, shpines dhe pozicioneve Trendenburg/Reverse Trendenburg.
		Komandim nga nje panel kontrolli dhe/ose telekomande.
		Pjesa e kembeve e zmontueshme lehtesisht.
		Trendenburg / Reverse Trendenburg
		Dyshek me tre seksione, me materiale antimikrobiale, rezistente ndaj ujit, te padjegeshme, te respirueshem, dhe lehtesisht te pastrueshem
		Bazamenti / platforma e dyshekut prej materiali ABS.
		Shina anesore (te zmontueshme) prej celiku inox ne seksionin e ndenjjeses, destinuar per montim aksesoresh.
		Pjesa e shtrirje (dysheku) i mbushur me shkume-gome per te ndjekur formen anatomike te trupit.
		Amortizatore goditjesh gjate levizjeve.
		Lartesia e shtratit e rregullueshme ne diapazonin 70 deri 85 cm
		Siperfaqja e krevatit; gjatesia min 185 cm, gjeresia min 80 cm.
		Seksioni i shpines i rregullueshem nga 0 ne 70 deg.
		Ttrendenburg/Reverse Trendenburg i rregullueshem deri ne rreth +/- 13 deg.
		Pesha mbajtese: 200 kg ± 10%
		Aksesore:
		- Mbajtese kembesh (1 cift), me veshje materiali te gomuar, me lidhese per fiksime kembesh,
		me konstruksion me cerniere sferike per pozicionim kendor te rregullueshem,
		dhe lartesi te rregullueshme
		- Mbajtese anesore te pacientit (1 cift);
		- Bacinele inoksi me fiksuesin perkates (1 cope);

Specifikime teknike LOT 2

Nr.	Pajisja	Specifikimet
1	Aspirator kirurgjikal	
		Pompe vakumi me kapacitet afersisht 670 mm/Hg
		Kapaciteti i thithjes mbi 60 L/min

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Rezervuari: 2 ene me volum min 4 Litra te autoklavueshme, te mbrojtura nga mbi mbushja dhe me kapak</p> <p>Vakumi te jete i kontrolluar dhe nga pedali</p> <p>Aksesore:</p> <p>Tuba silikoni me gjatesi 2m</p> <p>Filter anti bakterial</p> <p>Aparatura i permbahet standarteve nderkombetare EN 10079-1</p>
2	Defibrilator	<p>Defibrilator Bi-Fazik me Pacer per arrestet kardiake akute dhe kronike</p> <p>Me karikues dhe bateri.</p> <p>Diapazoni i energjise: min 2- 360 J</p> <p>Koha e karikimit. 6 sec per fuqi 200J</p> <p>Monitor LCD me ngjyra; madhesia min 8".</p> <p>Mundesi Monitorim te formave valore: ECG 3/5 lead, SpO2, NIBP, IBP, etj.</p> <p>Mundesi e regjistrimit te valeve EKG .</p> <p>Menyrat e punes: Manuale, Pacer, AED dhe Monitorim.</p> <p>Te kete te instaluara funksionet per SpO2, NiBP, Temperature dhe mundesi shtimi per CO2 dhe IBP.</p> <p>Mundesi monitorimi te EKG nepermjet elektrodave te EKG ose te dorezave te shkarkimit.</p> <p>Tregues digjital ne ekran te gjendjes te baterise.</p> <p>Kapaciteti i baterise min 200 goditje dhe monitorim ECG</p> <p>Koha e karikimit te baterise 5 ore.</p> <p>Pajisur me printer termal</p> <p>Me karte memorie per mundesi rregjistrimi.</p> <p>Doreze te inkorporuar.</p> <p>Aksesoret: 1x kabell ECG me 3 lead, 1x Set pllakash te riperdorshme adulte dhe pediatrike, 1x Set pllakash nje-perdorimeshe adulte dhe pediatrike, 10x Elektroda ECG njeperdorimshe, 1x kabell dhe Sensor SpO2 Adult, 1x Konektor dhe manshete NIBP Adult dhe pediatrik, 1x Sensor temperature Adult, 2x rulona leter termike per printer, 1x shishe xhel.</p>
3	Elektrobisturi	<p>Elektrobisturi me dy dalje monopolare dhe nje dalje bipolare.</p> <p>Diapazoni i fuqise: te pakten 1-280W</p> <p>Te kryeje procedura te rezektoskopise bipolare ne solucion saline.</p> <p>Mundesi memorizimi te pakten 10 programe</p> <p>Mundesi kontrolli me celes kembe dhe me elektroda dore.</p> <p>LED-bar per kontroll vizual te cilesise te kontaktit.</p> <p>Alarme vizive te ndara me ngjyra dhe akustik ne perputhje me normen IEC 60601-2-2</p> <p>Pajisja ka funksion me forme vale te pa moduluara (Puse cutting mode) dhe funksione me forme vale te perzjera (Blend cutting mode)</p> <p>Te kete mundesi per te funksionuar edhe me gaz Argoni</p> <p>Aksesoret: 1x celes pedal-kembe, 1x Pllake tokzimi neutrale gome,shumepedorimshe. 1x Elektrode thike monopolare, 1x elektrode lancet e drejte (Needle Shaft electrode). 1x Pince diatermie. 1x Elektrode me tel te harkuar (Loop electrode).</p>
4	Gjenerator Kirurgjikal	


Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Per perdorim ne salla operatore per shmangien e gjakrrjedhjes ne procedurat kirurgjikale.</p> <p>E pershtatshme per tu perdorur me instrumente te ndryshme per prerje bipolare ne solucion fiziologjik, histerektomi, rezektim dhe ngjitje te eneve te gjakut ne kirurgji te hapur dhe laparoscopi</p> <p>Sinjalizues akustik dhe/ose vizual te aktivizimit, mbylljes se ciklit apo keqfunksionimit.</p> <p>Sinjale akustike/vizuale per tregimin e mesazheve dhe alarmeve.</p> <p>Instrumentet hemostatike duhet te ngjisin duke aplikuar energji dhe te presin me thike te ftohte.</p> <p>Ngjitja dhe prerja te jene te pavarura nga njera tjetra apo te kombinuara.</p> <p>Per ngjitjen e eneve te gjakut deri ne 7mm</p> <p>Ngjitja e eneve te gjakut te jete e vazhdueshme me vale sinusoidale me frekuence reth 300-500kHz</p> <p>Fuqia e gjeneruar, te pakten 260W</p> <p>Rregullim automatik i formeveales</p> <p>Me matje te rezistences indore.</p> <p>Me modulim te tensionit dhe rrymes sipas ndryshimit te rezistences ne ngjitje.</p> <p>Ushqimi: Linje AC: 220V; 50Hz</p> <p>Aparatura i permbahet standarteve nderkombetare IEC 60601-1 and IEC 60601-2-2</p> <p>I furnizuar me aksesoret e meposhtem:</p> <p>Pincat/instrumentet hemostatike shume-perdorimesh - 2 cope (nje cope per laparoscopi dhe nje cope per kirurgji te hapur)</p> <p>Thike prerese njepedorimeshe (ose elektroda njepedorimeshe me thike prerese), per tu integruar me pincat/instrumentat e mesiperme, 10 cope per cdo pince/instrument (gjithesej 20 cope per pajisje).</p> <p>Pedal komandimi - 1 cope</p> <p>Kabell ushqimi - 1 cope</p>
5	Karrel Instrumentash kirurgjikale	<p>Karrel me dy rafta montuar ne kontruksion te levizshem me rrota</p> <p>Materiali teresisht celik inoksidabel</p> <p>Permasat e siperfaqes jo me pak se 70cm x 50cm</p> <p>Lartesi fikse aferisht 80cm</p> <p>Pajisur me kater rrota te gomuar me diameter min 80mm</p>
6	Komplet proktologjie	<p>Set proktologjie dhe rektoskopie</p> <p><i>i perbere nga:</i></p> <p>Ndricues LED me jetegjatesi te madhe, me fuqi te pakten 150W, me ndricim te rregullueshem.</p> <p>Kabel me fibra optike, gjatesia 180 cm , diametri 3.5mm</p> <p>Anoskop, diametri 15 mm gjatesia 7-8 cm</p> <p>Anoskop, diametri 20 mm gjatesia 7-8 cm</p> <p>Anoskop, diametri 25 mm gjatesia 7-8 cm</p> <p>Tub rektoskopie, diameter 16 mm, me gjatesi pune 30 - 35 cm, me obturator</p> <p>Tub rektoskopie, diameter 20 mm, me gjatesi pune 30 - 35 cm, me obturator</p> <p>Te pajisur me adaptor per ciftimin me kabllin e drites</p> <p>Puar gome per insuflim, me tub lidhes per rektoskopin</p> <p>Pince per kapje/terheqje, me gjatesi te 30 - 35 cm</p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Tub thithjeje metalik, me gjatesi 35 - 45 cm me kontroll manual</p> <p>Pince biopsie rotulluese, me nofulla kapese, me gjatesi pune 35 - 40 cm</p>
7	Llambe Baktericidi	
		<p>Pajisje baktericide me llampa ultraviolet dhe ventilator per purifikim-sterilizim ajri nga bakteriet dhe sporet ne ambiente spitalore</p> <p>E destinuar per instalim mural.</p> <p>Llampa UV me gjatesi vale 253-254 nm te vendosura ne dhome rrezatimi te mbyllur per mbrojtjen e personelit/pacienteve nga rrezatimi UV.</p> <p>Dhoma e sterilizimit UV e izoluar me siperfaqe reflektuese per mosekspozimin e jashtem te rrezatimit UV.</p> <p>Energjia e rrezatimit UV mbi 65 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$</p> <p>Efektiviteti i sterilizimit jo me pak se 90% per bakteriet.</p> <p>Kapaciteti sterilizues i ajrit mbi 100 m³/ore</p> <p>Niveli i zhurmes se pajisjes me pak se 35 dB</p> <p>Ushqimi 220V / 50Hz</p>
8	Llampe Ekzaminimi	
		<p>Llampe ekzaminimi LED</p> <p>Tub fleksibel mbi baze te levizshme me pese rrota</p> <p>Lartesi e rregullueshme 70-160cm</p> <p>Fuqi jo me shume se 10 W</p> <p>Diametri i fushes se drites ne 60cm</p> <p>Temperatura e ngjyres min. 4200 K</p> <p>Intensiteti ne 1m min 12000 Lux</p> <p>Mbulesa e kokes se llampes me xham te temperuar</p> <p>Jetegjatesia e LED-it jo me pak se rreth 50,000 ore</p>
9	Llampe Mobile	
		<p>Llampe per procedura ekzaminimi mjekesor dhe kirurgji minore.</p> <p>Llampe ekzaminimi LED .</p> <p>Tub fleksibel mbi baze te levizshme me 5 rrota</p> <p>Lartesi e rregullueshme 70 - 160cm</p> <p>Llampe me hijezim te reduktuar</p> <p>Diametri i fushes se drites ne 50 cm largesi min 14 cm</p> <p>Temperatura e ngjyres rreth 4500 K</p> <p>Intensiteti ne 0.5 m mbi 85000 lux</p> <p>Mbulesa e kokes se llampes me xham te temperuar</p> <p>Jetegjatesia e LED-it jo me pak se 50,000 ore</p> <p>Diametri I satelitit jo me pak se 190 mm</p> <p>Me rregullator Intesiteti</p> <p>Me rregullator te temperatures se ngjyrave</p> <p>Me doreze te sterilizueshme</p>
10	Llampe Operatore	
		<p>Llampe ndricimi kirurgjikale me baze per fiksime ne tavan dhe dy krahe te rotullueshem te pakten 320°</p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>E pajisur me dy koka (qendrore dhe satelit) e perbere nga Llamba LED</p> <p>Kontroll iluminimi elektronik</p> <p>Iluminimi ne 1 m per secilen koke: te pakten 130,000 lux</p> <p>Diametri i fushes i rregullueshem elektronikisht ne afersisht 20 deri ne 30 cm</p> <p>Ngjyra temperatures (K): rreth 4,300, e ndryshueshme</p> <p>indeksi i ngjyrave (Ra) te pakten 94</p> <p>Energjia rrezes (mW/m2.lx): 3 ± 1</p> <p>Nuk ka zevendesim llampe</p> <p>Jetegjatesia e LED te pakten 40,000 ore</p> <p>Disa ore operimi me batteri</p> <p>Me doreze te sterilizueshme per rrotullimin, ndryshimin e lartesisë dhe kendit te llampes</p> <p>Rrotullim horizontal</p> <p>Artikulacion (nyje,lidhje) vertikale</p> <p>Rrotullim vertikal</p> <p>Fiksuesi i llampes ne tavan dhe mbulesa te jene te perfshira ne cmim</p> <p>E pajisur me bateri per autonomi te pakten 2 ore dhe karikues automatik</p> <p>Te punoje me 220 V, 50Hz</p>
11	Makine Anestezie (Set)	<p style="text-align: center;"></p> <p>Sistem i perbere nga 1) makine anestezie, 2) monitor pacienti</p> <p>1) Makina e Anestezise</p> <p>Makine anestezie e pershtatshme per ventilim NEONATAL, PEDIATRIK dhe ADULT. Funksionim automatik me qark te mbyllur. E pershtatshme per funksionim me fluks te ulet.</p> <p>E pajisur me dalje shtese per mundesi ventilimi me qark te hapur.</p> <p>E pajisur me sistem thithje te CO2 ne qarkun e ventilimit. Mundesi zevendesimi te rezervuarit CO2 pa ndaluar ventilimin.</p> <p>Sistem me 3 gaze mjekesore: O2, N2O dhe Ajer. Presioni i gazeve ne hyrje te pajisjes: 3-6 atm.</p> <p>Me fluksimeter te dyfishte per cdo gaz mjekesor (ose fluksimeter elektronik) me mundesi rregullimi ne intervalet: 0-15.0 L/min per Oksigjen dhe Ajer dhe 0-10L/min per N2O.</p> <p>Me sistem sigurie per te garantuar perzjerje O2/N2O me min. 23% O2.</p> <p>Me 2 pozicione per vaporizatore. Te furnizohet me 1 vaporizator Isoflurane.</p> <p>Me dalje te drejtperdrejte 100% O2 me fluksimeter te rregullueshem nga 0 deri ne te pakten 10 L/min</p> <p>(konektor per kanjule nazale)</p> <p><u>Ventilatori dhe Ekрани:</u></p> <p>Ekran LCD me ngjyra dhe me prekje (touchscreen). Dimensioni minimal: 15".</p> <p>Shfaqje simultane grafike ne ekran te formave te vales: Kurba Presion-Kohe. Kurba Fluks-Kohe.</p> <p>Shfaqje grafike e nje prej kurbave te spirometrise: Presion-Volum, Presion-Fluks, Fluks-Volum.</p> <p>Shfaqje numerike e parametrave te ventilimit: Volum Tidal, Frekuenca e Respirimit, raporti I:E, Presion Inspirimi, Presioni Maksimal, PEEP, Volumi/minute, Volumi i Ekspirimit, %O2 gjate inspirimit.</p> <p><u>Modalitetet e Ventilimit:</u></p> <p>VCV, PCV, PS+APNEA, SIMV-VC, SIMV-PC</p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

Ventilim Manual me valvol sigurie te rregullueshme deri ne 70 cmH2O
<u>Karakteristikat e Ventilimit:</u>
Fluksi i gazit: 1-120 Litra/min
Volumi Tidal: 20-1500ml ne modalitet VCV
Volumi Tidal: 5-1500ml ne modalitet PCV
Frekuenca e Respirimit:
5-100 bpm per modalitet ventilimi te detyruar
4-60bpm per modalitet ventilimi te sinkronizuar me pacientin
Raporti Inspirim/Ekspirim: 2:1 deri ne 1:4 (me intervale 0.5)
PEEP: OFF, ON: 4÷20 cmH2O
Presioni i Inspirimit: 5÷60 cmH2O
Koha a Inspirimit: 0.2÷5 sekonda
<u>Karakteristikat e Monitorimit:</u>
Volumi Tidal: 0-1500ml
Presioni ne rruget e frymemarrjes: -10÷100 cmH2O
Volumi/minute: 0÷90 Litra/min
<u>Alarmet:</u>
Alarm i ulet/larte per %O2 te inspirimit
Alarm i ulet/larte per presionin e inspirimit
Alarm i ulet/larte per volumin tidal dhe volumin/minute
Alarm APNEA
Detektim dhe Alarm per humbje te gazit ne qarkun e pacientit.
Power Failure Alarm
<u>Aksesoret:</u>
1 cope - Qark pacienti i sterilizueshem per ventilim automatik dhe manual Adult 22mm+Ballon 2L
1 cope - Qark pacienti i sterilizueshem per ventilim automatik dhe manual Pediatrik 15mm+Ballon 1L
<u>Furnizimi me energji:</u>
Rrjeti AC 220V/50Hz
Bateri e integruar per kohezgjatje minimale prej te pakten 60 minuta.
2) Monitor Pacienti
Sistem Modular me a) modul hemodinamik, b) modul gazesh, c) modul sedacioni
Kategorite e perfshira: te rritur, femije, porsalindur.
<u>Karakteristikat:</u>
Format e valeve: Deri ne 6
Ekran i sheshte TFT/LCD min 12", rezolucion 800 x 600
Komandimi i monitorit: Celes knob (i rregullueshem)
Regjistrim i te dhenave grafike dhe parametrave: 72 ore
a) modul hemodinamik
<u>ECG:</u>
EKG- 3/5 lead

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Diapazoni min 30-300 bpm. Saktësia ± 5 bpm.</p> <p>Mbrojtje dhe sinkronizim me defibrilatorin.</p> <p>Zbulim të segmentit –ST. Me algoritëm për aritmi dhe pacemaker.</p> <p>Alarme vizuale dhe zanore.</p> <p><u>Respirimi:</u></p> <p>Metoda: matje e impedences elektrike</p> <p>Diapazon: 5-120rpm (te rritur); 5-150rpm (porsalindur/femije)</p> <p>Saktësia : ± 5rpm. Alarme për rrezën e matjes.</p> <p><u>SpO2 (Saturimi i oksigjenit)</u></p> <p>Diapazon 1-100%. Saktësi ± 2 në rrezën 70-100%.</p> <p><u>NIBP(Presioni i gjatë jo Invaziv)</u></p> <p>Metoda: Oshilometri Automatike</p> <p>Menyrat: manuale/automatike/vazhdueshme.</p> <p>Diapazoni: min 10-270mmHg.</p> <p>Tipi i matjes: sistolik, diastolik dhe mesatar.</p> <p>Mbrojtje ndaj presioneve të larta.</p> <p><u>Temperatura:</u></p> <p>2 kanale-1sonde për matjen e temperaturës në diapazonin: 10-45°C.</p> <p>Rezolucion: 0.1°C. Saktësia: ± 1°C.</p> <p>Pajisur me alarm për temperaturat jashtë diapazonit të matjes.</p> <p><u>IBP (Presioni i gjatë invaziv)</u></p> <p>Mundësi matje me 2- kanale</p> <p>Intervali i matjes: -40+300 mmHg. Saktësia e matjes: $\pm 5\%$.</p> <p><u>Aksesore:</u></p> <p>Konektor për EKG me 3-lead. Set 10x elektroda me një përdorim Adult.</p> <p>Manshete NIBP Adult.</p> <p>Sensor SpO2 Adult me shumë përdorime me kabell dhe konektor elektrik.</p> <p>Sonde temperature Adult</p> <p>Bateri e integruar e rikarikueshme për punë normale për 4 orë.</p> <p>Set Monitorimi për presionin invaziv (Kabell + 5x transducer njëpërdorimesh)</p> <p>b) Moduli i monitorimit të gazeve të pacientit: O2, CO2, N2O, Agjente Anestetike</p> <p>Shfaqje e Kurbes O2. Monitorim i FiO2, EtO2. Intervali i matjes: 0÷100 vol%.</p> <p>Shfaqje e Kurbes CO2. Monitorim i FiCO2, EtCO2. Intervali i matjes: 0÷15 vol%.</p> <p>Monitorim i N2O. Intervali i matjes: 0 ÷100 vol%.</p> <p>Identifikim dhe matje e vol% së agjenteve anestetike. Sevoflurane, Isoflurane, Halothane, enflurane 0÷6 vol%. Desflurane 0÷18 vol%.</p> <p><u>Aksesoret:</u></p> <p>Set monitorimi për modulin e gazeve (10x linja monitorimi + 10x "water trap")</p> <p>c) Modul Sedatimi</p> <p>Shih shenimet dhe specifikimet në artikullin Nr.4 "Modul Sedatimi"</p>
12	Microskop operator okulistik	

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Mikroskop operator okulistik per kirurgji te segmentit anterior</p> <p>Burimi direkt i drites me teknologji LED me jetegjatesei mbi 50,000 ore, me filtrim te rrezeve UV dhe IR</p> <p>Zmadhim i automatizuar me te pakten 5 nivele APO-kromatik ne diapazonin 6.4X-40X</p> <p>Dy drejtime optike te pavarura</p> <p>Ndriçim koaksial i integruar me rregullim nga vete kirurgu</p> <p>Fokusim elektrik deri ne 40mm, me shpejtesi te rregullueshme.</p> <p>Kendi i perthyerjes te pakten $\pm 15^\circ$.</p> <p>Objektiv me vater $f=200\text{mm}$</p> <p>Tub Binokular i perthyer me mundesi rregullimi te distances interpupulare</p> <p>me dy okularë 10x te fiksueshem me rrotullim</p> <p>Sistemi Optik i montuar ne nje bazament te levizshem rreth 60x60cm,</p> <p>me 4 rrota te pajisura me frena dhe me krah te gjate mbi 100 cm</p> <p>Distanca e objektivit nga dysHEMEJA e rregullueshme te pakten 80-130cm</p> <p>Platforma e levizjes ne akset X-Y me interval 40x40mm</p> <p>Sistem modular me opsion asistenti dhe video-dokumentimi</p> <p>Aksesore:</p> <p>Mbulese mbrojtese</p> <p>Mbulese e sterilizueshme per modulin e zmadhimit</p> <p>Mbulese e sterilizueshme per modulin e platformes X-Y</p> <p>Llampe rezerve LED per burimin e drites</p> <p>Te perfshihet pedal me më shumë se 4 funksione</p> <p>Ushqimi 220V / 50Hz</p>
13	Sistem Trapanacioni	<p>Sistem trapanacioni per kirurgji te kokes</p> <p><i>i perbere nga:</i></p> <p>Sistem motorrik multifunksional</p> <p>Pajisje kontrolli me mundesi lidhje te njekohshme te dy motorreve.</p> <p>Me njohje automatike te motorreve dhe rregullim te rrotullimeve deri ne 100,000 xhiro/min</p> <p>Me komandim dhe modifikim nepermjet ekranit grafik me ngjyra me madhesi te pakten 6".</p> <p>Me ruajtje te parametrave te ndryshme te rrotullimit</p> <p>Me pompe irrigimi dhe ftohje te integruar.</p> <p>I pajisur me sistem te sterilizueshem tubash irrigimi.</p> <p>I pajisur me pedal dysh per aktivizim.</p> <p>I pajisur me motorr me shpejtesi te larte, i autoklavueshem me vete-ftohje</p> <p>Ushqimi 220V / 50Hz</p> <p>Set frezimi dakriocistorinostomik</p> <p>Per nderhyrje kirurgjikale endonazale</p> <p><i>i perbere nga:</i></p> <p>Thike e mprehte e harkuar, me maje, me gjatesi 18-20cm</p> <p>Thike e mprehte teper delikate, e harkuar, me maje, me gjatesi 18-20cm</p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

		Thike e rumbullaket, me prerje vertikale, 3.5x2.5mm, me gjatesi 18-20cm
		Thike e rumbullaket, me kend 45 grade, diameter 2mm, me gjatesi 18-20cm
		Elevator, i kthyer djathtas, me gjatesi 18-20cm
		Elevator, i kthyer majtas, me gjatesi 18-20cm
		Gjilpere e forte, e kthyer fort, me gjatesi 18-20cm
		Grep jo i mprehte, 90 grade, me gjatesi 18-20cm
		Elevator jo i mprehte, me dopjo-fund, i niveluar, me gjatesi rreth 20cm
		Teleskop 30 grade, me diameter jo me te madh se 4mm
		Spekulum nazal me fiber optike, me gjatesi 13-14cm
		Forceps nazal Lubet-Barbon, i dhembzuar, me gjatesi 10-12cm
		Ndricues LED me jetegjatesi te madhe, me fuqi te pakten 150W, me ndricim te rregullueshem.
		Kabell drite optik, me gjatesi 1.5-2m per tu perdorur me ndricuesin e mesiperm.
		Reduktor motorrik i holle me diameter me te vogel se 5 mm, i anguluar, i perkulshem ±10 grade
		Per per tu perforur me sistemin e mesiperm motorrik, me shpejtesi 60,000 xhiro/min
		Freza diamanti me koke sferike, 2mm per reduktorin e mesiperm - 5 cope
		Freza diamanti me koke sferike, 3mm per reduktorin e mesiperm - 5 cope
		Freza diamanti me koke sferike, 4mm per reduktorin e mesiperm - 5 cope
		Freza diamanti te ashpra, me koke sferike, 3mm per reduktorin e mesiperm - 5 cope
		Set trapanacioni per koken
		Per nderhyrje kirurgjikale ne raste traumash
		<i>i perbere nga:</i>
		Kraniotom, per tu perdorur me sistemin e mesiperm motorrik
		Me mbrojtjes te cipes se trurit, ne masa pediatrike dhe adulte
		Freza kraniotomie me diameter 3-3.5mm, per kraniotomin e mesiperm, pediatrike - 5 cope
		Freza kraniotomie me diameter 3-3.5mm, per kraniotomin e mesiperm, per te rritur - 5 cope
		Doreze perforce, me konektor Hudson, per shpejtesi rrotullimi mbi 1000 xhiro/min
		per per tu perdorur me sistemin e mesiperm motorrik
		Perforues kranial me konektor Hudson, per dorezen e mesiperme, pediatrik - 5 cope
		Perforues kranial me konektor Hudson, per dorezen e mesiperme, adult - 5 cope
14	Tavoline Mayo	
		Tavoline e levishme per mbajtje instrumentash kirurgjikale
		Lartesi e rregullueshme aftersisht 90-115 cm
		Siperfaqia e tavolines jo me pak se 70 x 45 cm
		Tavolina te jete konstrukcion metalik inoksidabel
		Bazamenti prej celiku inoksidabel me 4 ose 5 rrota te levizeshme.
15	Tavoline Operatore - Kirurgji e pergjithshme	
		Tavoline me 4 segmente, koka, krahet, shpina, kembet. Pjesa e mesit me prerje te harkuar.
		Te jete e komandueshme me telekomande
		Mbulese antistatike , higjenike , e pa djegeshme, rrezistente ndaj ujit.
		Pjesa e kurritzit dhe lartesia e tavolines operatore e rregullueshme.

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Te gjitha pjeset e tavolines jane prej celik inox.</p> <p>I gjithë trupi i shtratit është radiolucent nga rrezet X.</p> <p>I pajisur me shina anesore per aksesoret</p> <p>Pjesa e mesit është me prerje te harkuar per nderhyrje gjinekologjike</p> <p>Permasat e shtratit te tavolines pa perfshire shinat anesore te pakten: 200 cm x 50 cm</p> <p>Te kete levizje Trendenburg / Reverse Trendenburg elektrikisht te rregullueshme te pakten -30°/30°</p> <p>Lartesia e rregullueshme ne menyre elektrike: afersisht 780-1000mm</p> <p>Pjesa e kokes (larte/poshte) e rregullueshme te pakten: 45°/-45°</p> <p>Trupi i shtratit, me shina anesore</p> <p>Perkulje anesore (majtas/djathtas) e rregullueshme, mbi 20°</p> <p>Pjesa e shpines (lart/poshte) te pakten 80°/-40°</p> <p>Mbeshtetja e krahut: 0-90°</p> <p>Pjesa e kembeve e ndare ne 2 seksione</p> <p>Pesha maksimale 180 Kg</p> <p>E pajisur me bateri te karikueshme te integruar per te pakten 50 operacione.</p> <p>Aksesoret: bllokues kembesh/mbeshtetes gjuri (1 pale), mbeshtetes i kraheve (1 pale), Mbeshtetes shpatulle (1 pale), Rrip per trupin, mbajtes serumi, mbeshtetes koke. Perde Anestezie.</p>
16	Tavoline Operatore - Ortopedike	<p>Tavoline me 4 segmente, koka, krahët, shpina, kembet. Pjesa e mesit me prerje te harkuar.</p> <p>Te jete e komandueshme me telekomande</p> <p>Mbulese antistatike , higjenike, e pa djegeshme, rrezistente ndaj ujit.</p> <p>Pjesa e kurrit dhe lartesia e tavolines operatore e rregullueshme.</p> <p>Te gjitha pjeset e tavolines jane prej celik inox.</p> <p>I gjithë trupi i shtratit është radiolucent nga rrezet X.</p> <p>I pajisur me shina anesore per aksesoret</p> <p>Permasat e shtratit te tavolines pa perfshire shinat anesore te pakten: 200 cm x 50 cm</p> <p>Te kete levizje Trendenburg / Reverse Trendenburg elektrikisht te rregullueshme te pakten -30°/30°</p> <p>Lartesia e rregullueshme ne menyre elektrike: afersisht 780-1000mm</p> <p>Pjesa e kokes (larte/poshte) e rregullueshme te pakten: 45°/-45°</p> <p>Trupi i shtratit, me shina anesore</p> <p>Perkulje anesore (majtas/djathtas) e rregullueshme, mbi 20°</p> <p>Pjesa e shpines (lart/poshte) te pakten 80°/-40°</p> <p>Mbeshtetja e krahut: 0-90°</p> <p>Pjesa e kembeve e ndare ne 2 seksione</p> <p>Pesha maksimale 180 Kg</p> <p>E pajisur me bateri te karikueshme te integruar per te pakten 50 operacione.</p> <p>Aksesoret: bllokues kembesh/mbeshtetes gjuri (1 pale), mbeshtetes i kraheve (1 pale), Mbeshtetes shpatulle (1 pale), Rrip per trupin, mbajtes serumi, mbeshtetes koke. Perde Anestezie. Te perfshihet ekstensioni ortopedik me aksesoret perkates.</p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

17	Tavoline Operatore Obstetrike-Gjinekologjike	<p>Tavoline me segmente, koka, krahet, shpina, kembet. Pjesa e mesit me prerje te harkuar.</p> <p>Te jete e komandueshme me telekomande</p> <p>Mbulese antistatike , higjenike, e pa djegeshme, rrezistente ndaj ujit.</p> <p>Pjesa e kurrizit dhe lartesia e tavolines operatore e rregullueshme.</p> <p>Te gjitha pjeset e tavolines jane prej celik inox.</p> <p>I gjithë trupi i shtratit është radiolucent nga rrezet X.</p> <p>I pajisur me shina anesore per aksesoret</p> <p>Pjesa e mesit është me prerje te harkuar per nderhyrje gjinekologjike</p> <p>Permasat e shtratit te tavolines pa perfshire shinat anesore te pakten: 200 cm x 50 cm</p> <p>Te kete levizje Trendelenburg / Reverse Trendelenburg elektrikisht te rregullueshme te pakten -30°/ 30°</p> <p>Lartesia e rregullueshme ne menyre elektrike: afersisht 780-1000</p> <p>Pjesa e kokes (larte/poshte) e rregullueshme te pakten: 45°/-45°</p> <p>Trupi I shtratit, me shina anesore</p> <p>Perkulje anesore (majtas/djathtas) e rregullueshme, mbi 20°</p> <p>Pjesa e shpines(lart/poshte) te pakten 80°/-40°</p> <p>Mbeshtetja e krahut: 0-90 grade</p> <p>Pjesa e kembeve e ndare ne 2 seksione</p> <p>Pesha maksimale 180 Kg</p> <p>E pajisur me bateri te karikueshme te integruar per te pakten 50 operacione.</p> <p>Aksesoret: bllokues kembesh/mbeshtetes gjuri (1 pale), mbeshtetes i kraheve (1 pale), Mbeshtetes shpatulle (1 pale), Rrip per trupin, mbajtes serumi, mbeshtetes koke.</p>
18	C - ARM	<p>Sistem C-ARM Dixhital per sala operimi</p> <p>Per aplikim Adult dhe Pediatrik</p> <p>Sistemi i gjenerimit te rrezeve-X:</p> <p>Gjenerator monoblok me frekuence te larte, jo me pak se 30kHz</p> <p>Panel kontrolli X-ray per parametrat funksionale</p> <p>Tensioni maksimal deri ne jo me pak se 110 kVp</p> <p>Kapaciteti i nxehtesise se monoblokut mbi 800.000 HU</p> <p>Tub X-Ray me dy fokuse</p> <p>Kapaciteti i nxehtesise se anodes mbi 70.000 HU</p> <p>Kapaciteti ftohes i anodes mbi 35.000 HU / min</p> <p>Nxehtesia e tubit te monitorohet me tregues kontrolli ne ekran</p> <p>Modalitetet e Operimit</p> <p><u>Radiografi</u></p> <p>Diapazoni kV jo me pak se 40-110 kV</p> <p>Mbajtesi i kasetes filmike jo me i vogel se 24 x 30 cm.</p> <p><u>Fluoroskopi</u></p> <p>Menyrat fluoroskopike: pulsative, te vazhdueshme, me doza te ulta, doza normale rrezatimi, etj..</p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

Fluoroskopi manuale dhe automatike per te gjithë llojet e menyrove fluoroskopike
Diapazoni kV jo me pak se 40-110 kV
Diapazoni i rrymes min. 0.2-12 mA varesisht menyres fluoroskopike
Fluoroscopia pulsative me zgjedhje te ritmit te pulseve deri ne jo me pak se 8 pulse ne sekonde.
Funksion per kontrollin dhe rregullimin automatik te ndricimit
<u>Moda Dixhitale Spot</u>
Me rregullim automatik te ekspozimit dhe ruajtjes se imazhit
Diapazoni kV jo me pak se 40-110 kV
Diapazoni i rrymes deri ne jo me pak se 15mA
<u>Sistemi i Perfimit dhe Procesimit te Imazhit</u>
<u>Kolimatori</u>
Me tregues pozicionimi ne ekran
Me mundesi rregullimi paraprak pa rrezatim
<u>Intensifikuesi i Imazhit 9"</u>
Intensifikator Imazhi me 3 fusha.
Fusha maksimale te kete dimension te pakten 9 inch
<u>Sistem automatik i perfimit dhe optimizimit te imazhit</u>
Identifikon automatikisht anatomine e fushepamjes dhe perzgjedh tekniken optimale te imazhimit
Monitoron dhe kontrollon ne menyre dinamike pozicionimin e kolimatorit dhe pershtatjen automatike te ndricimit dhe kontrastit
Identifikon objekte/implante metalike ne fushe pamje dhe ben rregullim automatik te densitetit te ndricimit dhe kontrastit duke perftuar imazhe te optimizuar me cilesi te larte.
Zinxhiri i perfimit, rishikimit dhe perpunimit te imazhit me rezolucion 1024 x 1024
<u>Kamera CCD</u>
Video-kamere dixhitale CCD
Me rezolucion te larte jo me pak se 1024 x 1024
<u>Monitore (Live dhe Reference) - 2 cope</u>
Monitoret te klases mjekesore; te montuar sebashku me sistemin dixhital ne nje karrel te levizshem
Dimensioni diagonal min. 19 inch.
Rezolucioni i larte min. 1280x1024
Ekran TFT/LCD antirefleks
Dalje dixhitale DVI per monitor te jashtem
<u>Sistem Dixhital i Imazhit</u>
Formati i procesimit te Imazhit: minimumi 1024 x 1024 x 16bit
Kapaciteti i regjistrimit/ruajtjes: min 100.000 imazhe me rezolucion 1024x1024
<u>Perpunimi i imazheve:</u>
Kontroll dixhital automatik dhe manual i ndicimit dhe kontrastit. Regjistrim i imazhit te fundit.
Korrektim automatik i uniformitetit te imazhit dhe permiresim i kontureve nepermjet filtrimit
Filter dinamik per minimizim te zhurmave gjate levizjes se pacientit
Matje e distances dhe kendeve me kalibrim operatori nepermjet funksioneve specifikë
Funksion per shenjimin, prerjen dhe komentimin e imazheve

Dokumentat Standarde të Tenderit

	<p>Modalitet zmadhimi, rrotullimi dhe pasqyrimi te imazheve</p> <p>Rrotullim i imazheve ne kohe reale dhe gjate rishikimit.</p> <p><u>Paketa Pediatrike</u></p> <p>Set aplikimi pediatrik per doza te uleta duke garantuar cilesi imazhi te larte</p> <p>Pajisur me filtra dhe rrjeta te dedikuara pediatrike</p> <p><u>Administrimi i Pacienteve dhe Arkivi i te dhenave</u></p> <p>Regjistrim i te dhenave te pacientit sebashku me listen e ekzaminimeve</p> <p>Raport i permbledhur ne lidhje me dozen e pacientit. Mundesi eksportimi dhe printimi te raportit</p> <p>Arkivim i imazheve ne forme elektronike nepermjet USB dhe DVD/CD</p> <p>Nderfaqe permanente DICOM per funksionet: Worklist, Transfer/Storage dhe Print</p> <p><u>Karakteristikat Mekanike:</u></p> <p>Levizje vertikale e motorizuar: jo me pak se 420 mm</p> <p>Levizja Horizontale: min. 200 mm</p> <p>Rrotullimi: min. $\pm 10^\circ$</p> <p>Rrotullimi anesor: min. $\pm 190^\circ$</p> <p>Rrotullim i planit orbital: min. 120°</p> <p>Thellesia: min. 650 mm</p> <p>Hapesira e lire: min. 780 mm</p> <p><u>Sisteme ndihmese dhe aksesore:</u></p> <p>Sistem pozicionimi me LASER per identifikimin e aksit qendror X-Ray</p> <p>Celes "Footswitch" dhe "Handswitch"</p> <p>Sistem i integruar per garantimin e energjise pa nderprerje. Garanton ruajtjen e te dhenave te pacientit dhe mbrojtjen e "hardware" nga shkeputjet e menjehershme te energjise</p> <p>Pajisje DAP (Dose Area Product) per monitorimin e dozesh</p>
--	--

Specifikime teknike LOT 3

Nr.	Pajisja	Specifikimet
1	Aparat Kolposkopie	
		Video Kolposkop trinokular me bazament te levizshem me rrota
		Mekanizem per rregullimin optimal te fokusit dhe lartesis
		Burim drite LED i bardhe me intensitet te rregullueshem dhe vlere minimale: 25 K Lux.
		Zmadhim optik me tre shkallezime: 3.75X, 7.5X dhe 15X
		Nje nga okularet te jete i pajisur me sistem shkallezimi per matje te indeve
		Optike e cila garanton rezolucion dhe kontrast te larte, dhe fushepamje te gjere
		I pajisur me filter te integruar (te gjelber) per identifikimin e eneve te gjakut
		Te perfshihet kamera e integruar per transferimin e imazheve ne monitor te jashtem dhe ne njesi dokumentimi dixhitale
		Furnizimi 220V/AC

Dokumentat Standarde të Tenderit

2	Aspirator per neonate	
		Pompe vakumi me kapacitet afersisht 550 mm/Hg
		Kapaciteti i thithjes mbi 15 L/min
		Rezervuari: nje ene me volum 1 Liter e autoklavueshme, mbrojtje nga mbi mbushja dhe me kapak
		Aksesore:
		Tuba silikoni me gjatesi 2m
		Filter anti bakterial
3	Sistem Histeroskopie	
		I pershtatshem per tu perdorur per ekzaminim dhe nderhyrje intrauterine
		<u>Processori i imazhit</u>
		Te marre dhe te procesoje imazhin e marre nga kamera endoskopike me nje chip
		Te kryeje balancimin automatik te te bardhes
		Te mund te kryeje permiresimin e imazhit nepermjet filtrave te integruar
		Te kete mundesi ndryshimi manual te kontrastit
		Te kete mundesi te lidhet dhe te jete i pajisur me nje tastiere
		Te supportoje dalje DVI
		<u>Monitori</u>
		Ekran me ngjyra LCD, madhesia min 15", me rezolucion te pakten 1024x768 piksel
		<u>Burimi i drites</u>
		I pajisur me llampe LED me jetegjatesi rreth 30,000 ore pune
		Me ndricim te rregullueshem
		<u>Njesia e dokumentimit</u>
		E afte per regjistrimin e te dhenave te pacienteve
		E afte per krijimin e raporteve, perfshire imazhet dhe filmimet e procedurave
		E pajisur me dalje USB per ruajtjen e per transferimin e te dhenave te pacientit ne pajisje te jashtme.
		Te mund te lidhet me printer USB per shtypjen e raporteve
		<u>Koka e kameres</u>
		E pershtatshme per tu lidhur me videoprocesorin e mesiperm
		Teknologjia CCD, me nje chip, me dy butona te programueshem
		E fokusueshme. Me zoom te integruar: min 1.5 here. E sterilizueshme
		<u>Kablli optik</u>
		I pershtatshem per tu lidhur me videoprocesorin e mesiperm.
		Me gjatesi te pakten 2300mm dhe trashesi 3.5mm
		I sterilizueshem me avull apo me gaz
		<u>Seti i Instrumentave</u>
		Teleskop 30°, me diameter me te vogel se 3 mm dhe gjatesi 30 cm, i autoklavueshem
		Kellef operimi i brendshem me kanal pune per instrumenta 5 Fr. Me rubinet dhe dalje Luer-lock per irrigim.
		(I pershtatshem per tu perdorur me teleskopin e mesiperm dhe kellefin e meposthem)
		Kellef i jashtem operimi me rrjedhje te vazhdueshme (Continuous-Flow) jo me i madh se 5 mm.

Dokumentat Standarde të Tenderit

		Me rubinet dhe dalje Luer-lock per aspirim. (I pershtatshem per tu perdorur me kellefin e mesiperm)
		Gershere jo te mprehta, me diameter 5 Fr. Dhe gjatesi rreth 35 cm
		Pince per kapje dhe biopsi, me diameter 5 Fr. Dhe gjatesi rreth 38 cm
		Electrode prerje bipolare me diameter 5Fr. Dhe gjatesi rreth 35 cm
		Element punues bipolar aktiv bashke me kabell per rezektim, kompatibel me Gjeneratorin Kirurgjikal
		Kellef i dyfishte per aspirim dhe irrigim, 26Fr per tu perdorur me elementin e mesiperm punues
		Obturator per tu perdorur per kellefin e mesiperm.
		Elektroda bipolare per miomektomi dhe polipektomi - 6 cope, per disektim te septumit - 6 cope
		Teleskop 12°, me gjatesi 30 cm, i autoklavueshem per rezektoskopin ne fjale
		<u>Pajisje irrigimi dhe aspirimi</u>
		Sistem irrigimi peristaltik dhe thithjeje per perdorim ne histeroskopi dhe laparoskopi gjinekologjike
		Me sistem monitorimimi te presionit intrauterin te irrigimit
		Presioni dhe fluksi i irrigimit te kontrollohet elektronikisht dhe me krahasim vizual kundrejt vlerave te paracaktuara
		Pedal per komandimin e irrigimit dhe butona per caktimin e parametrave te irrigimit.
		Rregullimi i presionit te irrigimit histeroskopik: 0-200mmHg
		Rregullimi i fluksit te irrigimit histeroskopik: 0-500ml/min
		Rregullimi i presionit te thithjes ne histeroskopi: 0-(-0.5)bar
		Ushqimi: 100 -240 VAC, 50/60 Hz
		Te furnizohet me: kabllin e ushqimit
		Me pedalin e komandimit te irrigimit
		Set tubash irrigimi me histeroskopi, i sterilizueshem
		Set tubash aspirimi, i sterilizueshem
		Shishe aspirimi 5L dhe kapaku bashke me konektoret, e gjitha e sterilizueshme
		Mbajtese metalike per shishes se aspirimit, me doreze te gomuar
		<u>Karrel endoskopie</u>
		I pajisur me 4 rrota antistatike me frena
		I pajisur me te pakten 2 ndarje per pajisjet e endoskopise dhe sirtar
		Me shperndares te integruar energjie per pajisjet e histeroskopise
4	Peshore Dixhitale per bebe	
		Peshore elektronike. Kapaciteti mates: jo me pak se 20Kg.
		Ndjeshmeria: 10g per intervalin <10Kg dhe 20g per intervalin 10+20Kg
		Me afishues dixhital
		Mbajtese per femije e cmontueshme.
		Mates gjatesie deri ne 80cm me afishues dixhital.
5	Puls oksimeter per femije	
		Te kryej matjet per SpO2, frekuenca kardiake
		Sensor SpO2 per perdorim neonatal
		Ekran me ngjyra LCD me resolucion te larte. Dimension minimal: 2.4"

Dokumentat Standarde të Tenderit

		Bateri e rikarikueshme Litiumi dhe karikues stacionar.
		Me alarm vizual dhe audio.
		Te kryej matjet e SpO2 ne intervalin: 0-100%. Saktesia: ±2%
		Te kryeje matjet e frekuences kardiake ne intervalin: 20-300 bpm. Saktesia: ±3bpm
6	Puls oksimeter per adult	
		Te kryej matjet per SpO2, frekuenca kardiake
		Sensor SpO2 per perdorim adult
		Ekran me ngjyra LCD me resolucion te larte. Dimension minimal: 2.4"
		bateri e rikarikueshme Litiumi dhe karikues stacionar.
		Me alarm vizual dhe audio.
		Te kryej matjet e SpO2 ne intervalin: 0-100%. Saktesia: ±2%
		Te kryeje matjet e frekuences kardiake ne intervalin: 20-300 bpm. Saktesia: ±3bpm
7	Inkubator per neonate me servo kontroll	
		Inkubator spitalor per te sapolindur dhe te lindur prematur.
		Pajisur me sistem kontrolli me mikroprocesor
		Kontrollon dhe monitoron ne menyre automatike gjate gjithë kohes: temperaturën e ajrit dhe të lekures, përqendrimin e oksigjenit dhe të lageshtise relative.
		Panel kontrolli i pajisur me ekran grafik LCD me ngjyra, per te vizualizuar parametrat e kontrollit
		Pajisur me peshore te integruar
		Vizualizim i vlerave aktuale dhe vlerave te vendosura te temperatures se ajrit, temperatures se lekures, lageshtise relative dhe përqendrimin te oksigjenit. Vizualizim i trendit grafik te parametrave te kontrollit.
		Alarmi visual dhe akustik per: tejkalim temperature, nderprerje te qarkullimit te ajrit, shkeputje te sensorit te temperatures, përqendrimin e oksigjenit, mungesen e energjise, devijim te temperatures se lekures nga vlera e paracaktuar, nivelin minimal te ujit etj.
		Pajisur me sisteme alarmi vizual dhe akustik per parametrat e matur
		Kapaku me mure transparente dopio
		Struktura e perbere nga te pakten 2 porta hyrese, 4 porta manipulimi, per sensore tuba ushqimi, etj
		Pajisur me mbajtese per kaseta x-ray
		Funksion automatik te kompensimit te temperatures ne momentin kur hapet nje nga portat hyrese te inkubatorit duke krijuar nje shtrese mbrojtese ajri.
		Komandim elektronik i kendit te shtratit nga paneli i komandimit
		Sistemi duhet te jete i mbeshtetur ne 4 rrota dy prej te cilave duhet te jene te pajisura me frena.
		Kontrolli i temperatures:
		Ajer: Servo control, Diapazoni: 20-37°C
		Kontroll i lekures i integruar: Servo control, diapazoni: 34-37°C
		Kontroll i lageshtise: 40-90%
		Kontroll i Oksigjenit: 21-75%
		Niveli i Zhurmes brenda inkubatorit me pak se 45dB
		Te kete nje strukture per montimin e monitoreve, pajisjeve dhe aksesoreve
		Te jete i pajisur me nje set sensoresh per temperaturën e lekures, filtra oksigjeni dhe ajri.
		Te furnizohet sebashku me nje kape (hood) me konektor oksigjeni per neonate dhe bebe

Dokumentat Standarde të Tenderit

		premature.
8	Kardiotohograf	
		Kardiotohograf per binjake
		Per perdorim te pergjithshem per rrahjet e zemres se fetusit, levizjet e fetusit ne menure automatike dhe kontraksionet e paralindjes. Aftesi interpretimi automatik dhe raportim te tij.
		I pajisur me monitor me prekje min 7" LCD dhe printer termal.
		Menyre e punes te jete dopler ultrasonik.
		Me frekuence pune 1.0 Mhz.
		Intesiteti: Me I vogel se 10 mW/cm2
		Shkalla e detektimit te rrahjeve te zemres se fetusit minimumi 50-200 rrahje per minute.
		Te kete memorie te brendshme me kapacitet ruajtje te pakten 48 ore.
		Te kete mundesi lidhjeje WiFi dhe LAN me sistem qendror monitorimi.
		Te kete dalje serial/usb per tu lidhur me kompjuter
		Bateri e karikueshme e integruar per te pakten 2 ore pune autonomi.
		Aksesoret:
		Karrel per vendosjen e Kardiotohografit dhe aksesoreve te tij - 1 cope
		Sonda ultrasonike - 2 cope
		Sonde Toko - 1 cope
		Shenues ngjarjesh - 1 cope
		Xhel - 1 cope
		Rrip fiksues - 3 cope
		Leter Printeri - 1 cope
9	FRH per rrahjet e zemres	
		E vogel, e lehte, me ndjeshmeri te larte Doppler.
		Me sonde fetusi
		Per perdorim te pergjithshem per rrahjet e zemres se fetusit nga java 10 e shtatzenise
		Perdorim:
		pozicionin i placentes,
		studimi fluksit te gjakut te kordonit te kerthizes
		diagnostikimi shtatzeni te shumefishta.
		Frekuenca e ultratingujve 2 MHz me vale te vazhdueshme
		Fuqia: $\leq 10 \text{ mW/mm}^2$
		Audio te pakten 1mW
		FHR (Fetal heart rate): min 50-210 bpm
		Risolucion: 2 bpm
		Saktesi: 2 bpm
		Indikatore: 3 digit FHR LCD ekran
10	Eko obstetrike gjinekologjike	
		Eko dopler me ngjyra per Obstetri dhe Gjinekologji
		Model i levizshem me rrota me mbeshtetje ne dysheme.

Dokumentat Standarde të Tenderit

I kontrolluar me mikroprocesor, teknologji dixhitale dhe mbi 220.000 kanale dixhitale perpunimi
Intervali I frekuencave te funksionimit: 2 deri ne 18MHz
Paketa matje dhe llogaritjesh per aplikime Gjinekologjike, Obstetrike, Abdominale, Doppler, Kardiake, Vaskulare, Urologjike.
Te mundesoje egzaminime Elastografie
Te kete te pakten 3 porta per sonda aktive.
Menyrat e operimit: 2D, 3D, 4D, te perfshira dhe instaluara ne aparat ne menyre permanente.
Monitori i imazhit i sheshte (LCD/LED), me ngjyra. Madhesia e ekranit te pakten 17", me rezolucion te larte.
Paneli i kontrollit i pajisur me ekran (LCD/LED) me prekje, per komandim/kontroll funksional. Madhesia: mbi 25cm diagonal
Monitori i rrotullueshem, me kend te ndryshueshem.
Shfaqja e imazhit: single/dual/quad, 256 nuanca grije.
Intervali Dinamik maksimal mbi 260 dB
Thellesia e fushes se skanimit: 0-33cm
Mundesi selektimi per minimumi 10 shkalle frekuencash.
Perfshin funksione cine me memorizim te shume cikleve.
Funksione automatike per permiresimin e rezolucionit, kontrastit dhe per rregullimin automatik te spektrit doppler (linja baze, frekuenca PRF, etj.)
Software per administrimin e te dhenave te pacienteve
Funksion per parametrizimin dinamik te zhvillimit te fetusit.
Software per permiresimin e kontureve te imazhit, diferencimin indor dhe reduktimin e artefakteve
Te kete filter per reduktimin e artefakteve me min. 8 shkallezime
Shpejtesia maksimale e nderrimit te imazhit mbi 1400 frames/sec
Perfshin Menyrat e shfaqjes se imazhit:
2D-Mode, M-Mode, Color M Mode, Color Doppler, Power Doppler (PD), Pulse Wave Doppler (PWD), 3D-Mode, 4D-Mode, Beam Steering, Harmonic Imaging.
Color Doppler. Amplifikim deri ne 40dB me shkallezim jo me te madh se 0.5dB. Shkalla PRF: 0.1 deri ne min.25KHz me te pakten 18 shkallezime. Perthyerje e kendit te skanimit ne te pakten 3 nivele dhe kend maksimal $\pm 20^\circ$. Kufiri i ngjyres i rregullueshem ne te pakten 10 nivele nga 10-100%. Mundesi selektimi deri ne 10 ose me shume harta ngjyre.
Power Doppler. Shkalla e ngjyres (PRF): 0.1 deri ne min. 25KHz me te pakten 18 nivele
PW Spectral Doppler. Intervali i frekuences jo me pak se 0.3 – 28.0 KHz. Shpejtesia: 0.1 - 3600 cm/s. Amplifikimi deri ne 80dB me shkallezim jo me te larte se 1.0dB. Korrigjimi i kendit: -90 deri +90. Rregullimi bazes se spektrit ne te pakten 10 nivele.
Software 3D dhe 4D. Paraqitje deri ne 3 plane X-Y-Z dhe imazhit 3D ne kohe reale (4D). Gjenerim deri ne 18 prerje terthore me distance te ndryshueshme nga 0.5mm deri ne 4cm. Mundesi perpunimi te imazhit 3D, pastrim i artefakteve dhe rrotullim deri ne 360°
Perfshin Sondat:
Sonde Konvekse volumetrike 4D, multifrequency me bande te gjere 2-5 MHz.
Numri minimal i elementeve: 128. Fushepamja minimale: 55° .
Teknologji e avancuar per depertim dhe rezolucion maksimal.
Sonde Endovaginale 2D multifrequency 4-10 MHz.

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Numri minimal i elementeve 128. Fushëpamja minimale 160°.</p> <p>Te kete memorje te brendshme HDD per te pakten 500 GB</p> <p>CD/DVD-RW te inkorporuar</p> <p>Te kete te pakten 3 porta USB 2.0.</p> <p>Porte network (Ethernet)</p> <p>Porte per Video Out</p> <p>Video Printer Bardh e Zi</p>
11	Eko Portative	<p>Eko dopler me ngjyra e pershtatshme per aplikime adult dhe neonatale</p> <p>Model portabel i pajisur me bateri te integruar</p> <p>I kontrolluar me mikroprocesor, teknologji dixhitale dhe mbi 180.000 kanale dixhitale perpunimi</p> <p>Intervali i frekuencave te funksionimit: 2 deri ne 13MHz</p> <p>Paketa matje dhe llogaritjesh per aplikime Gjinekologjike, Obstetrike, Abdominale, Doppler, Kardiake, Vaskulare, Urologjike, Transkranial, Pjese te Vogla dhe Muskoskeletale</p> <p>E pajisur me dy porta aktive per sondat</p> <p>Monitori i imazhit i sheshte LCD, me ngjyra. Madhesia e ekranit te pakten 15", me rezolucion te larte.</p> <p>Menyrat e operimit: 2D dhe opsion per modalitet 3D</p> <p>Shfaqja e imazhit: single/dual/quad, 256 nuanca grije.</p> <p>Intervali Dinamik maksimal mbi 220 dB.</p> <p>Thellesia e fushes se skanimit: 0-33cm</p> <p>Mundesi selektimi per minimumi 10 shkalle frekuencash ne modalitet 2D</p> <p>Perfshin funksione cine me memorizim te shume cikleve.</p> <p>Funksione automatike per permiresimin e rezolucionit, kontrastit dhe per rregullimin automatik te spektrit doppler (linja baze, frekuenca PRF, etj.)</p> <p>Software per administrimin e te dhenave te pacienteve</p> <p>Funksion per parametrizimin dinamik te zhvillimit te fetusit.</p> <p>Software per permiresimin e kontureve te imazhit, diferencimin indor dhe reduktimin e artefakteve</p> <p>Shpejtesia maksimale e nderrimit te imazhit te pakten 1100 frames/sec</p> <p>Te kete filter me definicion te larte per reduktimin e artefakteve me min. 6 shkallezime ne modalitet 2D dhe kompatibel per modalitet 3D</p> <p>Perfshin Menyrat e shfaqjes se imazhit:</p> <p>2D-Mode, M-Mode, Color M-Mode, Color Doppler, Power Doppler (PD), Pulse Wave Doppler (PWD), 3D, Beam Steering, Harmonic Imaging.</p> <p>Color Doppler. Amplifikim deri ne 40dB me shkallezim jo me te madh se 0.5dB. Shkalla PRF: 0.1 deri ne min.18KHz me te pakten 18 shkallezime. Perthyerje e kendit te skanimit ne te pakten 3 nivele dhe kend maksimal ±20°. Kufiri i ngjyres i rregullueshem ne te pakten 10 nivele nga 10-100%. Mundesi selektimi deri ne 10 ose me shume harta ngjyre.</p> <p>Power Doppler. Shkalla e ngjyres (PRF): 0.1 deri ne min. 18KHz me te pakten 18 nivele</p> <p>PW Spectral Doppler. Intervali i frekuences jo me pak se 0.3 – 25.0 KHz. Shpejtesia: 0.5 - 3600 cm/s. Amplifikimi deri ne 80dB me shkallezim jo me te larte se 1.0dB. Korrigjimi i kendit: -90 deri +90. Rregullimi bazes se spektrit ne te pakten 10 nivele.</p> <p>Te kete memorje te brendshme HDD per te pakten 100 GB</p> <p>Te kete te pakten 2 porta USB 2.0.</p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Porte network (Ethernet), Porte per Video Out</p> <p>Pesha maksimale e pajisjes (sebashku me bateri) te jete jo me shume se 7Kg.</p> <p><u>Perfshin Sondat:</u></p> <p>Sonde Konvekse 2D me frekuence te larte dhe me bande te gjere 2-5 MHz.</p> <p>Numri minimal i elementeve: 128. Fushepamja minimale: 55°.</p> <p>Sonde Mikrokonvekse Konvekse 2D me frekuence te larte dhe me bande te gjere 5-10 MHz.</p> <p>Numri minimal i elementeve: 128. Fushepamja minimale: 125°.</p> <p><u>Aksesore te tjere:</u></p> <p>Karrel i dedikuar posacerisht per ekografin e mesiperm me mbajtes per sondat dhe suport per instalimin e nje printeri bardh e zi.</p> <p>Video Printer Bardh e Zi</p>
12	Panel gazrash mjekesore dopjo (per kokat e krevateve)	
		<p>I montueshem ne mur</p> <p>Gjatesia 2500 ÷ 3500m</p> <p>Siperfaqe e lyer me boje statike</p> <p>Me dalje te vecanta per gaz dhe elektricitet</p> <p>Daljet e gazit te perfshijne gaz mjekesor oksigjen 2cope, vakum 2cope, drite 2 cope, Priza Schucko 4 cope, sistem lajmerim infermiere 2 cope. Me standarde gjermane ose AFNOR</p>
13	Panel gazrash mjekesore tek (per kokat e krevateve)	
		<p>I montueshem ne mur</p> <p>Gjatesia jo me pak se 900mm</p> <p>Siperfaqe e lyer me boje statike</p> <p>Me dalje te vecanta per gaz dhe elektricitet</p> <p>Daljet e gazit te perfshijne gaz mjekesor oksigjen 1cope, vakum 1cope, drite, Priza Schucko 2 cope, sistem lajmerim infermiere. Me standarde gjermane ose AFNOR</p>
14	Ngrohesh Intravenoz	
		<p>Ngrohesh gjaku dhe fluidesh intravenoze</p> <p>Per shmangien e hipotermise gjate nderhyrjeve kirurgjikale, reanimacion adult dhe neonatal</p> <p>I pajisur me kontrollor temperature dhe shkembyses nxehtesie steril, me nje perdorim.</p> <p>Temperatura e fluidit ne dalje rreth 40°C. Montim i thjeshte i linjave te ngroheshit me konektore luer-lock.</p> <p>Administrimi i fluideve me gravitet me nje fluks minimal jo me pak se 6 litra ne ore.</p> <p>Te furnizohet me 20 shkembyses steril.</p>
15	Panel per Reanimacionin Adult	
		<p>I montueshem ne mur</p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Gjatesia jo me pak se 1200mm</p> <p>Siperfaqe e lyster me boje statike</p> <p>Me dalje te vecanta per gaz dhe elektricitet</p> <p>Daljet e gazit perfshijne gaz mjekesor oksigjen 2cp, ajer 1cp, vakum 1cp, rrjet, drite, Priza Schucko 4 cope, sistem lajmerim infermiere etj., me standarde gjermane ose AFNOR</p>
16	Shiringe elektrike	<p>Volumi i infuzionit te pakten nga: 0.10-999.9ml</p> <p>Koha e infuzionit: 1 min – 95 h 59 min</p> <p>Administrimi i bolus manualisht ne intervalin 50-1200ml/h</p> <p>Saktesia ±2%</p> <p>Numri eventeve te pakten 1500</p> <p>Kohe zgjatja e baterise : 10 ore ne 5 ml/h</p> <p>Shkalla e KVO: 0.1-5.0ml/h</p> <p>Te perfshihet librari medikamentesh per te shmangur gabime ne administrimin e tyre.</p> <p>Pajisur me modalitet kontrolli te ndryshueshem gradual ose te paracaktuar ne 3 nivele</p> <p>Pajisur me sistem dinamik per te sinjalizuar ndryshimin e presionit</p> <p>Mundesi infuzioni per anestezi te plote</p> <p>Njesite e dozimit g, mg, µg, ng, U, mol.</p> <p>Kapaciteti i Shiringave: 5-60 ml</p> <p>Njohje automatike e madhesis se shiringes</p> <p>Alarme vizive dhe akustike per raste te ndryshme:</p> <p>Rastet: bateri e ulet, afrimi i mbarimit te infuzionit, rritje e presionit, fund infuzioni, fluks i ulet, bllokim i linjes, keqfunksionim i brendshem, ajer ne sistem, kapak i hapur.</p> <p>Te mundesoje integrimin e librarise se ilaceve per te pakten 120 ilace</p>
17	Ambu per Neonate	<p>vellimi 250-500ml</p> <p>te cmontueshem dhe te sterilizueshem</p> <p>duhet te jene me limitues te presionit (rreth 30 cmH2O)</p> <p>maskat duhet te jene transparente me jastek ajri dhe permasa neonatale, e sterilizueshme</p> <p>Te jete e pajisur me rezervuarin dhe tubat lidhes per bombul O2</p>
18	Aparature CPAP per neonate me lageshtues	<p>Pajisja perbehet nga Njesia CPAP dhe Lageshtues</p> <p>Njesia CPAP:</p> <p>Pajisje per terapi nCPAP per neonate me kontroll dhe monitorim te %O2 ne intervalin: 21-100%</p> <p>Perzjeres gazesh (Ajer dhe O2) i integruar ne pajisje.</p> <p>Fluksimeter i integruar ne pajisje per flukse nga 1-15 Litra/minute</p> <p>Te jete i pajisur me display LCD ku shfaqen parametrat e CPAP.</p> <p>I pajisur me alarme per presionin e CPAP dhe %O2. I pajisur me sensor O2.</p> <p>Presioni i gazeve ne hyrje te pajisjes: 3.5-6 atm.</p> <p>Furnizim nga rrjeti AC 220V/50Hz dhe bateri e integruar per te garantuar funksionim per te</p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>pakten 4 ore.</p> <p><u>Lageshtues:</u></p> <p>Lageshtues i pershtatshem per t'u perdorur ne kombinim me njesine CPAP te pershkruar mesiper.</p> <p>Sistem lageshtimi me dhome uji (chamber).</p> <p>Kontroll i temperatures se gazit ne qarkun e pacientit nepermjet ngrohjes ne intervalin: 30-40°C</p> <p>Monitorim i temperatures se gazit nepermjet sensoreve te vendosur ne qarkun e pacientit.</p> <p>Lageshtia minimale e garantuar: >30mg/l</p> <p>Furnizim nga rrjeti AC 220V/50Hz.</p> <p><u>Aksesoret:</u></p> <p>Te perfshihen sensoret e temperatures se lageshtuesit</p> <p>Te perfshihet nje strukture metalike e levizshme me rrota ku do te montohen njesia CPAP dhe Lageshtuesi.</p> <p>Te perfshihen 10 qarqe pacienti neperdorimesh neonatal (10mm) me rezistenca te integruara te pershtatshem per t'u perdorur sebashku me njesine CPAP dhe lageshtuesin e mesiper.</p>
19	Dyshek Fototerapie	
		<p>Paisje per trajtimin fototerapik te te porsalindurit, lehtesisht e tansportueshme, teknologji LED e gjeneratorit te drites me fibra optike.</p> <p>Te jete i pajisur me dyshek me fibra-optike, me mbulesa mbeshjtjellese te bute, me sipërfaqe te emetimit te drites 25x30cm te lidhur me gjeneratorin e drites me kabell optik 1.3-1.5m</p> <p>Diapazoni i rrazatimit optik: 430-490nm me intensitet maksimal ne 450±10nm.</p> <p>Rrezatimi spektral rreth 50 μW/cm²/nm-1 (±25%);</p> <p>Gjeneratori i drites LED te jete lehtesisht i montueshem ne stativ.</p> <p>Te siguroje nje nivel zhurme nen 45dBA ne distance 1m.</p> <p>Te furnizohet me nje set prej 20 mbulesash mbeshjtjellese shume te buta per dyshekun fibro-optik.</p> <p>Te jete kompatibel per rrezatimin me rreze X.</p> <p>Ushqimi: AC: 230 V~ 50/60 Hz</p> <p>Paisja te jete e testuar dhe e certifikuar ne perputhje me direktivat e paisjeve mjekesore per pediatrie neonatale</p>
20	Fluksometer dhe perzieres gazrash Neonatal	
		<p>Perzieres gazesh Neonatal me fluksimeter te dyfishte</p> <p>Te jete per te pakten 2 gazra: O2 dhe Ajer</p> <p>Perqendrim i rregullueshem %O2 ne dalje: 21-100%</p> <p>2 Fluksimetra me interval: 1-15 Litra/Minute dhe 0.0-3.5 Litra/Minute. Saktesia: ±3%.</p> <p>Te perfshihet mekanizmi i montimit ne mur ose ne IV-Pole sebashku me tubat e presionit te gazeve.</p>
21	Laringoskop	
		<p>me bateri dhe lame McIntosh 2, 3, 4</p> <p>Te jete me doreze me bateri</p> <p>Te jete me llampa LED</p> <p>Te gjitha materialet te jene celik inoksi</p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

22	Laringoskop Pediatrik	
		Set laringoskopik neonatal me fiber optike dhe llampe LED
		Te perfshihen Lama McIntosh 00 (premature) dhe Miller 0, 1
		Te jete me doreze me bateri
		Te gjitha materialet te jene metalike te pa oksidueshme
23	Llambe Ngrohese per neonate (Radiant)	
		Sistem Ngrohesh dhe reanimimi per neonate
		I pajisur me rezistence ngrohese 0÷500W. Modalitet funksionimi Manual dhe Automatik (servo mode).
		Te kete ekran per afishimin e temperatures dhe parametrave te tjere
		Te afishoje Apgar – timer (kronometer)
		Sistem i pajisur me nje porte per sensor temperature me vendosje siperfaqesore (ne lekure).
		Te kete mundesi manuale dhe automatike te kontrollit te temperatures ose nepermjet sensorit te temperatures
		Lartesi e rregullueshme e shtratit ne te pakten 3 nivele
		<u>Modalitet Funksionimi Manual</u>
		Ne modalitet Manual Intensiteti i energjise ngrohese duhet te rregullohet manualisht nga operatori ne te pakten 20 nivele energjie nga 0-100%.
		<u>Modalitet Funksionimi Automatik</u>
		Ne modalitet Automatik (servo), te kontrollohet energjia ngrohese ne menyre automatike sipas temperatures se deshiruar per pacientin (setpoint) dhe sipas informacionit te marre nga sensori i temperatures (feedback).
		Intervali i rregullimit te temperatures: 30÷38°C me rezolucion 0.1°C.
		Monitorim i temperatures se pacientit ne intervalin: 30°C÷42°C. Saktesia: ±0.1°C.
		Te jete i pajisur me llambe ndricimi per perdoruesin
		Dimensionet e peraferta te platformes se pacientit: 460 x 640 mm ±20mm
		Platforma duhet te mundesoje vendosjen e kasetave X-ray duke mos levizur pacientin.
		Platforma e pacientit duhet te mundesoje pozicionim horizontal ne kendet 0° ±15°.
		Mundesi rotullimi te kokes se radiantit ±90° per te mundesuar vendosjen e pajisjeve te tjera (njese portative x-ray, njese fototerapie, etj.)
		Radianti te jete i pajisur me te pakten dy sirtare
		<u>Aksesoret e perfshire:</u>
		1x sonde temperature me shume perdorime.
		1x IV-pole per montim ne pjesen anesore te pajisjes.
		1x pole per montim shiringa infuzioni, perzjeres gazesh, etj.
		1x platforme me montim lateral per vendosjen e monitorit te pacientit apo njesise se reanimimit.
24	Llambe Ngrohese per neonate (Radiant) me njese reanimimi	
		Sistem Ngrohesh dhe reanimimi per neonate
		I pajisur me rezistence ngrohese 0÷500W. Modalitet funksionimi Manual dhe Automatik (servo mode).
		Te kete ekran per afishimin e temperatures dhe parametrave te tjere

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Te afishoje Apgar – timer (kronometer)</p> <p>Sistem i pajisur me nje porte per sensor temperature me vendosje siperfaqesore (ne lekure).</p> <p>Te kete mundesi manuale dhe automatike te kontrollit te temperatures ose nepermjet sensorit te temp</p> <p>Lartesi e rregullueshme e shtratit ne te pakten 3 nivele</p> <p><u>Modalitet Funksionimi Manual</u></p> <p>Ne modalitet Manual Intensiteti i energjise ngrohese duhet te rregullohet manualisht nga operatori ne te pakten 20 nivele energjie nga 0-100%.</p> <p><u>Modalitet Funksionimi Automatik</u></p> <p>Ne modalitet Automatik (servo), te kontrollohet energjia ngrohese ne menyre automatike sipas temperatures se deshiruar per pacientin (setpoint) dhe sipas informacionit te marre nga sensori i temperatures (feedback).</p> <p>Intervali i rregullimit te temperatures: 30÷38°C me rezolucion 0.1°C.</p> <p>Monitorim i temperatures se pacientit ne intervalin: 30°C÷42°C. Saktesia: ±0.1°C.</p> <p>Te jete i pajisur me llambe ndricimi per perdoruesin</p> <p>Dimensionet e peraferta te platformes se pacientit: 460 x 640 mm ±20mm</p> <p>Platforma duhet te mundesoje vendosjen e kasetave X-ray duke mos levizur pacientin.</p> <p>Platforma e pacientit duhet te mundesoje pozicionim horizontal ne kendet 0° ±15°.</p> <p>Mundesi rrotullimi te kokes se radiantit ±90° per te mundesuar vendosjen e pajisjeve te tjera (njesi portative x-ray, njesi fototerapie, etj.)</p> <p>Radianti te jete i pajisur me te pakten dy sirtare</p> <p><u>Njesia e Reanimimit:</u></p> <p>Njesi plotesisht pneumatike pa nevoje per ushqim AC apo bateri.</p> <p>Sistem monitorimi dhe kontrolli per presionin e inspирimit PIP. Vlera maksimale: 50cmH2O</p> <p>E pajisur me rregullator per vleren e PEEP</p> <p>Intervali i presionit te aplikuar: 0÷80 cm H2O</p> <p>I pajisur me rregullator per fluksin e Inspirimit: 0÷15 Litra/minute. Saktesia: ±2L/min</p> <p>Pajisur me perzieres te integruar AIR/O2. Rregullim i %O2 ne nivelin: 21-100%. Saktesia: ±5%</p> <p><u>Aksesoret e perfshire:</u></p> <p>1x sonde temperature me shume perdorime.</p> <p>1x set tuba presioni Ajer dhe O2</p> <p>1x IV-pole per montim ne pjesen anesore te pajisjes.</p> <p>1x pole per montim shiringa infuzioni, perzjeres gazesh, etj.</p> <p>1x platforme me montim lateral per vendosjen e monitorit te pacientit apo njesise se reanimimit.</p> <p>10x qarqe neonate (perfshire maska) per njesine e reanimimit.</p>
25	Mates transkutan per bilirubinen	
		<p>Per matje transkutane te bilirubines pa cpim (jo invazive)</p> <p>Te jete i pershtrateshem per te matur Bilirubinen ne neonate</p> <p>Diapazoni i matjes min: 0-20 mg/dl</p> <p>Perseritshmeria: ≤ ± 0,8mg/dl</p> <p>Sistemi te komandohet nga ekran me prekje ose butona</p> <p>Sistemi te kete mundesi te perdoren ne paciente menjehere pas lindjes.</p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Saktesia (gabimi): $\leq \pm 1.5\text{mg/dl}$</p> <p>Te jete I validuar nga studime klinike per rezultate te krahasueshme me testimet laboratorike te gjakut.</p> <p>Sistemi te funksionoje me bateri te rikarikueshme</p> <p>Bateria e karikuar te kete mundesi per te pakten 100 matje</p> <p>Sistemi te funksionoje pa kerkuar materiale konsumi per matje</p> <p>Perdorim i lehte dhe matje e shpejte</p>
26	Monitor Pacienti Neonatal	<p>Monitor Modular per ICU Neonate me:</p> <p>a) modul hemodinamik per ECG, RESP, SPO2, NIBP, TEMP, IBP .</p> <p>b) porte per modul CO2</p> <p><u>Karakteristikat:</u></p> <p>Format e valeve: Deri ne 8</p> <p>Ekran i sheshte me prekje (touchscreen) TFT/LCD min 12", rezolucion 800 x 600</p> <p>Komandimi i monitorit: Celes knob (i rregullueshem)</p> <p>Regjistrim i te dhenave grafike dhe parametrave: 120 ore</p> <p>Mundesi komunikimi ne rrjet (LAN)</p> <p>Moduli / Funksionet Hemodinamike</p> <p><u>ECG:</u></p> <p>EKG- 3/5 lead</p> <p>Diapazoni min 30-300 bpm. Saktesia ± 5 bpm.</p> <p>Mbrojtje dhe sinkronizim me defibrilatorin.</p> <p>Zbulim te segmentit –ST. Me algoritem per aritmi dhe pacemaker.</p> <p>Alarme vizuale dhe zanore.</p> <p><u>Respirim:</u></p> <p>Metoda: matje e impedences elektrike</p> <p>Diapazon: 5-120rpm (te rritur); 5-150rpm (porsalindur/femije)</p> <p>Saktesia : ± 5rpm. Alarme per rrezet e matjes.</p> <p><u>SpO2 (Saturimi i oksigjenit)</u></p> <p>Diapazon 1-100%. Saktesi ± 2 ne rrezet 70-100%.</p> <p><u>NIBP(Presioni i gjakut jo Invaziv)</u></p> <p>Metoda: Oshilometri Automatike</p> <p>Menyrat: manuale/automatike/vazhdueshme.</p> <p>Diapazoni: min 10-270mmHg. Saktesi ± 5mmHg.</p> <p>Tipi i matjes: sistolik, diastolik dhe mesatar.</p> <p>Mbrojtje ndaj presioneve te larta.</p> <p><u>Temperatura:</u></p> <p>2 kanale-Isonde per matjen e temperatures ne diapazonin: 10-45°C.</p> <p>Rezolucion: 0.1°C. Saktesia: ± 1°C.</p> <p>Pajisur me alarm per temperaturat jashte diapazonit te matjes.</p> <p><u>IBP (Presioni i gjakut invaziv)</u></p> <p>Mundesi matje me 2- kanale</p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Intervali i matjes: -40÷300 mmHg. Saktësia e matjes: ±5%.</p> <p><u>Aksesore:</u></p> <p>Konektor per EKG me 3-lead. Set 10x elektroda neonatale me nje perdorim.</p> <p>Manshete NIBP neonatale me shume perdorime.</p> <p>Sensor SpO2 neonatal me shume perdorime me kabell dhe konektor elektrik.</p> <p>Sonde temperature.</p> <p>Bateri e integruar e rikarikueshme per pune normale per 4 ore.</p> <p>Set Monitorimi per presionin invaziv (Kabell + 5x transducer njeperdorimesh)</p> <p>Ushqimi: Linje AC: 220V; 50Hz. – Ose nga Bateria e integruar</p>
27	Pajisje Fototerapie	<p>Njesi fototerapie me LED per trajtimin e foshnjeve te sapolindur. Lartesi e rregullueshme. Komande start dhe stop. Mundesi trajtimi te te porsalindurit ne menyre te lehte. Drite me intensitet te larte me disa nivele zgjedhjeje. Kendi horizontal i rregullueshem. Numerues i jetegjatesise se LED-it, konsum i ulet i energjise. Rrezatimi Optik UV me gjatesi vale: 460nm ±5nm.</p> <p>Rrezatim i rregullueshem ne intervalin e fuqise 25÷45 µw/cm2/nm.</p> <p>Pajisja duhet te furnizohet sebashku me mates (UV-meter) te nivelit te rrezatimit UV ne intervalin e gjatesise se valeve 400÷500nm dhe Rrezatim spektral: 1-100 µw/cm2/nm. Te perfshihet ne furnizim nje set syze UV per neonate.</p>
28	Modul Sedatimi	<p>Modul kompatibel me monitoret e makinave te anestezise (Artikulli Nr. 3)</p> <p>Per monitorimin e nivelit te thellesise se anestezise dhe dozimit nepermjet monitorimit te valeve cerebrale.</p> <p>Amplifikim dhe perpunim i sinjalit EEG per shfaqjen e nje trendi grafik ku monitorohet niveli i zgjimit/pergjumesise (sedatimit) te pacientit nepermjet nje indeksi numerik. Perdorim i sensoreve me disa elektroda per marrjen e sinjalit.</p> <p>Te perfshihen 10x sensore monitorimi Adult per cdo Modul Sedatimi</p>
29	Monitor Pacienti	<p style="text-align: center;">Public Health Sector</p> <p>Monitor Modular per ICU Adult me:</p> <p>a) modul hemodinamik per ECG, RESP, SPO2, NIBP, TEMP .</p> <p>b) porte per modul CO2</p> <p><u>Karakteristikat:</u></p> <p>Format e valeve: Deri ne 8</p> <p>Ekran i sheshte me prekje (touchscreen) TFT/LCD min 12”, rezolucion 800 x 600</p> <p>Komandimi i monitorit: Celes knob (i rregullueshem)</p> <p>Regjistrim i te dhenave grafike dhe parametrave: 120 ore</p> <p>Mundesi komunikimi ne rrjet (LAN)</p> <p>Moduli / Funksionet Hemodinamike</p> <p><u>ECG:</u></p> <p>EKG- 3/5 lead</p> <p>Diapazoni min 30-300 bpm. Saktësia ±5 bpm.</p> <p>Mbrojtje dhe sinkronizim me defibrilatorin.</p> <p>Zbulim te segmentit –ST. Me algoritem per aritmi dhe pacemaker.</p> <p>Alarme vizuale dhe zanore.</p> <p><u>Respirim:</u></p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Metoda: matje e impedences elektrike</p> <p>Diapazon: 5-120rpm (te rritur); 5-150rpm (porsalindur/femije)</p> <p>Saktesia : ±5rpm. Alarme per rrezen e matjes.</p> <p><u>SpO2 (Saturimi i oksigjenit)</u></p> <p>Diapazon 1-100%. Saktesi ±2 ne rrezen 70-100%.</p> <p><u>NIBP(Presioni i gjakut jo Invaziv)</u></p> <p>Metoda: Oshilometri Automatike</p> <p>Menyrat: manuale/automatike/vazhdueshme.</p> <p>Diapazoni: min 10-270mmHg. Saktesi ±5mmHg.</p> <p>Tipi i matjes: sistolik, diastolik dhe mesatar.</p> <p>Mbrojtje ndaj presioneve te larta.</p> <p><u>Temperatura:</u></p> <p>2 kanale-1sonde per matjen e temperatures ne diapazonin: 10-45°C.</p> <p>Rezolucion: 0.1°C. Saktesia: ±1°C.</p> <p>Pajisur me alarm per temperaturat jashte diapazonit te matjes.</p> <p><u>IBP (Presioni i gjakut invaziv)</u></p> <p>Mundesi matje me 2- kanale</p> <p>Intervali i matjes: -40÷300 mmHg. Saktesia e matjes: ±5%.</p> <p><u>Aksesore:</u></p> <p>Konektor per EKG me 3-lead. Set 10x elektroda me nje perdorim.</p> <p>Manshete NIBP Adult.</p> <p>Sensor SpO2 Adult me shume perdorime me kabell dhe konektor elektrik.</p> <p>Sonde temperature.</p> <p>Bateri e integruar e rikarikueshme per pune normale per 4 ore.</p> <p>Set Monitorimi per presionin invaziv (Kabell + 5x transducer njeperdorimesh)</p> <p>Ushqimi: Linje AC: 220V; 50Hz. – Ose nga Bateria e integruar</p>
30	Monitor Pacienti me kapnografi	<p>Monitor Modular per ICU Adult me:</p> <p>a) modul hemodinamik per ECG, RESP, SPO2, NIBP, TEMP, IBP .</p> <p>b) porte dhe modul CO2 i perfshire</p> <p><u>Karakteristikat:</u></p> <p>Format e valeve: Deri ne 8</p> <p>Ekran i sheshte me prekje (touchscreen) TFT/LCD min 12”, rezolucion 800 x 600</p> <p>Komandimi i monitorit: Celes knob (i rregullueshem)</p> <p>Regjistrim i te dhenave grafike dhe parametrave: 120 ore</p> <p>Mundesi komunikimi ne rrjet (LAN)</p> <p>Moduli / Funksionet Hemodinamike</p> <p><u>ECG:</u></p> <p>EKG- 3/5 lead</p> <p>Diapazoni min 30-300 bpm. Saktesia ±5 bpm.</p> <p>Mbrojtje dhe sinkronizim me defibrilatorin.</p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Zbulim te segmentit –ST. Me algoritem per aritmi dhe pacemaker.</p> <p>Alarme vizuale dhe zanore.</p> <p><u>Respirim:</u></p> <p>Metoda: matje e impedences elektrike</p> <p>Diapazon: 5-120rpm (te rritur); 5-150rpm (porsalindur/femije)</p> <p>Saktesia : ±5rpm. Alarme per rrezen e matjes.</p> <p><u>SpO2 (Saturimi i oksigjenit)</u></p> <p>Diapazon 1-100%. Saktesi ±2 ne rrezen 70-100%.</p> <p><u>NIBP(Presioni i gjakut jo Invaziv)</u></p> <p>Metoda: Oshilometri Automatike</p> <p>Menyrat: manuale/automatike/vazhdueshme.</p> <p>Diapazoni: min 10-270mmHg. Saktesi ±5mmHg.</p> <p>Tipi i matjes: sistolik, diastolik dhe mesatar.</p> <p>Mbrojtje ndaj presioneve te larta.</p> <p><u>Temperatura:</u></p> <p>2 kanale-1sonde per matjen e temperatures ne diapazonin: 10-45°C.</p> <p>Rezolucion: 0.1°C. Saktesia: ±1°C.</p> <p>Pajisur me alarm per temperaturat jashte diapazonit te matjes.</p> <p><u>IBP (Presioni i gjakut invaziv)</u></p> <p>Mundesi matje me 2- kanale</p> <p>Intervali i matjes: -40÷300 mmHg. Saktesia e matjes: ±5%.</p> <p><u>Aksesore:</u></p> <p>Konektor per EKG me 3-lead. Set 10x elektroda me nje perdorim.</p> <p>Manshete NIBP Adult.</p> <p>Sensor SpO2 Adult me shume perdorime me kabell dhe konektor elektrik.</p> <p>Sonde temperature.</p> <p>Bateri e integruar e rikarikueshme per pune normale per 4 ore.</p> <p>Set Monitorimi per presionin invaziv (Kabell + 5x transducer njepedorimesh)</p> <p>Ushqimi: Linje AC: 220V; 50Hz. – Ose nga Bateria e integruar</p> <p>Modul Monitorimi CO2</p> <p>Matje e nivelit te CO2 ne frymemarrjen e pacientit ne intervalin: 0÷99 mmHg .</p> <p>Saktesia e matjes: ±10%</p> <p>Set aksesore monitorimi per modulin e gazeve (10x linja monitorimi + 10x water trap)</p> <p>Te jete kompatibel me Artikujt Nr.15, Nr.16 dhe Nr.17</p>
31	Sistem mjekesor me krah per salla	
		<p>E fiksuar ne tavan</p> <p>Gjatesia e krahut horizontal jo me pak se 750mm</p> <p>Per perdorim ne dhomen e operacioneve, reanimacion,</p> <p>Kapaciteti ngarkues min 220 kg</p> <p>Dalje per gazra mjekesore; Oksigjen x 2 ,Vakum x 1, Ajer x 1, N2O x 1, AGSS x 1.</p> <p>Raft per pajisje 2 cp.</p>

Dokumentat Standarde të Tenderit

		Sirtare per pajisje 1 cp. Me dy shufra vertikale anesore per mbajtje pompash infuzioni etj. Input elektrik 220v 50-60HZ Rrotullimi 250 - 360 degrees Priza Schucko 8 cope Priza ekuipotenciale 8 cope Lidhje me rrjetin 1 cp
32	Sistem mjekesor mural per salla	
		I montueshem ne mur Siperfaqe e lyer me boje statike Me dalje te vecanta per gaz dhe elektricitet Daljet e gazit perfshijne gaz mjekesor ajer 2 cp, oksigjen 2 cp, N2O 1 cp, AGSS, rrjet me standardet gjermane. Priza elektrike schuko 6 cp, me standarde gjermane ose AFNOR
33	Pompe infuzioni	
		Portabel. Sistem baze me mikroprocesor Ushqimi; AC- 220V, 50Hz dhe bateri. Monitor digital per tregimin e vlerave. Infuzion KVO(per mbajtjen hapur te venes) Sistemi i infuzionit: PERISTALTIK Presioni i infuzionit i rregullueshem Memorizim it e dhenave ne rast nderprerje e energjise Ndryshim i parametrave te infuzionit pa nderprere procedure e infuzimit Bateri e integruar e rikarikueshme. Karikohet automatikisht gjate punes. Kalim automatik ne regjim baterie ne rast nderprerje te energjise Kohezgjatja e baterise ne regjim pune; deri ne 8 ore ne 125ml/h. Karakteristikat Fluksi : 0.1-1200 ml/ore Vellimi i infuzuar : 0.1-9999 ml me rritje prej 0.1 ml-1ml Koha e infuzionit: 1 s – 159 ore 59 minuta Shpejtesia e bolusit: I rregullueshen deri ne 1200 ml/ore Saktesia: ±5% KVO e rregullueshme 1 – 20.0 ml/ore Pajisur me modalitet kontrolli te ndryshueshem gradual ose te paracaktuar ne 3 nivele Pajisur me sistem dinamik per te sinjalizuar ndryshimin e presionit Alarme vizive dhe akustike per raste te ndryshme: Rastet: bateri e ulet, afrimi i mbarimit te infuzionit, rritje e presionit, fund infuzioni, fluks i ulet, bllokim i linjes, keqfunksionim i brendshem, ajer ne sistem, kapak i hapur. Te mundesoje integrimin e librarise se ilaceve per te pakten 100 ilace Numri eventeve te pakten 1500
34	Ventilator Pacienti	
		Karakteristika te pergjithshme: Ventilator per Adulte, Pediatrik dhe Neonate i montuar ne karrel me rrota. Perfshire lageshtues.

Dokumentat Standarde të Tenderit

I pajisur me ekran LCD me prekje (touchscreen) dhe ngjyra. Dimensioni minimal: 15".
Shfaqje simultane grafike ne ekran te minimalisht 4 forma vale, Presion, Fluks, Volum dhe nje Kurbe spirometrie (P-V, P-F, F-V)
Shfaqje numerike e parametrave te ventilimit: Volum Tidal, Frekuenca e Respirimit, raporti I:E, Presion Inspirimi, Presioni Maksimal, PEEP, Volumi/minute, Volumi i Ekspirimit, FiO2, etj.
I pajisur me sensor fluksi proksimal per neonate dhe sensor fluksi ekspirimi.
I pajisur me Nebulizator te integruar ne pajisje me kontroll kohe. Diametri mesatar aerodinamik i grimcave $3\mu\text{m}\pm 10\%$
I pajisur me bateri te brendshme per te garantuar funksionim per te pakten 30÷60 minuta
Monitorimi i FiO2 ne shkallen 10-100%. Sensor O2 me jetegjatesi te larte i cili nuk ka nevojte te zevendesohet.
Mundesi opsionale per monitorim CO2.
<u>Modalitetet e Ventilimit dhe procedurat e perfshira:</u>
VC, VC-SIMV, VS, PC, PC-SIMV, SIMV-PRVC, APRV, BILEVEL, Apnea BACKUP.
Te perfshihet modalitet ventilimi jo-invaziv NIV
Perzjeresin elektronik te gazeve per nje FiO2 nga 0.21 – 1.0 me rregullim te vazhdueshem
Procedure Ventilimi me 100%O2 per nje kohe te percaktuar
Procedure Ventilimi manual ne rast urgjence
Procedure Testimi i kapacitetit te pacientit per frymemarrje spontane
<u>Karakteristikat e Ventilimit (neonatal):</u>
Fluks i vazhdueshem i inkorporuar
Rregullim i fluksit deri ne 20 litra ne minute
Volumi Tidal Neonate: 2÷50mL (pesha minimale 0.5Kg).
Volumi Tidal Pediatrik-Adult: 20÷2000 mL. Saktesia: $\pm 10\%$. (kompensim automatik i humbjeve ne qark).
PEEP: 1÷50 cmH2O
Frekuenca e Respirimit: 3÷150bpm (ne varesi te modalitetit te ventilimit)
Raport I/E varibel dhe te invertueshem 1:9 deri ne 4:1
Kontroll te vecante per Ti: 0.1÷10 sekonda, me alarm
Trigger Fluksi dhe Presioni. 0.2÷9 Litra/h dhe (-10) ÷ (-0.25) cmH2O
Presioni i Inspirimit: 1÷98 cmH2O
Koha a Ekspirimit: 0.25÷29 sekonda
<u>Karakteristikat e Monitorimit:</u>
Fluksi i gazit: 0.1-30 Litra/min
Volumi Tidal: 0.5-1000ml
Presioni ne rruget e frymemarrjes: -20÷120 cmH2O
Volumi/minute: 0÷90 Litra/min
FiO2 ne shkallen 10-100%
Regjistrim i trendit te parametrave (kurba dhe vlera numerike) te ventilimit per te pakten 48 ore.
<u>Alarmet:</u>
Alarm i ulet/larte per %O2 te inspirimit
Alarm i ulet/larte per presionin e inspirimit
Alarm i ulet/larte per volumin tidal dhe volumin/minute

Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Alarm APNEA</p> <p>Detektim dhe Alarm per humbje te gazit ne qarkun e pacientit.</p> <p>Power Failure Alarm</p> <p><u>Aksesoret:</u></p> <p>Krah mekanik per fiksimin e qarkut te respirimit prane pacientit</p> <p>Mekanizem per montim lageshtuesi te jashtem.</p> <p><u>Lageshtuesi:</u></p> <p>Lageshtues i pershtatshem per t'u montuar ne shasine e ventilatorit neonatal te pershkruar mesiper.</p> <p>Sistem lageshtimi me dhome uji (chamber).</p> <p>Kontroll i temperatures se gazit ne qarkun e pacientit nepermjet ngrohjes</p> <p>Monitorim i temperatures se gazit nepermjet sensoreve te vendosur ne qarkun e pacientit.</p> <p>Furnizim nga rrjeti AC 220V/50Hz.</p> <p><u>Aksesoret:</u></p> <p>Te perfshihen 20 qarqe pacienti njeperdorimesh (10x neonatal dhe 10x adult) me rezistenca te integruara te pershtatshem per t'u perdorur sebashku me ventilatorin dhe lageshtuesin e mesiper.</p>
35	Panel per Reanimacionin Neonatal	
		<p>I montueshem ne mur</p> <p>Gjatesia jo me pak se 1200mm</p> <p>Siperfaqe e lyer me boje statike</p> <p>Me dalje te vecanta per gaz dhe elektricitet</p> <p>Daljet e gazit perfshijne gaz mjekesor oksigjen 2cp, ajer 1cp, vakum 1cp, rrjet, drite, Priza Schucko 4 cope, sistem lajmerim infermiere etj., me standarde gjermane ose AFNOR</p>
36	Nebulizator	
		<p>Nebulizator Profesional per perdorim spitalor</p> <p>Presion Max.: 350 kPa</p> <p>Niveli i zhurmës: 60 dBA</p> <p>Presion operativ: 0-130 kPa</p> <p>Sasia e ajrit të qarkulluar: 15l/min</p> <p>Do shoqerohet me aksesoret e meposhtem:</p> <p>Maska e hundës (polypropylene)</p> <p>Maska e gojës (polypropylene) me valvul (silikoni);</p> <p>Maskë për fëmijë dhe të rritur</p>

Shtojca11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

Mall: Kuađer		Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		



Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet: (sipas loteve dhe AK përfituese)

- ✓ **Lot 1: “Furnizim vendosje pajisje mobilimi spitalor” me fond limit 18,052,899 (tetëmbëdhjetë milion e pesëdhjetë e dy mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH;**

Nr.	Emërtimi	Njesia	Sasia totale	Sasia Spitali Korce	Sasia Spitali Sarande
1	Barrele Spitalore	cope	3	2	1
2	Dollap pacienti	cope	50	25	25
3	Komodine Pacienti	cope	80	45	35
4	Krevat Neonatal per femije te porsalindur	cope	10	10	0
5	Shtrat Pacienti	cope	80	45	35
6	Shtrat reanimacioni	cope	7	3	4
7	Shtrat Vizitash mjekesore	cope	8	8	0
8	Shtrat Ekzaminimi Gjinekologjik	cope	3	3	0
9	Shtrat Lindje Elektrik	cope	3	3	0

Lot 2: “Furnizim vendosje pajisje salle operatore” me fond limit 57,683,710 (pesëdhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dhjetë) lekë pa TVSH;

Dokumentat Standarde të Tenderit

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia totale	Sasia Spitali Korce	Sasia Spitali Sarande
1	Aspirator kirurgjikal	cope	6	3	3
2	Defibrilator	cope	2	1	1
3	Elektrobisturi	cope	5	2	3
4	Gjenerator Kirurgjikal	cope	1	1	0
5	Karrel Instrumentash kirurgjikale	cope	6	3	3
6	Komplet proktologjie	cope	1	0	1
7	Llambe Baktericidi	cope	6	3	3
8	Llampe Ekzaminimi	cope	6	3	3
9	Llampe Mobile	cope	8	5	3
10	Llampe Operatore	cope	5	2	3
11	Makine Anestezie (Set)	set	5	2	3
12	Mikroskop operator okulistik	cope	1	0	1
13	Sistem trapanacioni	cope	1	0	1
14	Tavoline Mayo	cope	3	3	0
15	Tavoline Operatore-Kirurgji e perhershme	cope	2	0	2
16	Tavoline Operatore-Ortopedike	cope	1	0	1
17	Tavoline Operatore- Obstetrike-Gjinekologjike	cope	2	2	0
18	C ARM	cope	1	0	1

Lot. 3: “Furnizim vendosje pajisje biomjekësore dhe pediatrike” me fond limit 57,587,785 (pesedhjetë e shtatë milion e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

Nr.	Loti 3 Pajisje biomjekësore dhe pajisje pediatrike	Njesia	Sasia totale	Sasia Spitali Korce	Sasia Spitali Sarande
1	Aparat Kolposkopie	cope	2	2	0
2	Aspirator per neonate	cope	3	3	0
3	Sistem Histeroskopie	cope	1	1	0
4	Peshore Dixhitale per bebe	cope	2	2	0
5	Puls oksimeter per femije	cope	5	5	0
6	Puls oksimeter per adult	cope	10	5	5
7	Inkubator per neonate me servo kontroll	cope	1	1	0

Dokumentat Standarde të Tenderit

8	Kardiotohograf	cope	3	3	0
9	FRH per rrahjet e zemres	cope	3	3	0
10	Eko obstetrike gjinekologjike	cope	1	1	0
11	Eko Portabel	cope	1	1	0
12	Panel gazrash mjekesore dopjo (per kokat krevateve)	cope	13	0	13
13	Panel gazrash mjekesore teke (per kokat krevateve)	cope	12	0	12
14	Ngrohes Intravenoz	cope	6	3	3
15	Panel per Reanimacionin Adult	cope	7	3	4
16	Shiringe elektrike	cope	9	6	3
17	Ambu per neonate	cope	5	5	0
18	Aparature CPAP per neonate me lageshtues	cope	1	1	0
19	Dyshek Fototerapie	cope	1	1	0
20	Fluksometer dhe perzieres gazrash Neonatal	cope	3	3	0
21	Laringoskop Adult	cope	3	2	1
22	Laringoskop Pediatrik	cope	2	2	0
23	Llambe Ngrohese per neonate (Radiant)	cope	2	2	0
24	Llambe Ngrohese per neonate (Radiant) me njesi reanimimi	cope	1	1	0
25	Mates transkutan per bilirubinen	cope	1	1	0
26	Monitor Pacienti Neonatal	cope	3	3	0
27	Pajisje Fototerapie	cope	2	2	0
28	Modul Sedatimi	cope	2	1	1
29	Monitor Pacienti	cope	7	3	4
30	Monitor Pacienti me kapnografi	cope	2	1	1
31	Sistem mjekesor me krah per salla	cope	5	2	3
32	Sistem mjekesor mural per salla	cope	5	2	3
33	Pompe infuzioni	cope	6	3	3
34	Ventilator Pacienti	cope	6	3	3
35	Panel per Reanimacionin Neonatal	cope	3	3	0
36	Nebulizator	cope	4	2	2

FONDET LIMIT TË SEJCILIT AK SIPAS LOTEVE:

- ✓ **Lot 1: “Furnizim vendosje pajisje mobilimi spitalor” me fond limit 18,052,899 (tetëmbëdhjetë milion e pesëdhjetë e dy mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH;**
 1. **Fond limit Sp. Korce- 10,873,266 lekë pa TVSH**
 2. **Fond limit Sp.Sarandë – 7,179,633 lekë pa TVSH**

- ✓ **Lot 2: “Furnizim vendosje pajisje salle operatore” me fond limit 57,683,710 (pesëdhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dhjetë) lekë pa TVSH;**
 1. **Fondi limit Sp.Korce- 18,262,050 lekë pa TVSH**
 2. **Fondi limit Sp.Sarandë- 39,421,660 lekë pa TVSH**

- ✓ **Lot. 3: “Furnizim vendosje pajisje biomjekësore dhe pediatrike” me fond limit 57,587,785 (pesëdhjetë e shtatë milion e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.**
 1. **Fondi limit Sp.Korce- 37,575,692 lekë pa TVSH**
 2. **Fondi limit Sp.Sarandë- 20,012,093 lekë pa TVSH**

Afatet e lëvrimit: Brenda 45 diteve nga data e lidhjes se kontrates.



Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>



Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt
< **Emri** >

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Dokumentat Standarde të Tenderit

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues*] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [*shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [*vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____

2. _____

3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit: _____

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Dokumentat Standarde të Tenderit

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyt e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*
Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*
Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME **Mallrat – Tender i Hapur**

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruarra me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave

Dokumentat Standarde të Tenderit

në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi, tarifrat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.

- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës **Public Health Sector**

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikat e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të

emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezultojnë një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i

ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës së shitesit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.

- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.
- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe pakëtuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe pakëtuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës.
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspekte shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimin.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.
- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuara në kontratë.
- 14.2 Në Autoritetin Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetin Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e riskut.

Neni 15: Siguracioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.

- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defekte ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.

18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.

19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.

19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.

19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.

19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i

verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.

- 22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim

duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..
- 29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

- 30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.
- 30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.

34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.

35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

Public Health Sector

36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA Mallrat – Procedurë e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimet të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: _____

5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.

5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____

Neni 6: Kushtet e Pagesës

6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vone që të vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.

7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:



Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____
2. Burimi i Financimit _____
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:



Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po

Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme


lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë
etj. pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

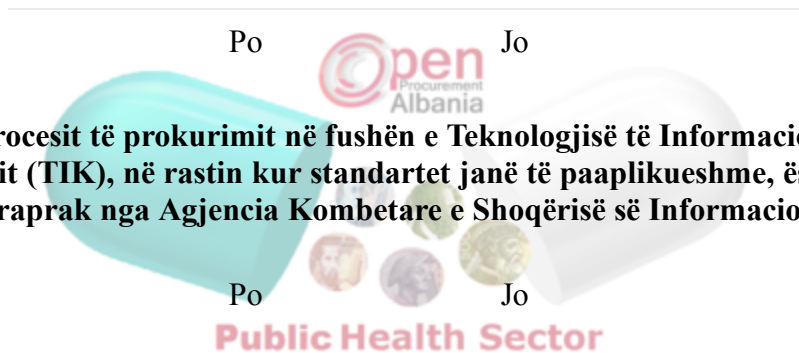

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //

Public Health Sector

Shtojca 18/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4.Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti



Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita)

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkëljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Dokumentat Standarde të Tenderit

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks: _____

E-mail: _____

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 21

**DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.


1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

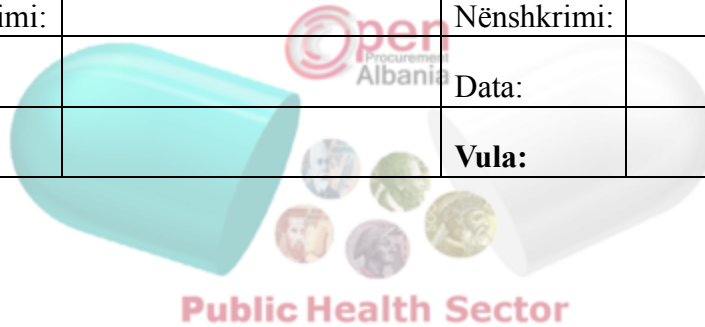

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor

duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
 Adresa _____
 Tel/Fax _____
 E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. **Lloji i procedurës:** _____

2. **Numri i Referencës:** _____

3. **Objekti i kontratës** _____

4. **Fondi limit** _____

5. **Arsyet e Anulimit:**

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. **Informacione shtesë**

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi _____


Public Health Sector