



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK**

**DOKUMENTAT STANDARDE**  
**TË PROCEDURËS SË HAPUR**  
**MALLRA**

**MINISTRIA E SHËNDETËSISË**  
**DHE MBROJTJES SOCIALE**

**Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje materiale të implantueshme për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj)”, i ndarë në lote.**

Fondi limit total për njësi (për të gjitha lotet): **16,233,241 (gjashtëmbëdhjetë milion e dyqind e tridhjetë e tre mijë e dyqind e dyzet e një) lekë pa TVSH**, ku fondi limit nënkupton totalin e çmimeve të përlogaritura për njësi për çdo artikull, referuar pikës 7.3 të Udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” të Agjencisë së Prokurimit Publik, i ndarë në lote si më poshtë:

1. Lot 1. **“Blerje katetere koronare diagnostike” me fond limit total për njësi 98,788 lekë pa TVSH**
2. Lot. 2 **“Blerje set per pergatitjen per koronarografie angioplastike” me fond limit total për njësi 566,863 lekë pa TVSH**
3. Lot. 3 **“Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit total për njësi 614,730 lekë pa TVSH**
4. Lot. 4 **“Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar” me fond limit total për njësi 2,522,540 lekë pa TVSH**
5. Lot. 5 **“Blerje stenta te pamedikuara” me fond limit total për njësi 292,400 lekë pa TVSH**
6. Lot. 6 **“Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me fond limit total për njësi 5,086,000 lekë pa TVSH**
7. Lot. 7 **“Blerje Stenta te medikuara” me fond limit total për njësi 712,950 lekë pa TVSH**
8. Lot. 8 **“Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta te medikuara për restenoze” me fond limit total për njësi 6,338,970 lekë pa TVSH**

**Fondi limi në total (Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër për të gjitha lotet): 158,529,940 (njëqind e pesëdhjetë e tetë milion e pesëqind e**

**njëzet e nëntë mijë e nëntëqind e dyzet) lekë pa TVSH, i ndarë në lote:**

1. *“Blerje katetere koronare diagnostike” me fond limit total 14,661,580 lekë pa TVSH;*
2. *“Blerje set per pergatitjen per koronarografine angioplastike” me fond limit total 23,368,350 lekë pa TVSH;*
3. *“Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit total 47,490,890 lekë pa TVSH;*
4. *“Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar” me fond limit total 13,413,600 lekë pa TVSH;*
5. *“Blerje stenta te pamedikuara” me fond limit total 11,871,500 lekë pa TVSH;*
6. *“Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me fond limit total 5,606,000 lekë pa TVSH;*
7. *“Blerje stenta te medikuara” me fond limit total 35,779,050 lekë pa TVSH;*
8. *“Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta të medikuara për restenoze” me fond limit total 6,338,970 lekë pa TVSH;*

**REF-67458-05-07-2018**

**Ref sipas loteve:**

- LOT1 - REF-67463-05-07-2018**  
**LOT2 - REF-67465-05-07-2018**  
**LOT3 - REF-67467-05-07-2018**  
**LOT4 - REF-67469-05-07-2018**  
**LOT5 - REF-67472-05-07-2018**  
**LOT6 - REF-67474-05-07-2018**  
**LOT7 - REF-67476-05-07-2018**  
**LOT8 - REF-67478-05-07-2018**



## I NJOFTIMI I KONTRATËS

### Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

#### 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Adresa Rruga e Kavajës, nr. 1001, Tiranë

Tel/Fax +355 4 2376178

E-mail \_\_\_\_\_

Adresa e Internetit [www.shendetesia.gov.al](http://www.shendetesia.gov.al)

#### 1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:



#### 1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

### Seksioni 2. Objekti i kontratës

#### 2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit

**REF-67458-05-07-2018**

**Ref sipas loteve:**

**LOT1 - REF-67463-05-07-2018**

**LOT2 - REF-67465-05-07-2018**

**LOT3 - REF-67467-05-07-2018**

**LOT4 - REF-67469-05-07-2018**

**LOT5 - REF-67472-05-07-2018**

**LOT6 - REF-67474-05-07-2018**

**LOT7 - REF-67476-05-07-2018**

**LOT8 - REF-67478-05-07-2018**

**2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”**

Blerje    Qira    Leasing    Blerje me këste    Një kombinim i tyre  
x

**2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër**

Po            x            Jo

**2.4 Lloji i Marreveshjes Kuadër**

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë            X

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po x Jo

**2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: 1 (një)** \_\_\_\_\_ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

<b>2.6</b>	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	<b>Nuk do të ketë rihapje të konkursit.</b> <b>Kontratat do të lidhen sipas kërkesave të AK, me operatorin ekonomik me të suksesshëm, i cili do të ofrojë cmimin me të ulët (totalin e cmimeve per njesi), per sejcilin lot.</b> <b>Dhënia e kontratave do të behet nga cdo AK palë në marrëveshje</b>
------------	--	--

**2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: OQB-MSHMS,**

**AK palë në MK: QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër ku:**

**1. QSUT- vlera e pritshme e kontratave total 125,020,450 lekë pa TVSH dhe sipas loteve:**

**Lot. 1 - 7,245,595 lekë pa TVSH**

**Lot. 2 – 16,479,185 lekë pa TVSH**

**Lot. 3 - 45,350,870 lekë pa TVSH**

**Lot. 4 – 9,023,300 lekë pa TVSH**

**Lot. 5 – 11,871,500 lekë pa TVSH**

**Lot. 6 – 1,558,000 lekë pa TVSH**

**Lot. 7- 33,492,000 lekë pa TVSH**

**Lot. 8 - 0**

**2. SU “Shefqet Ndroqi” - vlera e pritshme e kontratave total 30,814,690 lekë pa TVSH dhe sipas loteve:**

**Lot. 1 – 7,415,985 lekë pa TVSH**

**Lot. 2 – 4,612,365 lekë pa TVSH**

**Lot. 3- 1,852,020 lekë pa TVSH**

**Lot. 4 – 4,390,300 lekë pa TVSH**

**Lot. 5 – 0**

**Lot. 6 – 3,918,000 lekë pa TVSH**

**Lot. 7- 2,287,050 lekë pa TVSH**

**Lot. 8- 6,338,970 lekë pa TVSH**

**3. Spitali Rajonal Shkodër - vlera e pritshme e kontratave total 2,694,800 lekë pa TVSH dhe sipas loteve:**

**Lot. 1 - 0**

**Lot. 2 - 2,276,800 lekë pa TVSH**

**Lot. 3 – 288,000 lekë pa TVSH**

**Lot. 4 – 0**

**Lot. 5 – 0**

**Lot. 6- 130,000 lekë pa TVSH**

**Lot. 7- 0**

**Lot. 8 -0**



## **2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër**

1. Fondi limit: Fondi limit total për njësi për të gjitha lotet: **16,233,241 (gjashtëmbëdhjetë milion e dyqind e tridhjetë e tre mijë e dyqind e dyzet e një)**, (ku ky fond limit nënkupton totalin e çmimeve të përlogaritura për njësi për çdo artikull, referuar pikës 7.3 të Udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” të Agjencisë së Prokurimit Publik), i ndarë në lote:

- 1. Lot 1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me fond limit total për njësi 98,788 lekë pa TVSH**

2. Lot. 2 “Blerje set per pergatitjen per koronarografine angioplastike” me fond limit total për njësi 566,863 lekë pa TVSH
3. Lot. 3 “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit total për njësi 614,730 lekë pa TVSH
4. Lot. 4 “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar” me fond limit total për njësi 2,522,540 lekë pa TVSH
5. Lot. 5 “Blerje stenta te pamedikuara” me fond limit total për njësi 292,400 lekë pa TVSH
6. Lot. 6 “Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me fond limit total për njësi 5,086,000 lekë pa TVSH
7. Lot. 7 “Blerje Stenta te medikuara” me fond limit total për njësi 712,950 lekë pa TVSH
8. Lot. 8 “Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta te medikuara për restenoze” me fond limit total për njësi 6,338,970 lekë pa TVSH

1/1 Fondi limit në total (vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër për të gjitha lotet): 158,529,940 (njëqind e pesëdhjetë e tetë milion e pesëqind e njëzet e nëntë mijë e nëntëqind e dyzet) lekë pa TVSH i ndarë në lote:

1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me fond limit total 14,661,580 lekë pa TVSH;
2. “Blerje set per pergatitjen per koronarografine angioplastike” me fond limit total 23,368,350 lekë pa TVSH;
3. “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit total 47,490,890 lekë pa TVSH;
4. “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar” me fond limit total 13,413,600 lekë pa TVSH;
5. “Blerje stenta te pamedikuara” me fond limit total 11,871,500 lekë pa TVSH;
6. “Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me fond limit total 5,606,000 lekë pa TVSH;
7. “Blerje stenta te medikuara” me fond limit total 35,779,050 lekë pa TVSH;
8. “Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta të medikuara për restenoze” me fond limit total 6,338,970 lekë pa TVSH;

2. Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote

## 2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //


**2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër 12 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër për sejcilin lot**

<b>Kohëzgjatja në muaj: 12 ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër(jo më shumë se (4) vjet)</b> <b>Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv)</b> <b>Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)</b>
--

**2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:  
QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër**

**2.11 Ndarja në LOTE:**

Nëse po,

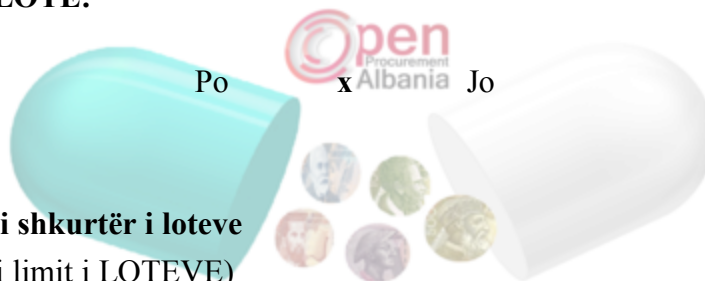

**2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve**

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

- Lot 1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me fond limit total për njësi 98,788 lekë pa TVSH
- Lot. 2 “Blerje set per pergatitjen per koronarografine angioplastike” me fond limit total për njësi 566,863 lekë pa TVSH
- Lot. 3 “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit total për njësi 614,730 lekë pa TVSH
- Lot. 4 “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuara” me fond limit total për njësi 2,522,540 lekë pa TVSH
- Lot. 5 “Blerje stenta te pamedikuara” me fond limit total për njësi 292,400 lekë pa TVSH
- Lot. 6 “Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me fond limit total për njësi 5,086,000 lekë pa TVSH
- Lot. 7 “Blerje Stenta te medikuara” me fond limit total për njësi 712,950 lekë pa TVSH
- Lot. 8 “Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta te medikuara për restenoze” me fond limit total për njësi 6,338,970 lekë pa TVSH

**Fondi limit në total (vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër) 158,529,940 (njëqind e pesëdhjetë e tetë milion e pesëqind e njëzet e nëntë mijë e nëntëqind e dyzet) lekë pa TVSH, i ndarë në lote:**

1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me fond limit total 14,661,580 lekë pa TVSH;

## Dokumentat Standarde të Tenderit

2. “Blerje set per pergatitjen per koronarografine angioplastike” me fond limit total 23,368,350 lekë pa TVSH;
3. “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit total 47,490,890 lekë pa TVSH;
4. “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar” me fond limit total 13,413,600 lekë pa TVSH;
5. “Blerje stenta te pamedikuara” me fond limit total 11,871,500 lekë pa TVSH;
6. “Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me fond limit total 5,606,000 lekë pa TVSH;
7. “Blerje stenta te medikuara” me fond limit total 35,779,050 lekë pa TVSH;
8. “Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta të medikuara për restenoze” me fond limit total 6,338,970 lekë pa TVSH;

**Një Ofertues mund të aplikojë për një lot, disa lote, ose të gjitha lotet. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.**

### 2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në

### 2.14 Do të pranohen variantet:

Po

Jo

Public Health Sector

#### 2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po

Jo

x

**Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: \_\_\_\_\_**

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po

Jo

### Shenime te tjera

---

---

---



**2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po Jo x

**2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po Jo x

### **Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik**

**3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.**

**3.2 Sigurimi i Ofertës<sup>1</sup>:** (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është \_\_\_\_\_ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ Lekë

Loti 2 \_\_\_\_\_ Lekë

### **Seksioni 4 Procedura**

**4.1 Lloji i procedurës: E Hapur**

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po Jo x

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

#### 4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **çmimi më i ulët** (*totali i cmimeve për njësi më i ulët*) **X** për sejcilin lot

**Marrëveshja Kuadër do të lidhet sipas cmimeve për njësi për sejcilin lot.**

- **Totali i cmimeve për njësi nuk duhet të kalojë fondin limit total për njësi për sejcilin lot.**
- **Totali i cmimeve sipas sasive të parashikuara për sejcilin lot, nuk duhet të kalojë fondin limit në total (vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër) për sejcilin lot.**
- **Gjithashtu, në hartimin e ofertës, nga OE duhet të merren në konsideratë fondet limit të parashikuara për sejcilin AK sipas sasive të pritshme për sejcilin lot (të përcaktuara në pikën 2.7 të këtyre DST), të cilat nuk duhet të tejkalohen.**

**Në rast të kundërt oferta do të refuzohet.**

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

*Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së cmimeve.*

*Ose*

**B) oferta ekonomikisht më e favorshme**

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

#### 4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **01/06/2018** (*dd/mm/vvvv*) Ora: **10 : 00** [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

Vendi: \_\_\_\_\_

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)**

**4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

Data: **01/06/2018** (dd/mm/vvvv) Ora: 10 : 00 [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

Vendi: \_\_\_\_\_

**Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.**

**4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150** (e shprehur në ditë)


**4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

Shqip                        Anglisht  
Tjetër            \_\_\_\_\_

**Seksioni 5 Informacione plotësuese**

**5.1 Dokumenta me pagesë** (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Nëse Po

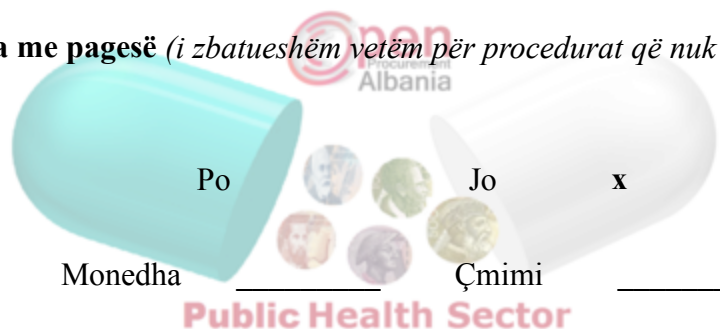

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

**5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi    **09 /05/2018**

**Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri                                   Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale  
Adresa                                Rruga e Kavajës Nr 1001 Tiranë  
Tel/Fax                               +355 4 2376178  
E-mail                                 \_\_\_\_\_  
Faqja ne Internet                 www.shendetesia.gov.al

**2. Lloji i procedurës se prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike- mallra**

**3. Numri i referencës së procedurës:**

**REF-67458-05-07-2018**

**Ref sipas loteve:**

**LOT1 - REF-67463-05-07-2018**

**LOT2 - REF-67465-05-07-2018**

**LOT3 - REF-67467-05-07-2018**

**LOT4 - REF-67469-05-07-2018**

**LOT5 - REF-67472-05-07-2018**

**LOT6 - REF-67474-05-07-2018**

**LOT7 - REF-67476-05-07-2018**

**LOT8 - REF-67478-05-07-2018**

**4.Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje materiale të implantueshme për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj)” i ndarë në lote.**

5. Fondi limit total për njësi (për të gjitha lotet): **16,233,241 (gjashtëmbëdhjetë milion e dyqind e tridhjetë e tre mijë e dyqind e dyzet e një) lekë pa TVSH**, ku fondi limit nënkupton totalin e çmimeve të përlogaritura për njësi për çdo artikull, referuar pikës 7.3 të Udhëzimit nr.

6, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” të Agjencisë së Prokurimit Publik, i ndarë në lote si më poshtë:

Lot 1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me fond limit total për njësi 98,788 lekë pa TVSH

Lot. 2 “Blerje set per pergatitjen per koronarografine angioplastike” me fond limit total për njësi 566,863 lekë pa TVSH

Lot. 3 “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit total për njësi 614,730 lekë pa TVSH



Lot. 4 “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar” me fond limit total për njësi 2,522,540 lekë pa TVSH

Lot. 5 “Blerje stenta te pamedikuara” me fond limit total për njësi 292,400 lekë pa TVSH

Lot. 6 “Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me fond limit total për njësi 5,086,000 lekë pa TVSH

Lot. 7 “Blerje Stenta te medikuara” me fond limit total për njësi 712,950 lekë pa TVSH

Lot. 8 “Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta te medikuara për restenoze” me fond limit total për njësi 6,338,970 lekë pa TVSH

**Fondi limi në total (Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër për të gjitha lotet): 158,529,940 (njëqind e pesëdhjetë e tetë milion e pesëqind e njëzet e nëntë mijë e nëntëqind e dyzet) lekë pa TVSH, i ndarë në lote:**

1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me fond limit total 14,661,580 lekë pa TVSH;
2. “Blerje set per pergatitjen per koronarografine angioplastike” me fond limit total 23,368,350 lekë pa TVSH;
3. “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit total 47,490,890 lekë pa TVSH;
4. “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar” me fond limit total 13,413,600 lekë pa TVSH;
5. “Blerje stenta te pamedikuara” me fond limit total 11,871,500 lekë pa TVSH;
6. “Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me fond limit total 5,606,000 lekë pa TVSH;
7. “Blerje stenta te medikuara” me fond limit total 35,779,050 lekë pa TVSH;
8. “Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta të medikuara për restenoze” me fond limit total 6,338,970 lekë pa TVSH;

**6.Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga data e nënshkrimit të marrëveshjes kuadër (për sejcilin lot).**

**7.Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 01/06/2018(dd/mm/vvvv) Ora: 10:00 [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)**

**8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 01/06/2018(dd/mm/vvvv) Ora: 10: 00 [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)**

**9. Lista e Autoriteteve Kontraktore palë të Marrëveshjes Kuadër: QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër**

## II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

### Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
- 1.5 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
- a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
- b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.
- c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.
- ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
- Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.
- 1.6 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për

furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit \_.

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN  
KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv  
\_\_\_\_\_ orës \_\_\_\_\_“**

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

## **Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike**

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasisë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4 Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare
- b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

## 2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëminë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

## 2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

### Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

#### 3.1 Kriteret e përzgjedhjes

**(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar për lot. X**

**Marrëveshja Kuadër do të lidhet sipas çmimeve për njësi për sejcilin lot.**

- **Totali i çmimeve për njësi nuk duhet të kalojë fondin limit total për njësi për sejcilin lot.**
- **Totali i çmimeve sipas sasive të parashikuara për sejcilin lot, nuk duhet të kalojë fondin limit në total (vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër) për sejcilin lot.**
- **Gjithashtu, në hartimin e ofertës, nga OE duhet të merren në konsideratë fondet limit të parashikuara për sejcilin AK sipas sasive të pritshme për sejcilin lot (të**



**përcaktuara në pikën 2.7 të këtyre DST), të cilat nuk duhet të tejkalohen.  
Në rast të kundërt oferta do të refuzohet.**

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

*Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes se çmimeve.*

**(Opsioni 2)** Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = Vmin k1 \times Pmaxk1 / Ok1$$

Pk1 _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
Vmin k1	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
Pmaxk1	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

**Sqarim:** Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy

opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

### **3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra**

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se  $\pm 2\%$  e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

### **3.3 Ofertat anomalisht të ulëta**

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të

ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

$M_O$  – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

$Z_M$  – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots + O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

**Vlera e Ofertës që vlerësohet <math>Z\_M</math>..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët**

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

#### **Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës**

##### **4.1 Njoftimi i fituesit**

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

##### **4.2 Sigurimi i kontratës**

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:  
i. garanci bankare

- ii. garanci sigurimi

**Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.**

#### 4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

**Shënim:** Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

### III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT: \_\_\_\_\_

- Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike
- Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje
- Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër
- Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës
- Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial
- Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
- Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit
- Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme
- Shtojca 9: Kriteret e Përgjithshme të Pranimi/Kualifikimit
- Shtojca 10: Specifikimet teknike
- Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit
- Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit
- Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit
- Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër
- Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës
- Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar
- Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike
- Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës
- Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor
- Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anullimit



Dokumentat standarde të tenderit

**Shtojca 1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

**FORMULARI I OFERTËS**

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote**

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH;

**Lot 1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me fond limit total për njësi 98,788 lekë pa TVSH**

Nr	Artikulli/ Specifikime teknike	Njesia	Sasia totale e Parashikuar	Cmimi/nj esi	Vlera e Pritshme (Cmim Njesi x Sasi)	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
----	--------------------------------	--------	----------------------------	--------------	--------------------------------------	--------------------	-------------------	-------

## Dokumentat Standarde të Tenderit

1	Angiokit containing: (Judkins left and right 6F – 4.0 catheter (100cm), and 6F normal sheeth introducer with mini-guide wire) Komplet angiografie qe permban: (kateter i majte dhe djathte Judkins 6 F-4.0 (100 cm), dhe introduktor 6 F normal me mini guide shoqeruese)	copë	250					
2	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 3.0	copë	100					
3	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 3.5	copë	250					
4	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 4.0	copë	80					
5	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 4.5	copë	40					
6	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 5.0	copë	20					
7	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 3.0	copë	270					
8	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 3.5	copë	350					
9	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 4.0	copë	2,800					
10	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 4.5	copë	200					
11	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 5.0	copë	100					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

12	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6_E</u> , 6.0	copë	20					
13	Catheter multipurpose Cournand technique A-2 (100 cm) (Kateter multifunksional Cournand) <u>6_E</u> ,	copë	5					
14	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5_E</u> , 3.0	copë	30					
15	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5_E</u> , 3.5	copë	30					
16	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5_E</u> , 4.0	copë	380					
17	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5_E</u> , 4.5	copë	55					
18	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5_E</u> , 5.0	copë	20					
19	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6_E</u> , 3.0	copë	30					
20	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6_E</u> , 3.5	copë	100					
21	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6_E</u> , 4.0	copë	2,800					
22	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6_E</u> , 4.5	copë	30					
23	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6_E</u> , 5.0	copë	50					



## Dokumentat Standarde të Tenderit

24	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6_E</u> , 6.0	copë	20					
25	Catheter ventricular angled Pigtail (110 cm) (Kateter ventrikular, Pigtail te kendezuar (110cm)) 6 F, 145* 6 SH	copë	400					
26	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>5_E</u> , AL I	copë	10					
27	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>5_E</u> , AL II	copë	10					
28	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>5_E</u> , AL III	copë	10					
29	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>6_E</u> , AL I	copë	45					
30	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>6_E</u> , AL II	copë	40					
31	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>6_E</u> , AL III	copë	25					
32	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>5_E</u> , AR I	copë	10					
33	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>5_E</u> , AR II	copë	10					
34	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>6_E</u> , AR I	copë	50					
35	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>6_E</u> , AR II	copë	40					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

36	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.0	copë	50					
37	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.5	copë	150					
38	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.0	copë	30					
39	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.5	copë	20					
40	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 5.0	copë	10					
41	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AL I	copë	10					
42	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AL II	copë	10					
43	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AL III	copë	10					
44	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.0	copë	20					
45	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.5	copë	20					
46	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.0	copë	150					
47	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.5	copë	20					
48	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 5.0	copë	10					
49	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AR I	copë	10					
50	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AR II	copë	10					

Dokumentat Standarde të Tenderit

51	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>6 F</u>	copë	250					
52	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>5 F</u>	copë	100					
53	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>4 F</u>	copë	50					
54	Catheter IMA (internal mammary) (100 cm) (Kateter te a. mamare (100cm) <u>6 F</u>	copë	100					
55	Catheter IMA (internal mammary) (100 cm) (Kateter te a. mamare (100cm) <u>5 F</u>	copë	20					
56	Catheter LCB (Left Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare sinister) (100 cm) <u>6 F</u>	copë	35					
57	Catheter LCB (Left Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare sinister) (100 cm) <u>5 F</u>	copë	20					
58	Catheter RCB (Right Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare dexter) (100 cm) <u>6 F</u>	copë	35					
59	Catheter RCB (Right Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare dexter) (100 cm) <u>5 F</u>	copë	20					
60	Catheter Right Coronary Technique (100cm) 6 FR - 3 DRC	copë	30					
61	Catheter Right Coronary Technique (100cm) 6 FR - 3 SRC	copë	30					
62	Flow directed balloon catheter multipurpose (100-110 cm) (Kateter me ballon drejtues multifunksional) <u>6 F</u>	copë	5					
63	PTFE-coated J curve - J radius 3 mm exchange guidewires (Maje ne forme J e veshur me PTFE me rreze 3 mm) .035 in 260 cm 7 cm	copë	3,000					
64	PTFE-coated J curve - J radius 3 mm exchange guidewires (Maje ne forme J e veshur me PTFE me rreze 3 mm) .038 in 260 cm 7 cm	copë	1,205					

Dokumentat Standarde të Tenderit

65	Diagnostic guidewie - PTFE-coated J curve -J radius 3mm ,Amplatz extra Stiff,0.035,260cm	copë	250					
66	Diagnostic Hydrophilic guidewire 0.035(0.89mm) curve -J radius 3cm,180-200cm	copë	250					
67	PTFE-coated straight flexible tip - (Maje e drejte e veshur me PTFE ) .035 in 260 cm 7 cm	copë	15					
68	PTFE-coated straight flexible tip - (Maje e drejte e veshur me PTFE ) .038 in 260 cm 7 cm	copë	15					
<b>SHUMA I. CMIMI NETO (Totali i crimeve per njësi)</b>								
<b>TVSH (%) (mbi Shumen I.)</b>								
<b>SHUMA II TOTALI ME TVSH (Shuma I + TVSH % mbi shumën I)</b>								
<b>SHUMA III CMIMI NETO (Totali i vleres se pritshme)</b>								
<b>TVSH (%) mbi Shumën III.</b>								
<b>SHUMA IV TOTALI ME TVSH (Shuma III+TVSH mbi shumën III)</b>								

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lekë ( kërkuar në dokumentat e tenderit )

**Shtojca 1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

**FORMULARI I OFERTËS**

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote**

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH;

**Lot. 2 “Blerje set per pergatitjen per koronarografie angioplastike” me fond limit total për njësi 566,863 lekë pa TVSH**

Nr	Artikulli/ Specifikime teknike	Njesia	Sasia totale e Parashikuar	Cmimi/nj esi	Vlera e Pritshme (Cmim Njesi x Sasi)	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
----	--------------------------------	--------	----------------------------	--------------	--------------------------------------	--------------------	-------------------	-------

Dokumentat Standarde të Tenderit

1	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 5 F	copë	40					
2	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 6 F	copë	3,200					
3	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 7 F	copë	1,805					
4	Midlelength sheath introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi mesatare pa obturator (me gide te vogel) 6 F	copë	60					
5	Midlelength sheath introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi mesatare pa obturator (me gide te vogel) 7 F	copë	160					
6	Extra long sheath 45-90 cm introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi te gjate 45-90 cm pa obturator (me guide te vogel) 6 F	copë	40					
7	Extra long sheath 45-90 cm introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi te gjate 45-90 cm pa obturator (me guide te vogel) 7 F	copë	85					
8	High-pressure 1000 PSI Catheter extensions (connector) male-female Katetere zgjatues me presion te larte (bashkues mashkull-femer) Ø interior 2,15 75 cm	copë	40					
9	Pressure tubing made of polyethylene Male-female, length 100 cm, tubing diameter 1 x 2 mm (Tuba presioni me material polietileni mashkull-femer, gjatesi 100 cm, diameter tubi 1x2mm)	copë	2,040					
10	Manifolds (female luer lock to distal rotating adapter) triple high-pressure manifold OFF (3 ways) Tre-rrugesht me dalje femer te pershtatur per pjesen distale te kateterit Tre-rrugesht me presion te larte OFF (3 rruge) 3 female right "off" 3 femra djathtas "off"	copë	3,700					

Dokumentat Standarde të Tenderit

11	Stopcocks 3 ports (2 female-1 male) Rubinet 3 portesh (2 femra-1 mashkull) a) low pressure stopcocks 50 psi (rubinet me presion te ulet)	copë	70					
12	One piece needles (Age teke) 18 G 7.6 cm	copë	150					
13	Disposable syringes for Medrad inject. Mark V Pro Vis: 150 ml (Shiringa nje perdorimeshe per injektim kontrasti Medrad Mark V Pro Vis: 150 ml)	copë	210					
14	Disposable syringes for Medrad inject. Mark V Pro Vis: 200 ml (Shiringa nje perdorimeshe per injektim kontrasti Medrad Mark V Pro Vis: 200 ml)	copë	300					
15	Spectraline disposable syringes for connection with manifolds and catheters 10-12 ml blue, security stop at 1.0 ml, rubber gasket for smooth plunger action with double seal crystal clear barrel without lateral finger rings (no finger grip) - 50% of quantity pieces and with lateral finger rings (with finger grip) - 50% of quantity pieces) (Shiringa nje perdorimeshme te vijezuara per lidhjen me tre rrugeshe dhe me kateter me piston e tape te qendrushme per injektim kontrasti, 10-12 ml blue, me ndalesa sigurie tek kufiri 1 ml, ndaresa gome ne fund te pistonit per nje levizje me te lehte te pistonit me izolim te dyfishte, material i tejdukshem dhe pa kapse anesore per gishtat ne 50% te sasise dhe me kapse anesore per gishtat ne 50% te sasise)	copë	5,400					
16	Angiodyn image intensifier cover with elastic fixation 140 cm (Qese plastmasi per veshjen e llambes) 140 cm	copë	70					
17	Angiography pack - Reinforced Angio Drape 240 x 300 cm with two sided PE clear film (waterproof, high absorption ability), - Tray 30x30x5 cm, - Cup 60 m, - Bowl 500 ml, - Table Cover 140x150 cm, - Gauze 10x10 cm, - Protective cover 80x110 cm, - Image intensifier cover with elastic fixation, - Sponge stick, - Coats XL x 2, - Scalpel	copë	5,600					
18	Monitoring Set for pressure transducer adapted for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë	10					

Dokumentat Standarde të Tenderit

19	Cable for pressure transducer adapted for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë	1					
20	Cable for ECG monitoring adapted for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë	1					
21	Hemostasis Y-connector: 50% of quantity with pressure monitoring line (no side arm), push click-20%, push pull-80% 50% of quantity without pressure monitoring line (no side arm), push click-20%, push pull-7, screw type-10% ( Lidhes tip Y per hemostaze: 50% te sasise me linje anesore per monitorimin e presionit, shty kercit 20%, shty terhiq 80%. 50% tjetet te sasise pa linje anesore per monitorimin e presionit, shty kercit 20%, shty -terhiq 70%, shtrengim me filetimit 10%)	copë	1,500					
22	High pressure Angiographic Syring for single use for Medrad Injector Mark–Stellant (2x200 ml Syring;1 x 60” T-Connector and Prime Tube;2 x Spikes) (Set me shiringa Angiografike me presion te larte per perdorim unik per Injektor Medrad Mark–Stellant qe permban 2x200 ml Syring, 1 x 60” T-Connector and Prime Tube, 2 x Spikes)	copë	1,000					
23	Pressure Transducer for Cath-Lab Model Artis Zee Floor-Siemens (percjelles presioni per aparatin Siemens Artis Zee)	copë	5					
24	Transducer (diafragm) dome for use with pressure transducer for Cath-Lab Model Arsis Zee Floor Siemens (Diafragm dome per percjellesin e presionit e pershtatur per aparatin Simes-Artis Zee)	copë	10					
25	Monitoring set for pressure transducer adapted for Cath-Lab Model Arsis Zee Floor -Siemens (Set monitorimi per percjellesin e presionit e pershtatshme per aparatin Simes-Artis Zee)	copë	5					
26	Monitoring Set for pressure transducer adapted for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë	20					
27	Cable for pressure transducer adapted for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë	1					



Dokumentat Standarde të Tenderit

28	Cable for ECG monitoring adapted for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë	1					
29	Cable for ECG monitoring adapted for Siemens Angio-CT Model Somatom definition AS	copë	1					
30	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 6 F, (sheath length 10-13 cm, guidewire and needle ) Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 11 cm, guide dhe age)	copë	120					
31	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 7 F, (sheath length 10-13 cm, guidewire and needle ) Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 11 cm, guide dhe age)	copë	65					
32	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 6 F (sheath length 16-23, guidewire and needle) Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 16-23 cm, guide dhe age)	copë	120					
33	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 7 F (sheath length 16-23, guidewire and needle) Komplet sheath transradial me dilatator 7 F (gjatesi sheath 16-23 cm, guide dhe age)	copë	65					
34	Contrast infusion set with hand syringe during angiography (set per infuzionin e kontrastit me shiringe dore gjate angiografise)	copë	3,000					
35	Kit radial - Radial sheath introducer 5 Fr, 10- 13cm, with mini-guide wire and needle, (Sheath radial 5Fr me gjatesi 10 -13 cm, gide te vogel dhe age)	copë	20					
36	Kit radial - Radial sheath introducer 6Fr, 10 - 13cm, with mini-guide wire and needle (Sheath radial 6Fr, me gjatesi 10 -13 cm, gide te vogel dhe age)	copë	650					
37	Kit Radial - Radial sheath introducer 6 Fr, 20 - 25cm, with mini-guide wire and needle (Sheath radial 6 Fr, me gjatesi 20-25 cm, gide te vogel dhe age)	copë	5					
38	Radial Artery Compression Device (Paisje per hemostaze te arteries radiale)	copë	10					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

	<b>SHUMA I.</b> <b>CMIMI NETO (Totali i cmimeve per njësi)</b>		
	<b>TVSH (%) (mbi Shumen I.)</b>		
	<b>SHUMA II</b> <b>TOTALI ME TVSH (Shuma I + TVSH % mbi shumën I)</b>		
	<b>SHUMA III</b> <b>CMIMI NETO (Totali i vleres se pritshme)</b>		
	<b>TVSH (%) mbi Shumën III.</b>		
	<b>SHUMA IV</b> <b>TOTALI ME TVSH (Shuma III+TVSH mbi shumën III)</b>		

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lekë ( kërkuar në dokumentat e tenderit )



**Shtojca 1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

**FORMULARI I OFERTËS**

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote**

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

**Public Health Sector**

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH;

**Lot. 3 “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit total për njësi 614,730 lekë pa TVSH**

Dokumentat Standarde të Tenderit

Nr	Artikulli/ Specifikime teknike	Njesia	Sasia totale e Parashikuar	Cmimi/nj esi	Vlera e Pritshme (Cmim Njesi x Sasi)	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
1	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.25 mm, 6-7 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	1					
2	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.25 mm, 9-10 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	1					
3	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.5 mm, 6-7 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	1					
4	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.5 mm, 9-10 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	1					
5	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,12-13mm	copë	1					
6	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,14-16mm	copë	1					
7	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 2 mm, 6-7 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	1					
8	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 2 mm, 9-10 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	1					
9	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,20 mm	copë	1					
10	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,12-13 mm	copë	1					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

11	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,14-16 mm	copë	1					
12	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,20 mm	copë	1					
13	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 2.5 mm, 6-7 mm -(ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	1					
14	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 9-10 mm -(ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	1					
15	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,12-13 mm	copë	1					
16	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,20 mm	copë	1					
17	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,12-13 mm	copë	1					
18	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,14-16 mm	copë	1					
19	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,14-16 mm	copë	1					
20	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,20 mm	copë	1					
21	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,12-13 mm	copë	1					
22	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,14-16 mm	copë	1					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

23	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,20 mm	copë	1				
24	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 4 mm,12-13 mm	copë	1				
25	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 4 mm,14-16 mm	copë	1				
26	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 4 mm,20 mm	copë	1				
27	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 12-13 mm -	copë	121				
28	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 14-16 mm -	copë	121				
29	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 20 mm	copë	20				
30	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 12-13 mm -	copë	210				
31	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 14-16 mm -	copë	100				
32	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 20 mm -	copë	100				
33	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 12-13 mm -	copë	100				
34	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 14-16 mm -	copë	200				

Dokumentat Standarde të Tenderit

35	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 20 mm -	copë	160					
36	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 12-13 mm -	copë	250					
37	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 14-16 mm -	copë	260					
38	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 20 mm -	copë	220					
39	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 12-13 mm -	copë	220					
40	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 14-16 mm -	copë	220					
41	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 20 mm -	copë	200					
42	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 12-13 mm -	copë	120					
43	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 14-16 mm -	copë	110					
44	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 20 mm -	copë	80					
45	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4.5 mm, 14-16 mm -	copë	50					
46	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4.5 mm, 20-22 mm -	copë	20					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

47	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.5mm,6-8mm	copë	90					
48	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.5mm,9-10mm	copë	1					
49	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.5mm,12-14mm	copë	1					
50	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,6-8mm	copë	10					
51	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,9-10mm	copë	10					
52	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,12-14mm	copë	1					
53	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,18-21mm	copë	1					
54	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,6-8mm	copë	10					
55	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,8-10mm	copë	10					
56	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,12-14mm	copë	1					
57	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,18-21mm	copë	1					
58	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,8-10mm	copë	1					



## Dokumentat Standarde të Tenderit

59	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,10-12mm	copë	1					
60	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,14-16mm	copë	1					
61	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,18-21mm	copë	1					
62	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,6-8mm	copë	10					
63	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,8-10mm	copë	5					
64	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,10-12mm	copë	1					
65	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,14-16mm	copë	1					
66	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,18-21mm	copë	1					
67	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4mm,8-10mm	copë	5					
68	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4mm,12-13mm	copë	5					
69	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4.5mm,14-16mm	copë	3					
70	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,5mm,14-16mm	copë	2					

Dokumentat Standarde të Tenderit

71	Rapid exchange PTCA catheter -over the wire ,2 markers,1.25, 6-7mm	copë	3				
72	Rapid exchange PTCA catheter -over the wire ,2 markers,1.25, 9-10mm	copë	3				
73	Rapid exchange PTCA catheter -over the wire ,2 markers,1.25-15mm	copë	3				
74	Rapid exchange PTCA catheter -over the wire ,2 markers,1.5, 6-7mm	copë	1				
75	Rapid exchange PTCA catheter -over the wire ,2 markers,1.5, 9-10mm	copë	1				
76	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Extra back up 3.0	copë	3				
77	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 3.0	copë	80				
78	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 3.5	copë	1,303				
79	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Extra back up 3.5	copë	3				
80	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 4.0	copë	100				
81	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 4.5	copë	30				
82	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 5.0	copë	14				

Dokumentat Standarde të Tenderit

83	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 3.0	copë	3					
84	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 3.5	copë	1					
85	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 4.0	copë	1					
86	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 4.5	copë	1					
87	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 5.0	copë	1					
88	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 3.5	copë	250					
89	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 4.0	copë	153					
90	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 4.5	copë	30					
91	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 5.0	copë	20					
92	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz I	copë	3					
93	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz II	copë	3					
94	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz III	copë	3					

Dokumentat Standarde të Tenderit

95	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz I	copë	30				
96	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz II	copë	20				
97	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz III	copë	5				
98	IMA (internal mammary)	copë	23				
99	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right,judkins technique 3.0	copë	2				
100	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right,judkins technique 3.5	copë	20				
101	Coronary guide catheter (with side holes)6F, right judkins technique 3.5	copë	3				
102	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right judkins technique 4.0	copë	1				
103	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right judkins technique 4.5	copë	3				
104	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.0	copë	100				
105	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.5	copë	903				
106	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.5	copë	3				

Dokumentat Standarde të Tenderit

107	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 4.0	copë	90					
108	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 4.5	copë	20					
109	Coronary guide catheter (without side holes)6F, Right Amplatz I	copë	3					
110	Coronary guide catheter (without side holes)6F, Right Amplatz II	copë	3					
111	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Amplatz I	copë	60					
112	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Amplatz II	copë	30					
113	Coronary guide catheter (without side holes)6F, Shepards crook right (guide kateter pa vrima anesore)	copë						
114	Coronary guide catheter (without side holes)6F, 3D RIGHT (guide kateter pa vrima anesore)	copë	3					
115	PTCA guidewire 0.014" (hydrophylic) floppy 180-200 cm	copë	3,560					
116	PTCA guidewire 0.014" (standart)	copë	99					
117	PTCA guidewire 0.014 (hydrophylic-extra floppy) 180-200cm. guide angioplastike e forte	copë	30					
118	PTCA guidewire 0.014 - (hydrophilic floppy) 300 cm, guida angioplastike (hydrofilike floppy) 300 cm	copë	30					
119	PTCA guidewire 0.014 (hydrophilic - extra floppy) 300cm, guida angioplastike e forte 300cm	copë	30					
120	Inflation device (Pistoleta e fryrjes se ballonit)	copë	2,050					
121	Set: Torque+metallic insertion tool for PCI guidewire in guiding catheter: Torku+shiringe (age) metalike per futjen e e guides se PCI ne kateterin drejtues	copë	2,050					
122	Catheter for intra-aortal balloon for Autocat 2 equipment (Katetere per ballon intra-aortal te pershtatshem per aparatin Autocat 2)	copë	9					
	<b>SHUMA I.</b>							

## Dokumentat Standarde të Tenderit

	<b>CMIMI NETO (Totali i cmimeve per njësi)</b>	
	<b>TVSH (%) (mbi Shumen I.)</b>	
	<b>SHUMA II TOTALI ME TVSH (Shuma I + TVSH % mbi shumën I)</b>	
	<b>SHUMA III CMIMI NETO (Totali i vleres se pritshme)</b>	
	<b>TVSH (%) mbi Shumën III.</b>	
	<b>SHUMA IV TOTALI ME TVSH (Shuma III+TVSH mbi shumën III)</b>	

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lekë ( kërkuar në dokumentat e tenderit )



**Shtojca 1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

**FORMULARI I OFERTËS**

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote**

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH;

**Lot. 4 “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar” me fond limit total për njësi 2,522,540 lekë pa TVSH**

Nr	Artikulli/ Specifikime teknike	Njesia	Sasia totale e Parashikuar	Cmimi/nj esi	Vlera e Pritshme (Cmim Njesi x Sasi)	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
----	--------------------------------	--------	----------------------------	--------------	--------------------------------------	--------------------	-------------------	-------

## Dokumentat Standarde të Tenderit

1	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker), 2.0 / 14-15mm	copë	5					
2	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.0 / 19-20mm	copë	1					
3	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.0 / 28-30mm	copë	1					
4	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.25 / 14-15mm	copë	5					
5	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2marker) 2.25 / 19-20mm	copë	1					
6	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.25 / 28-30mm	copë	1					
7	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/14-16 mm	copë	15					
8	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/18-20 mm	copë	11					
9	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/28-30 mm	copë	6					
10	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/40-42 mm	copë	1					
11	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/14-16 mm	copë	15					



Dokumentat Standarde të Tenderit

12	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/18-20 mm	copë	11					
13	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/28-30 mm	copë	6					
14	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/14-16 mm	copë	15					
15	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/18-20 mm	copë	11					
16	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/28-30 mm	copë	6					
17	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/40-42 mm	copë	1					
18	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.25 / 14-15mm	copë	1					
19	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.25 / 19-20mm	copë	1					
20	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.25 / 28-30mm	copë	1					
21	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/14-16 mm	copë	11					
22	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/18-20 mm	copë	11					
23	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/28-30 mm	copë	6					

Dokumentat Standarde të Tenderit

24	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.75 / 14-15mm	copë	1					
25	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.75 / 19-20mm	copë	1					
26	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.75 / 28-30mm	copë	1					
27	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 14.15mm	copë	1					
28	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 19-20mm	copë	1					
29	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 28-30mm	copë	1					
30	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 40-42mm	copë	1					
31	Catheter for Aspiration of Thrombus: it should have two lumen, vacuum available in 6F and 7F, length 140-145 cm, compatible with 0.014" wire, in a set with two syringes and two filter basket. (Kateter per aspirim trombi: duhet te kete 2 lumene, vakum te vlefshem ne 6F dhe 7F, gjatesi 140-145 cm, kompatibel me guide 0.014", ne nje set me 2 shiringa dhe 2 filter basket)	copë	30					
32	Basket for interventional recovery of foreign bodies from vessels or hollow viscera, diameter 15mm, 3F, length 120cm, 4 helical nitinol wire. - Rrjete per nxjerrjen e trupave te huaj nga enet, diameter 15mm, 3F, gjatesi 120cm, 4 tela spiral ninitoli.	copë	3					
33	Snare Set with atraumatic nitinol Loop diameter 25mm – variable, Length 125cm, Introducer 110cm-5F. Set snare me lak atraumatik ninitoli ne diameter 25mm - variabel, gjatesi 125cm, Introduktor 110cm - 5F.	copë	3					
<b>SHUMA I.</b>								

## Dokumentat Standarde të Tenderit

	<b>CMIMI NETO (Totali i cmimeve per njësi)</b>	
	<b>TVSH (%) (mbi Shumen I.)</b>	
	<b>SHUMA II TOTALI ME TVSH (Shuma I + TVSH % mbi shumën I)</b>	
	<b>SHUMA III CMIMI NETO (Totali i vleres se pritshme)</b>	
	<b>TVSH (%) mbi Shumën III.</b>	
	<b>SHUMA IV TOTALI ME TVSH (Shuma III+TVSH mbi shumën III)</b>	

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_  
 Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lekë ( kërkuar në dokumentat e tenderit )



**Shtojca 1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

**FORMULARI I OFERTËS**

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote**

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH;

**Lot. 5 “Blerje stenta te pamedikuara” me fond limit total për njësi 292,400 lekë pa TVSH**

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Nr	Artikulli/ Specifikime teknike	Njesia	Sasia totale e Parashikuar	Cmimi/nj esi	Vlera e Pritshme (Cmim Njesi x Sasi)	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
	Obligatory characteristics: architecture for flexibility, crossing profiles under 0.049 inch, thickness strut under 0.0038 inch, tested in multicentric studies for their efficacy and with American FDA and CE approvals) (Karakteristika te detyrueshme: arkitekture fleksible, me profil kalueshmerie nen 0.045 inch, dhe trashesine e strutit nen 0.0055 inch, te provuara ne studime multicentrike per efikasitet dhe te aprovuara nga FDA amerikane dhe komuniteti europian CE)							
1	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.25 mm 12-13 mm	cope	20					
2	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.25 mm 14-16 mm	cope	20					
3	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.25 mm 18-20 mm	cope	30					
4	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.5 mm 8-10 mm	cope	20					
5	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.5 mm 12-13 mm	cope	30					
6	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.5 mm 14-16 mm	cope	50					
7	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.5 mm 18-20 mm	cope	80					
8	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.5 mm 23-24 mm	cope	80					
9	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.75 mm 8-10 mm	cope	20					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

10	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 2.75 mm 12-13 mm	cope	20					
11	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 2.75 mm 14-16 mm	cope	40					
12	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 2.75 mm 18-20 mm	cope	55					
13	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 2.75 mm 23-24 mm	cope	50					
14	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 2.75 mm 26-28 mm	cope	70					
15	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.0 mm 8-10 mm	cope	30					
16	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.0 mm 12-13 mm	cope	50					
17	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.0 mm 14-16 mm	cope	50					
18	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.0 mm 18-20 mm	cope	90					
19	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.0 mm 23-24 mm	cope	100					
20	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.0 mm 26-28 mm	cope	80					
21	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.0 mm >30 mm	cope	80					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

22	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.5 mm 8-10 mm	cope	30					
23	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.5 mm 12-13 mm	cope	40					
24	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.5 mm 14-16 mm	cope	80					
25	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.5 mm 18-20 mm	cope	100					
26	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.5 mm 23-24 mm	cope	100					
27	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.5 mm 26-28 mm	cope	70					
28	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.5 mm >30 mm	cope	75					
29	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.0 mm 12-13 mm	cope	30					
30	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.0 mm 14-16 mm	cope	40					
31	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.0 mm 18-20 mm	cope	30					
32	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.0 mm 23-24 mm	cope	20					
33	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.0 mm 26-28 mm	cope	20					

Dokumentat Standarde të Tenderit

34	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.5 mm 14-16 mm	cope	5					
35	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.5 mm 18-20 mm	cope	5					
36	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.5 mm 23-24 mm	cope	5					
37	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.5 mm 26-30 mm	cope	5					
<b>SHUMA I. CMIMI NETO (Totali i çmimeve për njësi)</b>								
<b>TVSH (%) (mbi Shumën I.)</b>								
<b>SHUMA II TOTALI ME TVSH (Shuma I + TVSH % mbi shumën I)</b>								
<b>SHUMA III CMIMI NETO (Totali i vlerës së pritshme)</b>								
<b>TVSH (%) mbi Shumën III.</b>								
<b>SHUMA IV TOTALI ME TVSH (Shuma III+TVSH mbi shumën III)</b>								

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lekë ( kërkuar në dokumentat e tenderit )



## Shtojca 1

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

### FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] \_\_\_\_\_

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote**

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

**Public Health** \* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH;

**Lot. 6 “Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me fond limit total për njësi 5,086,000 lekë pa TVSH**

Dokumentat Standarde të Tenderit

Nr	Artikulli/ Specifikime teknike	Njesia	Sasia totale e Parashikuar	Cmimi/nj esi	Vlera e Pritshme (Cmim Njesi x Sasi)	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
	Coronary stent graft system, Micro-porous ePTFE graft material with one layer, CoCr single stent, 100% covered, 3 year shelf life, Guide Catheter Compatibility 5F for all sizes - Graft stente koronare, material mikroporoz ePTFE me nje shtrese, stent teke CoCr, 100% e veshur, jetegjatesi 3 vjet, kompatibel me Guide Kateter 5Fr per te gjitha permasat							
1	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /7-8 mm	cope	1					
2	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /11-12 mm	cope	1					
3	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /14-16 mm	cope	1					
4	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /18-20 mm	cope	1					
5	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /21-22 mm	cope	1					
6	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /24-26 mm	cope	1					
7	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.75 /14-16 mm	cope	1					
8	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /21-22 mm	cope	1					
9	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /14-16 mm	cope	2					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

10	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /18-20 mm	cope	2					
11	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /21-22 mm	cope	1					
12	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /24-26 mm	cope	1					
13	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /14-16 mm	cope	2					
14	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /18-20 mm	cope	1					
15	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /21-22 mm	cope	1					
16	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /24-26 mm	cope	1					
17	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /14-16 mm	cope	2					
18	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /18-20 mm	cope	1					
19	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /21-22 mm	cope	1					
20	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /24-26 mm	cope	1					
21	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.5 /14-16 mm	cope	1					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

22	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.5 /21-22 mm	cope	1					
23	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 5.0 /14-16 mm	cope	1					
24	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 5.0 /21-22 mm	cope	1					
	<b>SHUMA I.</b> <b>CMIMI NETO (Totali i cmimeve per njësi)</b>							
	<b>TVSH (%)</b> (mbi Shumen I.)							
	<b>SHUMA II</b> <b>TOTALI ME TVSH</b> (Shuma I + TVSH % mbi shumën I)							
	<b>SHUMA III</b> <b>CMIMI NETO</b> (Totali i vleres se pritshme)							
	<b>TVSH (%)</b> mbi Shumën III.							
	<b>SHUMA IV</b> <b>TOTALI ME TVSH</b> (Shuma III+TVSH mbi shumën III)							



Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lekë ( kërkuar në dokumentat e tenderit )

## Shtojca 1

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

### FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] \_\_\_\_\_

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote**

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

Public Health \*\*\* Sector

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH;

**Lot. 7 “Blerje Stenta te medikuara” me fond limit total për njësi 712,950 lekë pa TVSH**

Dokumentat Standarde të Tenderit

Nr	Artikulli/ Specifikime teknike	Njesia	Sasia totale e Parashikuar	Cmimi/nj esi	Vlera e Pritshme (Cmim Njesi x Sasi)	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
	Drug-eluting stents covered with cytostatic drugs: serolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus. Obligatory characteristics: architecture for flexibility, cobalt or platinum alloy, crossing profiles under 0.049 inch, thickness strut under 0.0038 inch, tested in multicentric studies for their efficacy and with American FDA and CE approvals) (Stente te veshura me medikamente citostatike: serolimus, everolimus, biolimus ose zotarolimus. Karakteristika te detyrueshme: arkitekture fleksibile, material kobalt ose platinum, me profil kalueshmerie nen 0.049 inch, dhe trashesine e trutit nen 0.0038 inch, te provuar ne studime multicentrike, te randomizuara, per efikasitet dhe te aprovuara nga FDA amerikane dhe Komun.Europian CE)	cope						
1	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 8-10 mm	cope	1					
2	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 12-14 mm	cope	30					
3	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 15-16 mm	cope	60					
4	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 18-20 mm	cope	85					
5	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 21-24 mm	cope	80					
6	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 25-28 mm	cope	111					
7	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 32 mm	cope	1					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

8	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 12-14 mm	cope	33					
9	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 15-16 mm	cope	67					
10	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 16-18 mm	cope	7					
11	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 18-20 mm	cope	110					
12	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 21-24 mm	cope	85					
13	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 25-28 mm	cope	101					
14	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 32 mm	cope	1					
15	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 12-14 mm	cope	65					
16	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 15-16 mm	cope	97					
17	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 18-20 mm	cope	121					
18	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 21-24 mm	cope	121					
19	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 25-28 mm	cope	111					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

20	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm >30 mm	cope	60					
21	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 32 mm	cope	1					
22	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 38 mm	cope	1					
23	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 48 mm	cope	1					
24	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 12-14 mm	cope	71					
25	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 15-16 mm	cope	110					
26	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 18-20 mm	cope	121					
27	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 21-24 mm	cope	121					
28	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 25-28 mm	cope	81					
29	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm >30 mm	cope	81					
30	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 32 mm	cope	3					
31	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 38 mm	cope	1					



## Dokumentat Standarde të Tenderit

32	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 48 mm	cope	1					
33	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 10-12 mm	cope	1					
34	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 14-16 mm	cope	21					
35	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 18-20 mm	cope	41					
36	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 20-24 mm	cope	41					
37	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 10-12 mm	cope	1					
38	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 14-16 mm	cope	20					
39	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 18-20 mm	cope	31					
40	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 20-24 mm	cope	30					
41	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 12-13 mm	cope	21					
42	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 15-16 mm	cope	33					
43	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 18-20 mm	cope	31					


## Dokumentat Standarde të Tenderit

44	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 21-24 mm	cope	33					
<b>SHUMA I. CMIMI NETO (Totali i cmimeve per njësi)</b>								
<b>TVSH (%) (mbi Shumen I.)</b>								
<b>SHUMA II TOTALI ME TVSH (Shuma I + TVSH % mbi shumën I)</b>								
<b>SHUMA III CMIMI NETO (Totali i vleres se pritshme)</b>								
<b>TVSH (%) mbi Shumën III.</b>								
<b>SHUMA IV TOTALI ME TVSH (Shuma III+TVSH mbi shumën III)</b>								

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lekë ( kërkuar në dokumentat e tenderit )

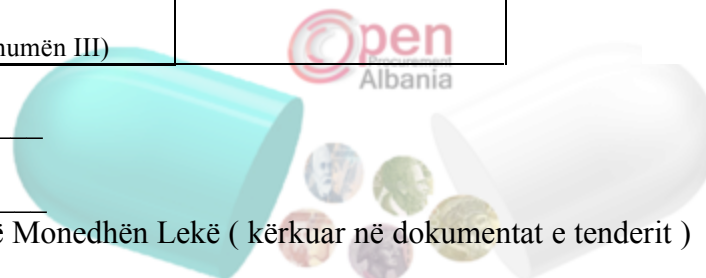

**Public Health Sector**

## Shtojca 1

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

### FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ” i ndarë në lote**

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH;

**Lot. 8 “Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta te medikuara për restenoze” me fond limit total për njësi 6,338,970 lekë pa TVSH**

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Nr	Artikulli/ Specifikime teknike	Njesia	Sasia totale e Parashikuar	Cmimi/nj esi	Vlera e Pritshme (Cmim Njesi x Sasi)	Kompania Prodhuese	Vendi i Prodhimit	Afati
	<p>Drug-eluting stent for restenosis, LM and bifurcation, Obligatory characteristics: Coronary stent that releases drug (drug-eluting) made of cobalt alloy (CoCr), markers of platinum iridium, sinusoidal technology connecting from one wire, or in combination CWT technology with the active component - cytostatic with anti-inflammatory and antiproliferative activity - Everolimus, Zotarolimus or Serolimus, the drug carries BioLinx polymer drug delivery through the 180 days, tested in multicentric studies for their efficacy, CE aproval for use in patients with diabetes or equivalent. (Stente te veshura me medikamente citostatike: Stente te veshura me me dikament per ristenzoza, LM dhe bifurkime, Karakteristika te detyrueshme: Stent koronar qe leshon ilac (i medikuar) e perbere prej aliazh kobalti (CoCr), markues platinumium iridium, teknologji sinusoidale me lidhje nga nje tel, ose ne kombinim me teknologjine CWT me komponent aktiv, citostatik Everolimus, Zotarolimus ose Serolimus me aktivitet anti-inflamator dhe anti-proliferativ, mbajtessi i ilacit BioLinx polymer shperndan ilacin ne 180 dite, te provuara ne studime multicentrike per efikasitet, CE per perdorim ne pacient diabetik ose ekuivalent)</p>							
		cope						
1	Diameter 2.0mm, gjatesi 7-8mm	cope	1					
2	Diameter 2.0mm, gjatesi 11-12mm	cope	1					
3	Diameter 2.0mm, gjatesi 15-16mm	cope	1					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

4	Diameter 2.0mm, gjatesi 18-19mm	cope	1					
5	Diameter 2.0mm, gjatesi 21-22mm	cope	1					
6	Diameter 2.0mm, gjatesi 26-27mm	cope	1					
7	Diameter 2.0mm, gjatesi 29-30mm	cope	1					
8	Diameter 2.25mm, gjatesi 7-8mm	cope	1					
9	Diameter 2.25mm, gjatesi 11-12mm	cope	1					
10	Diameter 2.25mm, gjatesi 15-16mm	cope	1					
11	Diameter 2.25mm, gjatesi 18-19mm	cope	1					
12	Diameter 2.25mm, gjatesi 21-22mm	cope	1					
13	Diameter 2.25mm, gjatesi 25-26mm	cope	1					
14	Diameter 2.25mm, gjatesi 29-30mm	cope	1					
15	Diameter 2.25mm, gjatesi 33-34mm	cope	1					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

16	Diameter 2.25mm, gjatesi 37-38mm	cope	1					
17	Diameter 2.50mm, gjatesi 7-8mm	cope	1					
18	Diameter 2.50mm, gjatesi 11-12mm	cope	1					
19	Diameter 2.50mm, gjatesi 15-16mm	cope	1					
20	Diameter 2.50mm, gjatesi 18-19mm	cope	1					
21	Diameter 2.50mm, gjatesi 21-22mm	cope	1					
22	Diameter 2.50mm, gjatesi 25-26mm	cope	1					
23	Diameter 2.50mm, gjatesi 29-30mm	cope	1					
24	Diameter 2.50mm, gjatesi 33-34mm	cope	1					
25	Diameter 2.50mm, gjatesi 37-38mm	cope	1					
26	Diameter 2.75mm, gjatesi 7-8mm	cope	1					
27	Diameter 2.75mm, gjatesi 11-12mm	cope	1					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

28	Diameter 2.75mm, gjatesi 15-16mm	cope	1					
29	Diameter 2.75mm, gjatesi 18-19mm	cope	1					
30	Diameter 2.75mm, gjatesi 21-22mm	cope	1					
31	Diameter 2.75mm, gjatesi 25-26mm	cope	1					
32	Diameter 2.75mm, gjatesi 29-30mm	cope	1					
33	Diameter 2.75mm, gjatesi 33-34mm	cope	1					
34	Diameter 2.75mm, gjatesi 37-38mm	cope	1					
35	Diameter 3.0mm, gjatesi 7-8mm	cope	1					
36	Diameter 3.0mm, gjatesi 11-12mm	cope	1					
37	Diameter 3.0mm, gjatesi 15-16mm	cope	1					
38	Diameter 3.0mm, gjatesi 18-19mm	cope	1					
39	Diameter 3.0mm, gjatesi 21-22mm	cope	1					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

40	Diameter 3.0mm, gjatesi 25-26mm	cope	1					
41	Diameter 3.0mm, gjatesi 29-30mm	cope	1					
42	Diameter 3.0mm, gjatesi 33-34mm	cope	1					
43	Diameter 3.0mm, gjatesi 37-38mm	cope	1					
44	Diameter 3.5mm, gjatesi 7-8mm	cope	1					
45	Diameter 3.5mm, gjatesi 11-12mm	cope	1					
46	Diameter 3.5mm, gjatesi 15-16mm	cope	1					
47	Diameter 3.5mm, gjatesi 18-19mm	cope	1					
48	Diameter 3.5mm, gjatesi 21-22mm	cope	1					
49	Diameter 3.5mm, gjatesi 25-26mm	cope	1					
50	Diameter 3.5mm, gjatesi 29-30mm	cope	1					
51	Diameter 3.5mm, gjatesi 33-34mm	cope	1					
52	Diameter 3.5mm, gjatesi 37-38mm	cope	1					
53	Diameter 4.0mm, gjatesi 11-12mm	cope	1					
54	Diameter 4.0mm, gjatesi 15-16mm	cope	1					
55	Diameter 4.5mm, gjatesi 18-19mm	cope	1					
56	Diameter 4.5mm, gjatesi 21-22mm	cope	1					




Dokumentat Standarde të Tenderit

57	Diameter 5.0mm, gjatesi 11-12mm	cope	1					
	<b>SHUMA I. CMIMI NETO (Totali i cmimeve per njësi)</b>							
	<b>TVSH (%) (mbi Shumen I.)</b>							
	<b>SHUMA II TOTALI ME TVSH (Shuma I + TVSH % mbi shumën I)</b>							
	<b>SHUMA III CMIMI NETO (Totali i vleres se pritshme)</b>							
	<b>TVSH (%) mbi Shumën III.</b>							
	<b>SHUMA IV TOTALI ME TVSH (Shuma III+TVSH mbi shumën III)</b>							

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lekë ( kërkuar në dokumentat e tenderit )

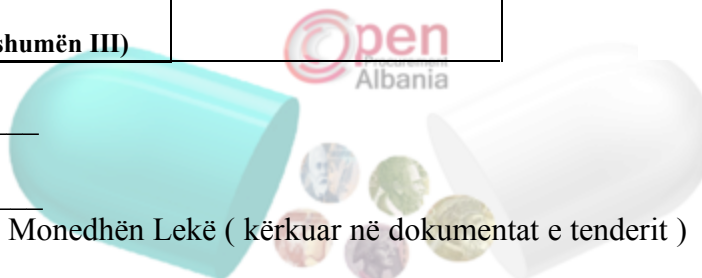

Public Health Sector

## Shtojca 2

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

### FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrimit

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

**Shtojca 3**

[ Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

**FTESA PËR OFERTË**

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....  
.....  
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni nje pershkrim te shkurter)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës \_\_\_\_\_

Oferta duhet të paraqitet

[Jep adresën e saktë]

Përpara


[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese \_\_\_\_\_

Forma e komunikimit: \_\_\_\_\_

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

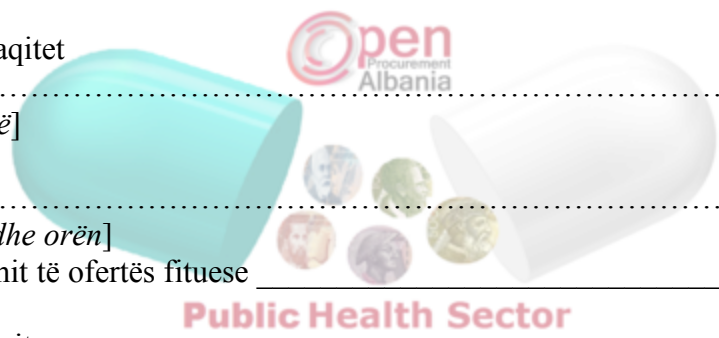

**Shtojca 4.**

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

**FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se



\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

**Shtojca 5**

**LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

**LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL**

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

**KUJDES**

**Public Health Sector**

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

**Shtojca 6**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik* ]

**DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e \_\_\_\_\_ të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.



Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

## Shtojca 7

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

### **DEKLARATË** **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejta ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësisë të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejta ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një

## Dokumentat Standarde të Tenderit

institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

**Emri, Mbiemri, Nënshkrimi**

\_\_\_\_\_

Vula





## Shtojca 8

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik* ]

### DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilesinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale,
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv),
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatorit ekonomik si më sipër.**

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

**Emri, Mbiemri, Nënshkrimi**

\_\_\_\_\_

Vula

## Shtojca 9

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)

b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,

c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

**Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.**

**Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.**

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

**Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:**

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;

b. Prokura e posaçme.

### 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT LOT. 1

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;jo
- b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- ç. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. **(Të jetë i përfshirë muaji –Mars 2018).**

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

- sipas Kriteve të Përgjithshme të kualifikimit

### **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2015,2016,2017). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të fondit limit\* të këtij loti.

Shënim\*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

### **2.3 Kapaciteti teknik:**

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të fondit limit\* të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të lotit 1 të kësaj procedure prokurimi. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Shënim\*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

3. Ofertuesi duhet të jete i certifikuar ISO 9001, për import eksport, tregtim të materialeve mjekesore. Per kete ai duhet të paraqese certifikaten e vlefshme perkatese, te perkthyer dhe te noterizuar.

4. Ofertuesi duhet të paraqese Certifikate ISO 9001 ose ISO 13485, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar, të perkthyer dhe të noterizuar.

5. Ofertuesi duhet të paraqese Çertifikate konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC, (të

## Dokumentat Standarde të Tenderit

përditësuar), për të gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, të përkthyer dhe të noterizuar.

6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku në rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lejimin e tregëtimit të artikujve të tij. (të përkthyer dhe të noterizuar)

7. Operatori duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të leshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

8. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe)

9. Kërkohen mostra për të gjithë artikujt e kërkuar si më poshtë:

- Kateter diagnostikues

Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « ..... » dhe jo para datës ..... 2018, ora \_\_\_\_ : \_\_\_\_.

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënojë Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

Mostrat e dorëzuara duhet të jenë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor të formularit të çmimit, e cila dorëzohet vetëm elektronikisht. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT LOT. 2

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;jo
- b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- ç. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. **(Të jetë i përfshirë muaji Mars 2018).**

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

- - sipas Kritereve të Përgjithshme të kualifikimit

### **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2015,2016,2017). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të fondit limit\* të këtij loti.

Shënim\*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

### **2.3 Kapaciteti teknik:**

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të fondit limit\* të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të lotit 2 të kësaj procedure prokurimi. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Shënim\*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

3. Ofertuesi duhet të jete i certifikuar ISO 9001, për import eksport, tregtim të materialeve mjekesore. Per kete ai duhet të paraqese certifikaten e vlefshme perkatese, të perkthyer dhe të noterizuar.

4. Ofertuesi duhet të paraqese Certifikate ISO 9001 ose ISO 13485, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar, të perkthyer dhe të noterizuar.

5. Ofertuesi duhet të paraqese Çertifikate konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC, (të përditësuar), për të gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, të perkthyer dhe të

noterizuar.

6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku në çdo rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lejimin e tregëtimit të artikujve të tij. (të perkthyer dhe të noterizuar)

7. Operatori duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të leshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

8. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i perkthyer në gjuhën shqipe)

9. Kërkohen mostra për të gjithë artikujt e kërkuar si më poshtë:

- Introducer (sheths)
- Introducer (sheths) radial
- Radial Artery Compression Device
- Rubinet 3-rrugësh (monifolds)
- Angiography pack (set angiografie)
- High pressure Angiographic Syring (Set me shiringa Angiografike me presion të lartë)

Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « ..... » dhe jo para datës .....2018, ora \_\_\_\_ : \_\_\_\_.

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

Mostrat e dorëzuara duhet të jenë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuar sipas Nr. Rendor të formularit të çmimit, e cila dorëzohet vetëm elektronikisht. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT LOT. 3**

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;jo
- b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- ç. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. **(Të jetë i përfshirë muaji Mars 2018).**

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

- - sipas Kritereve të Përgjithshme të kualifikimit

### **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2015,2016,2017). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të fondit limit\* të këtij loti.

Shënim\*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

### **2.3 Kapaciteti teknik:**

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të fondit limit\* të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të lotit 3 të kësaj procedure prokurimi. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku te shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Shënim\*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

3. Ofertuesi duhet te jete i certifikuar ISO 9001, për import eksport, tregtim te materialeve mjekesore. Per kete ai duhet te paraqese certifikaten e vlefshme perkatese, te perkthyer dhe te noterizuar.

4. Ofertuesi duhet te paraqese Certificate ISO 9001 ose ISO 13485, për prodhuesin/t e artikujve te ofruar, te perkthyer dhe te noterizuar.

5. Ofertuesi duhet te paraqese Çertifikate konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC, (të përditësuar), per te gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, të përkthyer dhe të

noterizuar.

6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku ne cdo rast te dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lejimin e tregëtimit të artikujve të tij. (të përkthyer dhe te noterizuar)

7. Operatori duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të leshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

8. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe)

9. Kerkohen mostra per te gjithë artikujt e kerkuar si me poshte:

- Guida angiografie
- Ballon angioplastike (Rapid exchange PTCA catheter; Non compliant Rapid exchange PTCA catheter; OTW)
- PTCA Guidewire 0.014”
- Kateter drejtues koronar (coronary guide catheter side holes; without side holes)
- Inflation device (pistoleta e fryrjes se ballonit)
- Set: torque, metallic insertion (Komplet : Torku+shiringe metalike)
- Katetere per ballon intra-aortik

Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « ..... » dhe jo para datës . . . . .2018, ora \_\_\_\_ : \_\_\_\_.

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

Mostrat e dorëzuara duhet të jenë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor të formularit të çmimit, e cila dorëzohet vetëm elektronikisht. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT LOT. 4

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:



- a. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;jo
- b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- ç. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. **(Të jetë i përfshirë muaji –Mars– 2018).**

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

- - sipas Kritereve të Përgjithshme të kualifikimit

### **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2015,2016,2017). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të fondit limit\* të këtij loti.

Shënim\*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

### **2.3 Kapaciteti teknik:**

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të fondit limit\* të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të lotit 4 të kësaj procedure prokurimi. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku te shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Shënim\*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

3. Ofertuesi duhet te jete i certifikuar ISO 9001, për import eksport, tregtim te materialeve mjekesore. Per kete ai duhet te paraqese certifikaten e vlefshme perkatese, te perkthyer dhe te noterizuar.

4. Ofertuesi duhet te paraqese Certificate ISO 9001 ose ISO 13485, për prodhuesin/t e artikujve te ofruar, te perkthyer dhe te noterizuar.

5. Ofertuesi duhet te paraqese Certificate konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC, (të përditësuar), per te gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, të përkthyer dhe të

noterizuar.

6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku ne cdo rast te dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lejimin e tregëtimit të artikujve të tij. (të përkthyer dhe te noterizuar)

7. Operatori duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të leshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

8. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe)

9. Kerkohen mostra per te gjithë artikujt e kerkuar si me poshte:

- Ballon i medikuar
- Kateter per aspirim trombi
- Snare

Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « ..... » dhe jo para datës . . . . .2018, ora \_\_\_\_ : \_\_\_\_.

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

Mostrat e dorëzuara duhet të jenë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor të formularit të çmimit, e cila dorëzohet vetëm elektronikisht. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT LOT. 5

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;jo
- b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- ç. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. **(Të jetë i përfshirë muaji –Mars– 2018).**

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

- - sipas Kritereve të Përgjithshme të kualifikimit

### **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2015,2016,2017). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të fondit limit\* të këtij loti.

Shënim\*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

### **2.3 Kapaciteti teknik:**

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të fondit limit\* të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të lotit 5 të kësaj procedure prokurimi. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku te shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Shënim\*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

3. Ofertuesi duhet te jete i certifikuar ISO 9001, për import eksport, tregtim te materialeve mjekesore. Per kete ai duhet te paraqese certifikaten e vlefshme perkatese, te perkthyer dhe te noterizuar.

4. Ofertuesi duhet te paraqese Certificate ISO 9001 ose ISO 13485, për prodhuesin/t e artikujve te ofruar, te perkthyer dhe te noterizuar.

5. Ofertuesi duhet te paraqese Certificate konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC, (të përditësuar), per te gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, të përkthyer dhe të

noterizuar ose certifikate FDA, te perkthyer dhe te noterizuar.

6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku ne cdo rast te dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lejimin e tregëtimit të artikujve të tij. (të perkthyer dhe te noterizuar)

7. Operatori duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të leshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

8. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit te artikullit ne Formularin e Ofertes dhe te markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe)

9. Kerkohen mostra per te gjithë artikujt e kerkuar si me poshte:

- Stent i zakonshem koronar (bare stent)

Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim te rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit te Ofertave te procedurës se prokurimit « ..... » dhe jo para datës . . . . .2018, ora \_\_\_\_ : \_\_\_\_.

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

Mostrat e dorëzuara duhet të jenë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor të formularit te çmimit, e cila dorëzohet vetëm elektronikisht. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT LOT. 6

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;jo
- b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- ç. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. **(Të jetë i përfshirë muaji Mars 2018).**

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

- - sipas Kritereve të Përgjithshme të kualifikimit

### **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2015,2016,2017). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të fondit limit\* të këtij loti.

Shënim\*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

### **2.3 Kapaciteti teknik:**

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të fondit limit\* të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të lotit 6 të kësaj procedure prokurimi. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku te shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Shënim\*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

3. Ofertuesi duhet te jete i certifikuar ISO 9001, për import eksport, tregtim te materialeve mjekesore. Per kete ai duhet te paraqese certifikaten e vlefshme perkatese, te perkthyer dhe te noterizuar.

4. Ofertuesi duhet te paraqese Certifikate ISO 9001 ose ISO 13485, për prodhuesin/t e artikujve te ofruar, te perkthyer dhe te noterizuar.

5. Ofertuesi duhet te paraqese Çertifikate konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC, (të përditësuar), per te gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, të përkthyer dhe të

noterizuar.

6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku ne cdo rast te dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lejimin e tregëtimit të artikujve të tij. (të perkthyer dhe te noterizuar)

7. Operatori duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të leshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

8. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit te artikullit ne Formularin e Ofertes dhe te markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe)

9. Kerkohen mostra per te gjithë artikujt e kerkuar si me poshte:

- Graft Stent Koronare

Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim te rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit te Ofertave te procedurës se prokurimit « ..... » dhe jo para datës . . . . .2018, ora \_\_\_\_ : \_\_\_\_.

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

Mostrat e dorëzuara duhet të jenë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor të formularit te çmimit, e cila dorëzohet vetëm elektronikisht. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT LOT. 7

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;jo
- b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- ç. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. **(Të jetë i përfshirë muaji –Mars– 2018).**

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

- - sipas Kriteve të Përgjithshme të kualifikimit

### **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2015,2016,2017). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të fondit limit\* të këtij loti.

Shënim\*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

### **2.3 Kapaciteti teknik:**

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të fondit limit\* të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të lotit 7 të kësaj procedure prokurimi. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Shënim\*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

3. Ofertuesi duhet të jete i certifikuar ISO 9001, për import eksport, tregtim të materialeve mjekesore. Per kete ai duhet të paraqese certifikaten e vlefshme perkatese, te perkthyer dhe te noterizuar.

4. Ofertuesi duhet të paraqese Certificate ISO 9001 ose ISO 13485, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar, te perkthyer dhe te noterizuar.

5. Ofertuesi duhet të paraqese Certificate konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC, (të përditësuar), për të gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, të përkthyer dhe të noterizuar ose certificate FDA, te perkthyer dhe te noterizuar.

6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku në çdo rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lejimin e tregëtimit të artikujve të tij. (të përkthyer dhe të noterizuar)

7. Operatori duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të leshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

8. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe)

9. Kërkohen mostra për të gjithë artikujt e kërkuar si më poshtë:

- Stent i medikuar koronar (drug-eluting stent)

Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « ..... » dhe jo para datës .....2018, ora \_\_\_\_ : \_\_\_\_.

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

Mostrat e dorëzuara duhet të jenë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor të formularit të çmimit, e cila dorëzohet vetëm elektronikisht. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT LOT. 8

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:



- a. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;jo
- b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- ç. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. **(Të jetë i përfshirë muaji Mars 2018).**

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

- - sipas Kritereve të Përgjithshme të kualifikimit

### **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2015,2016,2017). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të fondit limit\* të këtij loti.

Shënim\*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

### **2.3 Kapaciteti teknik:**

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të fondit limit\* të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të lotit 8 të kësaj procedure prokurimi. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Shënim\*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit në total të parashikuar sipas sasive të pritshme të këtij loti.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

3. Ofertuesi duhet të jete i certifikuar ISO 9001, për import eksport, tregtim të materialeve mjekesore. Per kete ai duhet të paraqese certifikaten e vlefshme perkatese, te perkthyer dhe te noterizuar.

4. Ofertuesi duhet të paraqese Certificate ISO 9001 ose ISO 13485, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar, të perkthyer dhe të noterizuar.

5. Ofertuesi duhet të paraqese Certificate konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC, (të përditësuar), për të gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, të perkthyer dhe të

noterizuar.

6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku ne cdo rast te dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lejimin e tregëtimit të artikujve të tij. (të perkthyer dhe te noterizuar)

7. Operatori duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të leshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

8. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit te artikullit ne Formularin e Ofertes dhe te markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe)

9. Kerkohen mostra per te gjithë artikujt e kerkuar si me poshte:

- Stente te veshura me medikament per ristenozia

Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të mbyllura me ngjitëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim te rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit te Ofertave te procedurës se prokurimit « ..... » dhe jo para datës . . . .2018, ora \_\_\_\_ : \_\_\_\_.

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

Mostrat e dorëzuara duhet të jenë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor të formularit te çmimit, e cila dorëzohet vetëm elektronikisht. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

**Shënim:** KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit

### o CERTIFIKATAT E CILËSISË (ISO & CE)

- Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë sipas zërave të që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje.

o **PJESMARRJA NË MË SHUMË SE NJË LOT:**

- Nëse një operator ekonomik konkuron në më shumë se 1 lot të kësaj procedure prokurimi atëherë ai duhet të zotërojë kapacitetet teknike, ekonomike financiare dhe kualifikimin profesional për të realizuar objektin e procedurës së prokurimit, pra të gjitha lotetë së bashku. Në këtë kuptim edhe kriteret e veçanta për kualifikim (si psh kontratat e ngjashme, xhiro., etj) duhet të plotësohen nga operatori ekonomik në varesi të lotetë që ai konkuron.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**



Shtojca 10

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**

**Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë**

## Dokumentat Standarde të Tenderit

kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

### KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

**Lot 1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me fond limit total për njësi 98,788 lekë pa TVSH**

Nr	Materiale mjekesore/ Specifikimet teknike	Njësia
<b>Katetere koronare diagnostike</b>		
1	Angiokit containing: (Judkins left and right 6F – 4.0 catheter (100cm), and 6F normal sheeth introducer with mini-guide wire) Komplet angiografie qe permban: (kateter i majte dhe djathte Judkins 6 F-4.0 (100 cm), dhe introduktor 6 F normal me mini guide shoqeruese)	copë
2	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 3.0	copë
3	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 3.5	copë
4	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 4.0	copë
5	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 4.5	copë
6	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 5 F, 5.0	copë
7	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 3.0	copë
8	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 3.5	copë
9	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 4.0	copë
10	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 4.5	copë
11	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 6 F, 5.0	copë

## Dokumentat Standarde të Tenderit

12	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 6.0	copë
13	Catheter multipurpose Cournand technique A-2 (100 cm) (Kateter multifunksional Cournand) <u>6 F</u> ,	copë
14	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5 E</u> , 3.0	copë
15	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5 E</u> , 3.5	copë
16	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5 E</u> , 4.0	copë
17	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5 E</u> , 4.5	copë
18	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5 E</u> , 5.0	copë
19	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 E</u> , 3.0	copë
20	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 E</u> , 3.5	copë
21	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 E</u> , 4.0	copë
22	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 E</u> , 4.5	copë
23	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 E</u> , 5.0	copë
24	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 E</u> , 6.0	copë
25	Catheter ventricular angled Pigtail (110 cm) (Kateter ventrikular, Pigtail te kendeuar (110cm)) <u>6 F</u> , 145* 6 SH	copë
26	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 F</u> , AL I	copë
27	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 F</u> , AL II	copë
28	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 F</u> , AL III	copë
29	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AL I	copë
30	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AL II	copë
31	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AL III	copë
32	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 E</u> , AR I	copë
33	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 E</u> , AR II	copë
34	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AR I	copë
35	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AR II	copë

## Dokumentat Standarde të Tenderit

36	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.0	copë
37	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.5	copë
38	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.0	copë
39	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.5	copë
40	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 5.0	copë
41	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AL I	copë
42	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AL II	copë
43	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AL III	copë
44	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.0	copë
45	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.5	copë
46	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.0	copë
47	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.5	copë
48	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 5.0	copë
49	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AR I	copë
50	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AR II	copë
51	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>6 F</u>	copë
52	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>5 F</u>	copë
53	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>4 F</u>	copë
54	Catheter IMA (internal mammary) (100 cm) (Kateter te a. mamare (100cm) <u>6 F</u>	copë
55	Catheter IMA (internal mammary) (100 cm) (Kateter te a. mamare (100cm) <u>5 F</u>	copë
56	Catheter LCB (Left Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare sinister) (100 cm) <u>6 F</u>	copë
57	Catheter LCB (Left Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare sinister) (100 cm) <u>5 F</u>	copë
58	Catheter RCB (Right Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare dexter) (100 cm) <u>6 F</u>	copë
59	Catheter RCB (Right Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare dexter) (100 cm) <u>5 F</u>	copë
60	Catheter Right Coronary Technique (100cm) 6 FR - 3 DRC	copë
61	Catheter Right Coronary Technique (100cm) 6 FR - 3 SRC	copë

## Dokumentat Standarde të Tenderit

62	Flow directed balloon catheter multipurpose (100-110 cm) (Kateter me ballon drejtues multifunksional) <u>6 F</u>	copë
63	PTFE-coated J curve - J radius 3 mm exchange guidewires (Maje ne forme J e veshur me PTFE me rreze 3 mm) .035 in 260 cm 7 cm	copë
64	PTFE-coated J curve - J radius 3 mm exchange guidewires (Maje ne forme J e veshur me PTFE me rreze 3 mm) .038 in 260 cm 7 cm	copë
65	Diagnostic guidewie - PTFE-coated J curve -J radius 3mm ,Amplatz extra Stiff,0.035,260cm	copë
66	Diagnostic Hydrophilic guidewire 0.035(0.89mm) curve -J radius 3cm,180-200cm	copë
67	PTFE-coated straight flexible tip - (Maje e drejte e veshur me PTFE) .035 in 260 cm 7 cm	copë
68	PTFE-coated straight flexible tip - (Maje e drejte e veshur me PTFE) .038 in 260 cm 7 cm	copë

### Lot. 2 “Blerje set per pergatitjen per koronarografine angioplastike” me fond limit total për njësi 566,863 lekë pa TVSH

Nr	Materialë mjekësore/ Specifikimet teknike	Njësia
<b>Set per pergatitjen per koronarografine angioplastike</b>		
1	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 5 F	copë
2	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 6 F	copë
3	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 7 F	copë
4	Middlelength sheath introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi mesatare pa obturator (me gide te vogel) 6 F	copë
5	Middlelength sheath introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi mesatare pa obturator (me gide te vogel) 7 F	copë
6	Extra long sheath 45-90 cm introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi te gjate 45-90 cm pa obturator (me guide te vogel) 6 F	copë
7	Extra long sheath 45-90 cm introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi te gjate 45-90 cm pa obturator (me guide te vogel) 7 F	copë
8	High-pressure 1000 PSI Catheter extensions (connector) male-female Katetere zgjatues me presion te larte (bashkues mashkull-femer) Ø interior 2,15 75 cm	copë
9	Pressure tubing made of poliethylene Male-female, length 100 cm, tubing diameter 1 x 2 mm (Tuba presioni me material polietileni mashkull-femer, gjatesi 100 cm, diameter tubi 1x2mm)	copë

## Dokumentat Standarde të Tenderit

10	Manifolds (female luer lock to distal rotating adapter) triple high-pressure manifold OFF (3 ways) Tre-rrugesh me dalje femer te pershtatur per pjesen distale te kateterit Tre-rrugesh me presion te larte OFF (3 rruge) 3 female right "off" 3 femra djathtas "off"	copë
11	Stopcocks 3 ports (2 female-1 male) Rubinet 3 portesh (2 femra-1 mashkull) a) low pressure stopcocks 50 psi (rubinet me presion te ulet)	copë
12	One piece needles (Age teke) 18 G 7.6 cm	copë
13	Disposable syringes for Medrad inject. Mark V Pro Vis: 150 ml (Shiringa nje perdorimeshe per injektim kontrasti Medrad Mark V Pro Vis: 150 ml)	copë
14	Disposable syringes for Medrad inject. Mark V Pro Vis: 200 ml (Shiringa nje perdorimeshe per injektim kontrasti Medrad Mark V Pro Vis: 200 ml)	copë
15	Spectraline disposable syringes for connection with manifolds and catheters 10-12 ml blue, security stop at 1.0 ml, rubber gasket for smooth plunger action with double seal crystal clear barrel without lateral finger rings (no finger grip) - 50% of quantity pieces and with lateral finger rings (with finger grip) - 50% of quantity pieces) (Shiringa nje perdorimeshe te vijezuara per lidhjen me tre rrugesh dhe me kateter me piston e tape te qendrueshme per injektim kontrasti, 10-12 ml blue, me ndalese sigurie tek kufiri 1 ml, ndarese gome ne fund te pistonit per nje levizje me te lehte te pistonit me izolim te dyfishte, material i tejdukshem dhe pa kapse anesore per gishtat ne 50% te sasise dhe me kapse anesore per gishtat ne 50% te sasise)	copë
16	Angiodyn image intensifier cover with elastic fixation 140 cm (Qese plastmasi per veshjen e llambes) 140 cm	copë
17	Angiography pack - Reinforced Angio Drape 240 x 300 cm with two sided PE clear film (waterproof, high absorption ability), - Tray 30x30x5 cm, - Cup 60 m, - Bowl 500 ml, - Table Cover 140x150 cm, - Gauze 10x10 cm, - Protective cover 80x110 cm, - Image intensifier cover with elastic fixation, - Sponge stick, - Coats XL x 2, - Scalpel	copë
18	Monitoring Set for pressure transducer adapted for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë
19	Cable for pressure transducer adapted for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë
20	Cable for ECG monitoring adapted for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë
21	Hemostasis Y-connector: 50% of quantity with pressure monitoring line (no side arm), push click-20%, push pull-80% 50% of quantity without pressure monitoring line (no side arm), push click-20%, push pull-7, screw type-10% ( Lidhes tip Y per hemostaze: 50% te sasise me linje anesore per monitorimin e presionit, shty kercit 20%, shty terhiq 80%. 50% tjeter te sasise pa linje anesore per monitorimin e presionit, shty kercit 20%, shty -terhiq 70%, shtrengim me filetimit 10%)	copë



Dokumentat Standarde të Tenderit

22	High pressure Angiographic Syringe for single use for Medrad Injector Mark–Stellant (2x200 ml Syring;1 x 60” T-Connector and Prime Tube;2 x Spikes) (Set me shiringa Angiografike me presion te larte per perdorim unik per Injektor Medrad Mark–Stellant qe permban 2x200 ml Syring, 1 x 60” T-Connector and Prime Tube, 2 x Spikes)	copë
23	Pressure Transducer for Cath-Lab Model Artis Zee Floor-Siemens (percjelles presioni per aparatin Siemens Artis Zee)	copë
24	Transducer (diaphragm) dome for use with pressure transducer for Cath-Lab Model Arsis Zee Floor Siemens (Diafragm dome per percjellesin e presionit e pershtatur per aparatin Simes-Artis Zee)	copë
25	Monitoring set for pressure transducer adapted for Cath-Lab Model Arsis Zee Floor -Siemens (Set monitorimi per percjellesin e presionit e pershtatshme per aparatin Simes-Artis Zee)	copë
26	Monitoring Set for pressure transducer adapted for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë
27	Cable for pressure transducer adapted for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë
28	Cable for ECG monitoring adapted for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë
29	Cable for ECG monitoring adapted for Siemens Angio-CT Model Somatom definition AS	copë
30	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 6 F, (sheath length 10-13 cm, guidewire and needle ) Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 11 cm, guide dhe age)	copë
31	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 7 F, (sheath length 10-13 cm, guidewire and needle ) Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 11 cm, guide dhe age)	copë
32	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 6 F (sheath length 16-23, guidewire and needle) Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 16-23 cm, guide dhe age)	copë
33	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 7 F (sheath length 16-23, guidewire and needle) Komplet sheath transradial me dilatator 7 F (gjatesi sheath 16-23 cm, guide dhe age)	copë
34	Contrast infusion set with hand syringe during angiography (set per infuzionin e kontrastit me shiringe dore gjate angiografise)	copë
35	Kit radial - Radial sheath introducer 5 Fr, 10- 13cm, with mini-guide wire and needle, (Sheath radial 5Fr me gjatesi 10 -13 cm, gide te vogel dhe age)	copë

## Dokumentat Standarde të Tenderit

36	Kit radial - Radial sheath introducer 6Fr, 10 - 13cm, with mini-guide wire and needle (Sheath radial 6Fr, me gjatesi 10 -13 cm, gide te vogel dhe age)	copë
37	Kit Radial - Radial sheath introducer 6 Fr, 20 - 25cm, with mini-guide wire and needle (Sheath radial 6 Fr, me gjatesi 20- 25 cm, gide te vogel dhe age)	copë
38	Radial Artery Compression Device (Paisje per hemostaze te arteries radiale)	copë

### Lot. 3 “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit total për njësi 614,730 lekë pa TVSH

Nr	Materiale mjekesore/ Specifikimet teknike	Njësia
<b>Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike</b>		
1	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.25 mm, 6-7 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë
2	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.25 mm, 9-10 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë
3	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.5 mm, 6-7 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë
4	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.5 mm, 9-10 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë
5	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,12-13mm	copë
6	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,14-16mm	copë
7	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 2 mm, 6-7 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë
8	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 2 mm, 9-10 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë
9	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,20 mm	copë
10	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,12-13 mm	copë
11	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,14-16 mm	copë

## Dokumentat Standarde të Tenderit

12	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,20 mm	copë
13	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 2.5 mm, 6-7 mm -(ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë
14	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 9-10 mm -(ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë
15	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,12-13 mm	copë
16	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,20 mm	copë
17	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,12-13 mm	copë
18	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,14-16 mm	copë
19	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,14-16 mm	copë
20	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,20 mm	copë
21	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,12-13 mm	copë
22	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,14-16 mm	copë
23	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,20 mm	copë
24	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 4 mm,12-13 mm	copë
25	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 4 mm,14-16 mm	copë
26	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 4 mm,20 mm	copë
27	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 12-13 mm -	copë
28	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 14-16 mm -	copë
29	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 20 mm	copë
30	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 12-13 mm -	copë

## Dokumentat Standarde të Tenderit

31	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 14-16 mm -	copë
32	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 20 mm -	copë
33	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 12-13 mm -	copë
34	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 14-16 mm -	copë
35	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 20 mm -	copë
36	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 12-13 mm -	copë
37	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 14-16 mm -	copë
38	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 20 mm -	copë
39	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 12-13 mm -	copë
40	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 14-16 mm -	copë
41	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 20 mm -	copë
42	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 12-13 mm -	copë
43	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 14-16 mm -	copë
44	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 20 mm -	copë
45	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4.5 mm, 14-16 mm -	copë
46	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4.5 mm, 20-22 mm -	copë
47	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.5mm,6-8mm	copë
48	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.5mm,9-10mm	copë
49	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.5mm,12-14mm	copë
50	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,6-8mm	copë
51	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,9-10mm	copë
52	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,12-14mm	copë
53	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,18-21mm	copë
54	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,6-8mm	copë
55	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,8-10mm	copë
56	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,12-14mm	copë
57	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,18-21mm	copë
58	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,8-10mm	copë
59	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,10-12mm	copë

Dokumentat Standarde të Tenderit

60	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,14-16mm	copë
61	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,18-21mm	copë
62	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,6-8mm	copë
63	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,8-10mm	copë
64	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,10-12mm	copë
65	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,14-16mm	copë
66	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,18-21mm	copë
67	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4mm,8-10mm	copë
68	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4mm,12-13mm	copë
69	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4.5mm,14-16mm	copë
70	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,5mm,14-16mm	copë
71	Rapid exchange PTCA catheter -over the wire ,2 markers,1.25, 6-7mm	copë
72	Rapid exchange PTCA catheter -over the wire ,2 markers,1.25, 9-10mm	copë
73	Rapid exchange PTCA catheter -over the wire ,2 markers,1.25-15mm	copë
74	Rapid exchange PTCA catheter -over the wire ,2 markers,1.5, 6-7mm	copë
75	Rapid exchange PTCA catheter -over the wire ,2 markers,1.5, 9-10mm	copë
76	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Extra back up 3.0	copë
77	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 3.0	copë
78	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 3.5	copë
79	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Extra back up 3.5	copë
80	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 4.0	copë
81	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 4.5	copë
82	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 5.0	copë
83	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 3.0	copë
84	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 3.5	copë
85	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 4.0	copë

## Dokumentat Standarde të Tenderit

86	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 4.5	copë
87	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 5.0	copë
88	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 3.5	copë
89	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 4.0	copë
90	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 4.5	copë
91	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 5.0	copë
92	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz I	copë
93	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz II	copë
94	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz III	copë
95	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz I	copë
96	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz II	copë
97	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz III	copë
98	IMA (internal mammary)	copë
99	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right,judkins technique 3.0	copë
100	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right,judkins technique 3.5	copë
101	Coronary guide catheter (with side holes)6F, right judkins technique 3.5	copë
102	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right judkins technique 4.0	copë
103	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right judkins technique 4.5	copë
104	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.0	copë
105	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.5	copë
106	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.5	copë
107	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 4.0	copë
108	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 4.5	copë
109	Coronary guide catheter (without side holes)6F, Right Amplatz I	copë
110	Coronary guide catheter (without side holes)6F, Right Amplatz II	copë
111	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Amplatz I	copë
112	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Amplatz II	copë
113	Coronary guide catheter (without side holes)6F, Shepards crook right (guide kateter pa vrima anesore)	copë

Dokumentat Standarde të Tenderit

114	Coronary guide catheter (without side holes)6F, 3D RIGHT (guide kateter pa vrima anesore)	copë
115	PTCA guidewire 0.014" (hydrophylic) floppy 180-200 cm	copë
116	PTCA guidewire 0.014" (standart)	copë
117	PTCA guidewire 0.014 (hydrophylic-extra floppy) 180-200cm. guide angioplastike e forte	copë
118	PTCA guidewire 0.014 - (hydrophilic floppy) 300 cm, guida angioplastike (hidrofilike floppy) 300 cm	copë
119	PTCA guidewire 0.014 (hydrophilic - extra floppy) 300cm, guida angioplastike e forte 300cm	copë
120	Inflation device (Pistoleta e fryrjes se ballonit)	copë
121	Set: Torque+metallic insertion tool for PCI guidewire in guiding catheter: Torku+shiringe (age) metalike per futjen e e guides se PCI ne kateterin drejtues	copë
122	Catheter for intra-aortal balloon for Autocat 2 equipment (Katetere per ballon intra-aortal te pershtatshem per aparatin Autocat 2)	copë

**Lot. 4 “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar” me fond limit total për njësi 2,522,540 lekë pa TVSH**

Nr	Materiale mjekesore/ Specifikimet teknike	Njësia
	<b>Drug Eluting Balloon catheter-kateter ballon i medikuar</b>	
	Drug eluting balloon Catheter, catheter 145 cm, the RX design. The proxy. part spindle 2F, a dist.part 2,5F with max. accept wire 0.014 " FLEXITEC HF material, LFC hydrophilic coating that provides superior reliability and stability within the lesion during surgery. 1 or 2 Pt-Ir markers provide excellent visualization in the cylinder of the balloon. Nominal pressure of 7 bar and RPB 15-17 bar. The body of the balloon coated with the active substance (paclitaxel, sirolimus or zotarolimus), which is the time during the dilatation of 30-60 sec resorbed into the tissue. (Kateter ballon i medikuar, kateter 145 cm, me RX design. Pjesa e majes proximale 2F, pjesa ditale 2.5F qe pranon guide max 0.014", materjal flexitech, LFC hidrofilikeqe siguron stabilitet dhe arritje te lehte ne lezion gjate procedures. 1 deri 2 Pt-Ir marker qe te sigurojne nje shikueshmeri shume te mire te cilindrit te balonit. Presioni nominal 7 Bar dhe RPB 15-17 Bar. Trupi i ballonit i veshur me me substance aktive (paclitaxel ose sirolimus ose zotarolimus) i cili gjate kohes se fryrjes se ballonit prej 30-60 sek te reabsorbohet ne ind)	copë
1	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon i medikuar me 2 marker), 2.0 / 14-15mm	copë
2	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon i medikuar me 2 marker) 2.0 / 19-20mm	copë

## Dokumentat Standarde të Tenderit

3	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.0 / 28-30mm	copë
4	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.25 / 14-15mm	copë
5	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2marker) 2.25 / 19-20mm	copë
6	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.25 / 28-30mm	copë
7	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/14-16 mm	copë
8	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/18-20 mm	copë
9	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/28-30 mm	copë
10	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/40-42 mm	copë
11	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/14-16 mm	copë
12	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/18-20 mm	copë
13	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/28-30 mm	copë
14	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/14-16 mm	copë
15	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/18-20 mm	copë
16	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/28-30 mm	copë
17	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/40-42 mm	copë
18	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.25 / 14-15mm	copë
19	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.25 / 19-20mm	copë
20	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.25 / 28-30mm	copë
21	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/14-16 mm	copë
22	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/18-20 mm	copë
23	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/28-30 mm	copë
24	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.75 / 14-15mm	copë
25	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.75 / 19-20mm	copë
26	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.75 / 28-30mm	copë



## Dokumentat Standarde të Tenderit

27	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 14.15mm	copë
28	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 19-20mm	copë
29	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 28-30mm	copë
30	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 40-42mm	copë
31	Catheter for Aspiration of Thrombus: it should have two lumen, vacuum available in 6F and 7F, length 140-145 cm, compatible with 0.014" wire, in a set with two syringes and two filter basket. (Kateter per aspirim trombi: duhet te kete 2 lumene, vakum te vlefshem ne 6F dhe 7F, gjatesi 140-145 cm, kompatibel me guide 0.014", ne nje set me 2 shiringa dhe 2 filter basket)	copë
32	Basket for interventional recovery of foreign bodies from vessels or hollow viscera, diameter 15mm, 3F, length 120cm, 4 helical nitinol wire. - Rrjete per nxjerrjen e trupave te huaj nga enet, diameter 15mm, 3F, gjatesi 120cm, 4 tela spiral ninitoli.	copë
33	Snare Set with atraumatic nitinol Loop diameter 25mm – variable, Length 125cm, Introducer 110cm-5F. Set snare me lak atraumatik ninitoli ne diameter 25mm - variabel, gjatesi 125cm, Introduktor 110cm - 5F.	copë

### Lot. 5 “Blerje stenta te pamedikuara” me fond limit total për njësi 292,400 lekë pa TVSH

Public Health Sector		
Nr	Materiale mjekesore/ Specifikimet teknike	Njësia
<b>Stenta te pamedikuara</b>		
	Obligatory characteristics: architecture for flexibility, crossing profiles under 0.049 inch, thickness strut under 0.0038 inch, tested in multicentric studies for their efficacy and with American FDA and CE approvals) (Karakteristika te detyrueshme: arkitekture fleksible, me profil kalueshmerie nen 0.045 inch, dhe trashesine e strutit nen 0.0055 inch, te provuara ne studime multicentrike per efikasitet dhe te aprovuara nga FDA amerikane ose komuniteti european CE)	
1	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.25 mm 12-13 mm	cope
2	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.25 mm 14-16 mm	cope
3	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.25 mm 18-20 mm	cope
4	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.5 mm 8-10 mm	cope

## Dokumentat Standarde të Tenderit

5	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 2.5 mm 12-13 mm	cope
6	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 2.5 mm 14-16 mm	cope
7	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 2.5 mm 18-20 mm	cope
8	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 2.5 mm 23-24 mm	cope
9	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 2.75 mm 8-10 mm	cope
10	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 2.75 mm 12-13 mm	cope
11	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 2.75 mm 14-16 mm	cope
12	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 2.75 mm 18-20 mm	cope
13	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 2.75 mm 23-24 mm	cope
14	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 2.75 mm 26-28 mm	cope
15	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 3.0 mm 8-10 mm	cope
16	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 3.0 mm 12-13 mm	cope
17	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 3.0 mm 14-16 mm	cope
18	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 3.0 mm 18-20 mm	cope
19	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 3.0 mm 23-24 mm	cope
20	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 3.0 mm 26-28 mm	cope
21	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 3.0 mm >30 mm	cope
22	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 3.5 mm 8-10 mm	cope
23	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 3.5 mm 12-13 mm	cope
24	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 3.5 mm 14-16 mm	cope
25	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 3.5 mm 18-20 mm	cope
26	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 3.5 mm 23-24 mm	cope
27	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 3.5 mm 26-28 mm	cope
28	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejte) 3.5 mm >30 mm	cope

## Dokumentat Standarde të Tenderit

29	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.0 mm 12-13 mm	cope
30	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.0 mm 14-16 mm	cope
31	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.0 mm 18-20 mm	cope
32	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.0 mm 23-24 mm	cope
33	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.0 mm 26-28 mm	cope
34	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.5 mm 14-16 mm	cope
35	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.5 mm 18-20 mm	cope
36	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.5 mm 23-24 mm	cope
37	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.5 mm 26-30 mm	cope

### Lot. 6 “Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me fond limit total për njësi 5,086,000 lekë pa TVSH

Nr	Materialë mjekësore/ Specifikimet teknike	Njësia
<b>Coronary stent graft system- Graft stente koronare</b>		cope
	Coronary stent graft system, Micro-porous ePTFE graft material with one layer, CoCr single stent, 100% covered, 3 year shelf life, Guide Catheter Compatibility 5F for all sizes - Graft stente koronare, material mikroporoz ePTFE me një shtresë, stent teke CoCr, 100% e veshur, jetëgjatësi 3 vjet, kompatibel me Guide Kateter 5Fr per të gjitha permasat	
1	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /7-8 mm	cope
2	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /11-12 mm	cope
3	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /14-16 mm	cope
4	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /18-20 mm	cope
5	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /21-22 mm	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

6	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /24-26 mm	cope
7	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.75 /14-16 mm	cope
8	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /21-22 mm	cope
9	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /14-16 mm	cope
10	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /18-20 mm	cope
11	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /21-22 mm	cope
12	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /24-26 mm	cope
13	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /14-16 mm	cope
14	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /18-20 mm	cope
15	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /21-22 mm	cope
16	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /24-26 mm	cope
17	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /14-16 mm	cope
18	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /18-20 mm	cope
19	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /21-22 mm	cope
20	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /24-26 mm	cope
21	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.5 /14-16 mm	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

22	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.5 /21-22 mm	cope
23	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 5.0 /14-16 mm	cope
24	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 5.0 /21-22 mm	cope

**Lot. 7 “Blerje Stenta te medikuara” me fond limit total për njësi 712,950 lekë pa TVSH**

Nr	Materiale mjekesore/ Specifikimet teknike	Njësia
<b>Stenta te medikuara</b>		
	Drug-eluting stents covered with cytostatic drugs: serolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus. Obligatory characteristics: architecture for flexibility, cobalt or platinum alloy, crossing profiles under 0.049 inch, thickness strut under 0.0038 inch, tested in multicentric studies for their efficacy and with American FDA and CE approvals) (Stente te veshura me medikamente citostatike: serolimus, everolimus, biolimus ose zotarolimus. Karakteristika te detyrueshme: arkitekture fleksibile, material kobalt ose platinum, me profil kalueshmerie nen 0.049 inch, dhe trashesine e trutit nen 0.0038 inch, te provuar ne studime multicentrike, te randomizuara, per efikasitet dhe te aprovuara nga FDA amerikane ose Komun.Europian CE)	cope
1	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 8-10 mm	cope
2	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 12-14 mm	cope
3	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 15-16 mm	cope
4	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 18-20 mm	cope
5	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 21-24 mm	cope
6	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 25-28 mm	cope

## Dokumentat Standarde të Tenderit

7	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 32 mm	cope
8	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 12-14 mm	cope
9	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 15-16 mm	cope
10	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 16-18 mm	cope
11	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 18-20 mm	cope
12	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 21-24 mm	cope
13	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 25-28 mm	cope
14	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 32 mm	cope
15	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 12-14 mm	cope
16	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 15-16 mm	cope
17	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 18-20 mm	cope
18	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 21-24 mm	cope
19	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 25-28 mm	cope
20	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm >30 mm	cope
21	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 32 mm	cope
22	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 38 mm	cope

## Dokumentat Standarde të Tenderit

23	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 48 mm	cope
24	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 12-14 mm	cope
25	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 15-16 mm	cope
26	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 18-20 mm	cope
27	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 21-24 mm	cope
28	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 25-28 mm	cope
29	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm >30 mm	cope
30	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 32 mm	cope
31	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 38 mm	cope
32	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 48 mm	cope
33	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 10-12 mm	cope
34	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 14-16 mm	cope
35	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 18-20 mm	cope
36	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 20-24 mm	cope
37	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 10-12 mm	cope
38	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 14-16 mm	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

39	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 18-20 mm	cope
40	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 20-24 mm	cope
41	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 12-13 mm	cope
42	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 15-16 mm	cope
43	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 18-20 mm	cope
44	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 21-24 mm	cope

**Lot. 8 “Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta te medikuara për restenoze” me fond limit total për njësi 6,338,970 lekë pa TVSH**

Nr	Materiale mjekesore	Njësia
<b>Drug-eluting stent for restenosis- stenta te medikuara per restenoze</b>		
	Drug-eluting stent for restenosis, LM and bifurcation, Obligatory characteristics: Coronary stent that releases drug (drug-eluting) made of cobalt alloy (CoCr), markers of platinum iridium, sinusoidal technology connecting from one wire, or in combination CWT technology with the active component - cytostatic with anti-inflammatory and antiproliferative activity - Everolimus, Zotarolimus or Serolimus, the drug carries BioLinx polymer drug delivery through the 180 days, tested in multicentric studies for their efficacy, CE aproval for use in patients with diabetes or equivalent. (Stente te veshura me me dikament per ristenozia, LM dhe bifurkime, Karakteristika te detyrueshme: Stent koronar qe leshon ilac (i medikuar) e perbere prej aliazh kobalti (CoCr), markues platinumium iridium, teknologji sinusoidale me lidhje nga nje tel, ose ne kombinim me teknologjine CWT me komponent aktiv, citostatik Everolimus, Zotarolimus ose Serolimus me aktivitet anti-inflamator dhe anti-proliferativ, mbajtjesi i ilacit BioLinx polymer shperndan ilacin ne 180 dite, te provuara ne studime multicentrike per efikasitet, CE per perdorim ne pacient diabetik ose ekuivalent)	cope
1	Diameter 2.0mm, gjatesi 7-8mm	cope
2	Diameter 2.0mm, gjatesi 11-12mm	cope



## Dokumentat Standarde të Tenderit

3	Diameter 2.0mm, gjatesi 15-16mm	cope
4	Diameter 2.0mm, gjatesi 18-19mm	cope
5	Diameter 2.0mm, gjatesi 21-22mm	cope
6	Diameter 2.0mm, gjatesi 26-27mm	cope
7	Diameter 2.0mm, gjatesi 29-30mm	cope
8	Diameter 2.25mm, gjatesi 7-8mm	cope
9	Diameter 2.25mm, gjatesi 11-12mm	cope
10	Diameter 2.25mm, gjatesi 15-16mm	cope
11	Diameter 2.25mm, gjatesi 18-19mm	cope
12	Diameter 2.25mm, gjatesi 21-22mm	cope
13	Diameter 2.25mm, gjatesi 25-26mm	cope
14	Diameter 2.25mm, gjatesi 29-30mm	cope
15	Diameter 2.25mm, gjatesi 33-34mm	cope
16	Diameter 2.25mm, gjatesi 37-38mm	cope
17	Diameter 2.50mm, gjatesi 7-8mm	cope
18	Diameter 2.50mm, gjatesi 11-12mm	cope
19	Diameter 2.50mm, gjatesi 15-16mm	cope
20	Diameter 2.50mm, gjatesi 18-19mm	cope
21	Diameter 2.50mm, gjatesi 21-22mm	cope
22	Diameter 2.50mm, gjatesi 25-26mm	cope
23	Diameter 2.50mm, gjatesi 29-30mm	cope
24	Diameter 2.50mm, gjatesi 33-34mm	cope
25	Diameter 2.50mm, gjatesi 37-38mm	cope
26	Diameter 2.75mm, gjatesi 7-8mm	cope
27	Diameter 2.75mm, gjatesi 11-12mm	cope
28	Diameter 2.75mm, gjatesi 15-16mm	cope
29	Diameter 2.75mm, gjatesi 18-19mm	cope
30	Diameter 2.75mm, gjatesi 21-22mm	cope
31	Diameter 2.75mm, gjatesi 25-26mm	cope
32	Diameter 2.75mm, gjatesi 29-30mm	cope
33	Diameter 2.75mm, gjatesi 33-34mm	cope
34	Diameter 2.75mm, gjatesi 37-38mm	cope
35	Diameter 3.0mm, gjatesi 7-8mm	cope
36	Diameter 3.0mm, gjatesi 11-12mm	cope
37	Diameter 3.0mm, gjatesi 15-16mm	cope
38	Diameter 3.0mm, gjatesi 18-19mm	cope
39	Diameter 3.0mm, gjatesi 21-22mm	cope
40	Diameter 3.0mm, gjatesi 25-26mm	cope
41	Diameter 3.0mm, gjatesi 29-30mm	cope
42	Diameter 3.0mm, gjatesi 33-34mm	cope
43	Diameter 3.0mm, gjatesi 37-38mm	cope
44	Diameter 3.5mm, gjatesi 7-8mm	cope
45	Diameter 3.5mm, gjatesi 11-12mm	cope

## Dokumentat Standarde të Tenderit

46	Diameter 3.5mm, gjatesi 15-16mm	cope
47	Diameter 3.5mm, gjatesi 18-19mm	cope
48	Diameter 3.5mm, gjatesi 21-22mm	cope
49	Diameter 3.5mm, gjatesi 25-26mm	cope
50	Diameter 3.5mm, gjatesi 29-30mm	cope
51	Diameter 3.5mm, gjatesi 33-34mm	cope
52	Diameter 3.5mm, gjatesi 37-38mm	cope
53	Diameter 4.0mm, gjatesi 11-12mm	cope
54	Diameter 4.0mm, gjatesi 15-16mm	cope
55	Diameter 4.5mm, gjatesi 18-19mm	cope
56	Diameter 4.5mm, gjatesi 21-22mm	cope
57	Diameter 5.0mm, gjatesi 11-12mm	cope

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit duhet të jetë sa 2/3 e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës. Skadencia duhet të jetë e shënuar në ambalazh.

Materialet e mjekimit duhet të përmbushin standartet CE ose CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC.

Ato duhet të jenë të markuara CE në momentin e lëvrimit të mallit.

Ofertuesi duhet të përmbushë specifikimet teknike të materialeve mjekësorë detyrimisht sipas përcaktimit të bërë në përshkrimin e mallrave në DS të kësaj procedurë prokurimi.

### Shtojca11

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

### PLANIFIKIMI I KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

	Mall:	Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes
Kuadër		
<b>Kontrata Nr.</b>	<b>Titulli i Kontratës</b>	<b>Përshkrim i shkurtër i kontratës</b>

Dokumentat Standarde të Tenderit

<b>01</b>		
<b>02</b>		
<b>03</b>		
<b>...</b>		

**Shtojca 12**

( Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)



**SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT**

**Public Health Sector**

**Sasia e mallit që kërkohet: TABELA me sasite e pritshme ne total dhe për sejcilin AK**

**Lot 1. “Blerje katetere koronare diagnostike”**

<b>Nr</b>	<b>Materiale mjekesore</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia Totale</b>	<b>Sasia/ QSUT</b>	<b>Sasia/ SUSN</b>	<b>Sasia/ Shkoder</b>
<b>Katetere koronare diagnostike</b>						
1	Angiokit containing: (Judkins left and right 6F – 4.0 catheter (100cm), and 6F normal sheeth introducer with mini-guide wire) Komplet angiografie qe permban: (kateter i majte dhe djathte Judkins 6 F-4.0 (100 cm), dhe introduktor 6 F normal me mini guide shoqeruese)	copë	250	250		
2	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 5_E, 3.0	copë	100		100	
3	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) 5_E, 3.5	copë	250		250	

## Dokumentat Standarde të Tenderit

4	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 4.0	copë	80	30	50	
5	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 4.5	copë	40	10	30	
6	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 5.0	copë	20		20	
7	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 3.0	copë	270	20	250	
8	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 3.5	copë	350	50	300	
9	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 4.0	copë	2,800	2,000	800	
10	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 4.5	copë	200	150	50	
11	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 5.0	copë	100	70	30	
12	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 6.0	copë	20	20		
13	Catheter multipurpose Cournand technique A-2 (100 cm) (Kateter multifunksional Cournand) <u>6 F</u> ,	copë	5	5		
14	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 3.0	copë	30		30	
15	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 3.5	copë	30		30	
16	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 4.0	copë	380	30	350	
17	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 4.5	copë	55	5	50	
18	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>5 F</u> , 5.0	copë	20		20	
19	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 3.0	copë	30		30	
20	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 3.5	copë	100	70	30	
21	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 4.0	copë	2,800	2,000	800	
22	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 4.5	copë	30		30	
23	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 5.0	copë	50	30	20	
24	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>6 F</u> , 6.0	copë	20	20	-	
25	Catheter ventricular angled Pigtail (110 cm) (Kateter ventrikular, Pigtail te kendeuzar (110cm)) <u>6 F</u> , 145* <u>6 SH</u>	copë	400	400		
26	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 F</u> , AL I	copë	10		10	
27	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 F</u> , AL II	copë	10		10	

## Dokumentat Standarde të Tenderit

28	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 F</u> , AL III	copë	10		10	
29	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AL I	copë	45	25	20	
30	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AL II	copë	40	20	20	
31	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AL III	copë	25	15	10	
32	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 F</u> , AR I	copë	10	-	10	
33	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>5 F</u> , AR II	copë	10	-	10	
34	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AR I	copë	50	30	20	
35	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>6 F</u> , AR II	copë	40	30	10	
36	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.0	copë	50		50	
37	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.5	copë	150		150	
38	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.0	copë	30		30	
39	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.5	copë	20		20	
40	Catheter left coronary Judkins Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 5.0	copë	10		10	
41	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AL I	copë	10		10	
42	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AL II	copë	10		10	
43	Catheter left coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te majte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AL III	copë	10		10	
44	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.0	copë	20		20	
45	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 3.5	copë	20		20	
46	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.0	copë	150		150	
47	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 4.5	copë	20		20	
48	Catheter right coronary Judkins technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Judkins (100cm) <u>4 F</u> , 5.0	copë	10		10	
49	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AR I	copë	10		10	
50	Catheter right coronary Amplatz Technique (100 cm) (Kateter te djathte, teknika Amplatz (100cm) <u>4 F</u> , AR II	copë	10		10	
51	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>6 F</u>	copë	250		250	
52	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>5 F</u>	copë				

Dokumentat Standarde të Tenderit

			100		100	
53	Catheter Sones II (100 cm) (Kateter Sones II (100cm) <u>4 F</u>	copë	50		50	
54	Catheter IMA (internal mammary) (100 cm) (Kateter te a. mamare (100cm) <u>6 F</u>	copë	100	80	20	
55	Catheter IMA (internal mammary) (100 cm) (Kateter te a. mamare (100cm) <u>5 F</u>	copë	20		20	
56	Catheter LCB (Left Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare sinister) (100 cm) <u>6 F</u>	copë	35	15	20	
57	Catheter LCB (Left Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare sinister) (100 cm) <u>5 F</u>	copë	20		20	
58	Catheter RCB (Right Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare dexter) (100 cm) <u>6 F</u>	copë	35	15	20	
59	Catheter RCB (Right Coronary Bypass) (100 cm) (Kateter per bypass ne a.coronare dexter) (100 cm) <u>5 F</u>	copë	20		20	
60	Catheter Right Coronary Technique (100cm) 6 FR - 3 DRC	copë	30		30	
61	Catheter Right Coronary Technique (100cm) 6 FR - 3 SRC	copë	30		30	
62	Flow directed balloon catheter multipurpose (100-110 cm) (Kateter me ballon drejtues multifunksional) <u>6 F</u>	copë	5	5		
63	PTFE-coated J curve - J radius 3 mm exchange guidewires (Maje ne forme J e veshur me PTFE me rreze 3 mm) .035 in 260 cm 7 cm	copë	3,000	1,200	1,800	
64	PTFE-coated J curve - J radius 3 mm exchange guidewires (Maje ne forme J e veshur me PTFE me rreze 3 mm) .038 in 260 cm 7 cm	copë	1,205	1,200	5	
65	Diagnostic guidewie - PTFE-coated J curve -J radius 3mm ,Amplatz extra Stiff,0.035,260cm	copë	250		250	
66	Diagnostic Hydrophilic guidewire 0.035(0.89mm) curve -J radius 3cm,180-200cm	copë	250		250	
67	PTFE-coated straight flexible tip - (Maje e drejte e veshur me PTFE ) .035 in 260 cm 7 cm	copë	15	10	5	
68	PTFE-coated straight flexible tip - (Maje e drejte e veshur me PTFE ) .038 in 260 cm 7 cm	copë	15	10	5	

**Lot. 2 “Blerje set per pergatitjen per koronarografine angioplastike”**

Nr	Materiale mjekesore	Njësia	Sasia Totale	Sasia/ QSUT	Sasia/ SUSN	Sasia/ Shkoder
<b>Set per pergatitjen per koronarografine angioplastike</b>						
1	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 5 F	copë	40	30	10	
2	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 6 F	copë	3,200	2,000	1,200	
3	Normal sheath introducer with mini-guide wire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 7 F	copë	1,805	1,800	5	

## Dokumentat Standarde të Tenderit

4	Midlength sheath introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi mesatare pa obturator (me gide te vogel) 6 F	copë	60	10	50	
5	Midlength sheath introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi mesatare pa obturator (me gide te vogel) 7 F	copë	160	150	10	
6	Extra long sheath 45-90 cm introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi te gjate 45-90 cm pa obturator (me guide te vogel) 6 F	copë	40	30	10	
7	Extra long sheath 45-90 cm introducers without obturator (with mini-guide wire) Sheath me gjatesi te gjate 45-90 cm pa obturator (me guide te vogel) 7 F	copë	85	80	5	
8	High-pressure 1000 PSI Catheter extensions (connector) male-female Katetere zgjatues me presion te larte (bashkues mashkull-femer) Ø interior 2,15 75 cm	copë	40	40		
9	Pressure tubing made of polyethylene Male-female, length 100 cm, tubing diameter 1 x 2 mm (Tuba presioni me material polietileni mashkull-femer, gjatesi 100 cm, diameter tubi 1x2mm)	copë	2,040	40	2,000	
10	Manifolds (female luer lock to distal rotating adapter) triple high-pressure manifold OFF (3 ways) Tre-rrugeshe me dalje femer te pershtatur per pjesen distale te kateterit Tre-rrugeshe me presion te larte OFF (3 rruge) 3 female right "off" 3 femra djathtas "off"	copë	3,700	2,500	1,200	
11	Stopcocks 3 ports (2 female-1 male) Rubinet 3 portesh (2 femra-1 mashkull) a) low pressure stopcocks 50 psi (rubinet me presion te ulet)	copë	70	50	20	
12	One piece needles (Age teke) 18 G 7.6 cm	copë	150	50	100	
13	Disposable syringes for Medrad inject. Mark V Pro Vis: 150 ml (Shiringa nje perdorimeshe per injektim kontrasti Medrad Mark V Pro Vis: 150 ml)	copë	210	200	10	
14	Disposable syringes for Medrad inject. Mark V Pro Vis: 200 ml (Shiringa nje perdorimeshe per injektim kontrasti Medrad Mark V Pro Vis: 200 ml)	copë	300	300		
15	Spectraline disposable syringes for connection with manifolds and catheters 10-12 ml blue, security stop at 1.0 ml, rubber gasket for smooth plunger action with double seal crystal clear barrel without lateral finger rings (no finger grip) - 50% of quantity pieces and with lateral finger rings (with finger grip) - 50% of quantity pieces) (Shiringa nje perdorimeshe te vijezuara per lidhjen me tre rrugeshe dhe me kateter me piston e tape te qendrushme per injektim kontrasti, 10-12 ml blue, me ndalesa sigurie tek kufiri 1 ml, ndalesa gome ne fund te pistonit per nje levizje me te lehte te pistonit me izolim te dyfishte, materjal i tejdukshem dhe pa kapse anesore per gishtat ne 50% te sasise dhe me kapse anesore per gishtat ne 50% te sasise)	copë	5,400	4,200	1,200	
16	Angiodyn image intensifier cover with elastic fixation 140 cm (Qese plastmasi per veshjen e llambes) 140 cm	copë	70	20	50	

## Dokumentat Standarde të Tenderit

17	Angiography pack - Reinforced Angio Drape 240 x 300 cm with two sided PE clear film (waterproof, high absorption ability), - Tray 30x30x5 cm, - Cup 60 m, - Bowl 500 ml, - Table Cover 140x150 cm, - Gauze 10x10 cm, - Protective cover 80x110 cm, - Image intensifier cover with elastic fixation, - Sponge stick, - Coats XL x 2, - Scalpel	copë	5,600	3,400	1,800	400
18	Monitoring Set for pressure transducer adapted for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë	10	10		
19	Cable for pressure transducer adapted for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë	1	1		
20	Cable for ECG monitoring adapted for Philips Angiograph Model Allura CV20	copë	1	1		
21	Hemostasis Y-connector: 50% of quantity with pressure monitoring line (no side arm), push click-20%, push pull-80% 50% of quantity without pressure monitoring line (no side arm), push click-20%, push pull-7, screw type-10% ( Lidhes tip Y per hemostaze: 50% te sasise me linje anesore per monitorimin e presionit, shty kercit 20%, shty terhiq 80%. 50% tjeter te sasise pa linje anesore per monitorimin e presionit, shty kercit 20%, shty -terhiq 70%, shtrengim me filetim 10%)	copë	1,500	1,500		
22	High pressure Angiographic Syring for single use for Medrad Injector Mark–Stellant (2x200 ml Syring;1 x 60” T-Connector and Prime Tube;2 x Spikes) (Set me shiringa Angiografike me presion te larte per perdorim unik per Injektor Medrad Mark–Stellant qe permban 2x200 ml Syring, 1 x 60” T-Connector and Prime Tube, 2 x Spikes)	copë	1,000	1,000		
23	Pressure Transducer for Cath-Lab Model Artis Zee Floor-Siemens (percjelles presioni per aparatin Siemens Artis Zee)	copë	5		5	
24	Transducer (diafragm) dome for use with pressure transducer for Cath-Lab Model Arsis Zee Floor Siemens (Diafragm dome per percjellesin e presionit e pershtatur per aparatin Simes-Artis Zee)	copë	10		10	
25	Monitoring set for pressure transducer adapted for Cath-Lab Model Arsis Zee Floor -Siemens (Set monitorimi per percjellesin e presionit e pershtatshme per aparatin Simes-Artis Zee)	copë	5		5	
26	Monitoring Set for pressure transducer adapted for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë	20	20		
27	Cable for pressure transducer adapted for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë	1	1		
28	Cable for ECG monitoring adapted for Philips Angiograph Model Allura Centron Sistem module 000400	copë	1	1		
29	Cable for ECG monitoring adapted for Siemens Angio-CT Model Somatom definition AS	copë	1	1		
30	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 6 F, (sheath length 10-13 cm, guidewire and needle ) Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 11 cm, guide dhe age)	copë	120	120		



Dokumentat Standarde të Tenderit

31	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 7 F, (sheath length 10-13 cm, guidewire and needle ) Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 11 cm, guide dhe age)	copë	65	65		
32	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 6 F (sheath length 16-23, guidewire and needle) Komplet sheath transradial me dilatator 6 F (gjatesi sheath 16-23 cm, guide dhe age)	copë	120	120		
33	Transradial kit sheath introducer with vessel dilator 7 F (sheath length 16-23, guidewire and needle) Komplet sheath transradial me dilatator 7 F (gjatesi sheath 16-23 cm, guide dhe age)	copë	65	65		
34	Contrast infusion set with hand syringe during angiography (set per infuzionin e kontrastit me shiringe dore gjate angiografise)	copë	3,000	3,000		
35	Kit radial - Radial sheath introducer 5 Fr, 10- 13cm, with mini-guide wire and needle, (Sheath radial 5Fr me gjatesi 10 -13 cm, gide te vogel dhe age)	copë	20		20	
36	Kit radial - Radial sheath introducer 6Fr, 10 - 13cm, with mini-guide wire and needle (Sheath radial 6Fr, me gjatesi 10 -13 cm, gide te vogel dhe age)	copë	650		150	500
37	Kit Radial - Radial sheath introducer 6 Fr, 20 - 25cm, with mini-guide wire and needle (Sheath radial 6 Fr, me gjatesi 20- 25 cm, gide te vogel dhe age)	copë	5		5	
38	Radial Artery Compression Device (Paisje per hemostaze te arteries radiale)	copë	10		10	

**Lot. 3 “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike”**

Nr	Materiale mjekesore	Njësia	Sasia Totale	Sasia/ QSUT	Sasia/ SUSN	Sasia/ Shkoder
<b>Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike</b>						
1	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.25 mm, 6-7 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	1		1	
2	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.25 mm, 9-10 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	1		1	
3	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.5 mm, 6-7 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	1		1	
4	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 1.5 mm, 9-10 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	1		1	
5	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,12-	copë	1		1	

## Dokumentat Standarde të Tenderit

	13mm					
6	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,14-16mm	copë	1		1	
7	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 2 mm, 6-7 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	1		1	
8	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 2 mm, 9-10 mm - (ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	1		1	
9	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 1.5mm,20 mm	copë	1		1	
10	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,12-13 mm	copë	1		1	
11	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, (ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,14-16 mm	copë	1		1	
12	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2 mm,20 mm	copë	1		1	
13	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 2.5 mm, 6-7 mm -(ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	1		1	
14	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers, 9-10 mm -(ballon gjysem kompleant me 2 marker)	copë	1		1	
15	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,12-13 mm	copë	1		1	
16	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,20 mm	copë	1		1	
17	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,12-13 mm	copë	1		1	
18	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 2.5 mm,14-16 mm	copë	1		1	
19	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,14-16 mm	copë	1		1	
20	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3 mm,20 mm	copë	1		1	
21	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,12-13 mm	copë	1		1	
22	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem kompleant me 2 marker) 3.5 mm,14-16 mm	copë	1		1	

Dokumentat Standarde të Tenderit

23	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem komplet me 2 marker) 3.5 mm,20 mm	copë	1		1	
24	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem komplet me 2 marker) 4 mm,12-13 mm	copë	1		1	
25	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter,2 markers,(ballon gjysem komplet me 2 marker) 4 mm,14-16 mm	copë	1		1	
26	Semi compliant Rapid exchange PTCA ballon catheter, 2 markers,(ballon gjysem komplet me 2 marker) 4 mm,20 mm	copë	1		1	
27	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 12-13 mm -	copë	121	120	1	
28	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 14-16 mm -	copë	121	120	1	
29	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 1.5 mm, 20 mm	copë	20	20		
30	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 12-13 mm -	copë	210	210		
31	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 14-16 mm -	copë	100	100		
32	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2 mm, 20 mm -	copë	100	100		
33	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 12-13 mm -	copë	100	100		
34	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 14-16 mm -	copë	200	200		
35	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 2.5 mm, 20 mm -	copë	160	160		
36	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 12-13 mm -	copë	250	250		
37	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 14-16 mm -	copë	260	260		
38	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3 mm, 20 mm -	copë	220	220		
39	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 12-13 mm -	copë	220	220		
40	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 14-16 mm -	copë	220	220		
41	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 3.5 mm, 20 mm -	copë	200	200		
42	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 12-13 mm -	copë	120	120		
43	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 14-16 mm -	copë	110	110		
44	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4 mm, 20 mm -	copë	80	80		
45	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4.5 mm, 14-16 mm -	copë	50	50		
46	Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4.5 mm, 20-22 mm -	copë	20	20		
47	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.5mm,6-8mm	copë	90	80	10	
48	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.5mm,9-10mm	copë	1		1	
49	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.5mm,12-14mm	copë	1		1	
50	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,6-8mm	copë	10		10	

Dokumentat Standarde të Tenderit

51	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,9-10mm	copë	10		10	
52	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,12-14mm	copë	1		1	
53	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,2.75mm,18-21mm	copë	1		1	
54	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,6-8mm	copë	10		10	
55	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,8-10mm	copë	10		10	
56	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,12-14mm	copë	1		1	
57	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter ,2 markers,3mm,18-21mm	copë	1		1	
58	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,8-10mm	copë	1		1	
59	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,10-12mm	copë	1		1	
60	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,14-16mm	copë	1		1	
61	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.25mm,18-21mm	copë	1		1	
62	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,6-8mm	copë	10		10	
63	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,8-10mm	copë	5		5	
64	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,10-12mm	copë	1		1	
65	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,14-16mm	copë	1		1	
66	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,3.5mm,18-21mm	copë	1		1	
67	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4mm,8-10mm	copë	5		5	
68	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4mm,12-13mm	copë	5		5	
69	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,4.5mm,14-16mm	copë	3		3	
70	Non compliant Rapid exchange PTCA catheter,2 markers,5mm,14-16mm	copë	2		2	
71	Rapid exchange PTCA catheter -over the wire ,2 markers,1.25, 6-7mm	copë	3		3	
72	Rapid exchange PTCA catheter -over the wire ,2 markers,1.25, 9-10mm	copë	3		3	
73	Rapid exchange PTCA catheter -over the wire ,2 markers,1.25-15mm	copë	3		3	
74	Rapid exchange PTCA catheter -over the wire ,2 markers,1.5, 6-7mm	copë	1		1	

## Dokumentat Standarde të Tenderit

75	Rapid exchange PTCA catheter -over the wire ,2 markers,1.5, 9-10mm	copë	1		1	
76	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Extra back up 3.0	copë	3		3	
77	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 3.0	copë	80	80		
78	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 3.5	copë	1,303	1,300	3	
79	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Extra back up 3.5	copë	3		3	
80	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 4.0	copë	100	100		
81	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 4.5	copë	30	30		
82	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Extra back up 5.0	copë	14	14		
83	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 3.0	copë	3		3	
84	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 3.5	copë	1		1	
85	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 4.0	copë	1		1	
86	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 4.5	copë	1		1	
87	Coronary guide catheter (without side holes) 6F, Left Judkins technique 5.0	copë	1		1	
88	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 3.5	copë	250	250		
89	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 4.0	copë	153	150	3	
90	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 4.5	copë	30	30		
91	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Judkins technique 5.0	copë	20	20		
92	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz I	copë	3		3	
93	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz II	copë	3		3	
94	Coronary guide catheter (without side holes)6F,left,Amplatz III	copë	3		3	
95	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz I	copë	30	30		
96	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz II	copë	20	20		
97	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Left, Amplatz III	copë	5	5		
98	IMA (internal mammary)	copë	23	20	3	
99	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right,judkins technique 3.0	copë	2		2	
100	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right,judkins technique 3.5	copë	20		20	
101	Coronary guide catheter (with side holes)6F, right judkins technique 3.5	copë	3		3	
102	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right judkins technique 4.0	copë	1		1	
103	Coronary guide catheter (without side holes)6F, right judkins technique 4.5	copë	3		3	

## Dokumentat Standarde të Tenderit

104	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.0	copë	100	100		
105	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.5	copë	903	900	3	
106	Coronary guide catheter (without Side holes) 7F, Right, Judkins technique 3.5	copë	3		3	
107	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 4.0	copë	90	90		
108	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Judkins technique 4.5	copë	20	20		
109	Coronary guide catheter (without side holes)6F, Right Amplatz I	copë	3		3	
110	Coronary guide catheter (without side holes)6F, Right Amplatz II	copë	3		3	
111	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Amplatz I	copë	60	60		
112	Coronary guide catheter (Side holes) 7F, Right, Amplatz II	copë	30	30		
113	Coronary guide catheter (without side holes)6F, Shepards crook right (guide kateter pa vrima anesore)	copë	3		3	
114	Coronary guide catheter (without side holes)6F, 3D RIGHT (guide kateter pa vrima anesore)	copë	3		3	
115	PTCA guidewire 0.014" (hydrophylic) floppy 180-200 cm	copë	3,560	3,500	60	
116	PTCA guidewire 0.014" (standart)	copë	99	59	40	
117	PTCA guidewire 0.014 (hydrophylic-extra floppy) 180-200cm. guide angioplastike e forte	copë	30		30	
118	PTCA guidewire 0.014 - (hydrophilic floppy) 300 cm, guida angioplastike (hidrofilike floppy) 300 cm	copë	30		30	
119	PTCA guidewire 0.014 (hydrophilic - extra floppy) 300cm, guida angioplastike e forte 300cm	copë	30		30	
120	Inflation device (Pistoleta e fryrjes se ballonit)	copë	2,050	2,000	50	
121	Set: Torque+metallic insertion tool for PCI guidewire in guiding catheter: Torqu+shiringe (age) metalike per futjen e e guides se PCI ne kateterin drejtues	copë	2,050	2,000	50	
122	Catheter for intra-aortal balloon for Autocat 2 equipment (Katetere per ballon intra-aortal te pershtatshem per aparatin Autocat 2)	copë	9	5		4

### Lot. 4 “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar”

Nr	Materiale mjekesore	Njësia	Sasia Totale	Sasia/ QSUT	Sasia/ SUSN	Sasia/ Shkoder
	<b>Drug Eluting Balloon catheter-kateter ballon i medikuar</b>					

Dokumentat Standarde të Tenderit

	Drug eluting balloon Catheter, catheter 145 cm, the RX design. The proxy. part spindle 2F, a dist.part 2,5F with max. accept wire 0.014 " FLEXITEC HF material, LFC hydrophilic coating that provides superior reliability and stability within the lesion during surgery. 1 or 2 Pt-Ir markers provide excellent visualization in the cylinder of the balloon. Nominal pressure of 7 bar and RPB 15-17 bar. The body of the balloon coated with the active substance (paclitaxel, sirolimus or zotarolimus), which is the time during the dilatation of 30-60 sec resorbed into the tissue. (Kateter ballon i medikuar, kateter 145 cm, me RX design. Pjesa e majes proximale 2F, pjesa ditale 2.5F qe pranon guide max 0.014", materjal flexitech, LFC hidrofilikeqe siguron stabilitet dhe arritje te lehte ne lezion gjate procedures. 1 deri 2 Pt-Ir marker qe te sigurojne nje shikueshmeri shume te mire te cilindrit te balonit. Presioni nominal 7 Bar dhe RPB 15-17 Bar. Trupi i ballonit i veshur me me substance aktive (paclitaxel ose sirolimus ose zotarolimus) i cili gjate kohes se fryrjes se ballonit prej 30-60 sek te reabsorbohet ne ind)	copë				
1	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker), 2.0 / 14-15mm	copë	5		5	
2	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.0 / 19-20mm	copë	1		1	
3	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.0 / 28-30mm	copë	1		1	
4	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.25 / 14-15mm	copë	5		5	
5	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2marker) 2.25 / 19-20mm	copë	1		1	
6	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.25 / 28-30mm	copë	1		1	
7	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/14-16 mm	copë	15	10	5	
8	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/18-20 mm	copë	11	10	1	
9	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/28-30 mm	copë	6	5	1	
10	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.5/40-42 mm	copë	1		1	
11	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/14-16 mm	copë	15	10	5	
12	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/18-20 mm	copë	11	10	1	
13	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 2.75/28-30 mm	copë	6	5	1	
14	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/14-16 mm	copë	15	10	5	
15	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/18-20 mm	copë	11	10	1	

## Dokumentat Standarde të Tenderit

16	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/28-30 mm	copë	6	5	1	
17	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.0/40-42 mm	copë	1		1	
18	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.25 / 14-15mm	copë	1		1	
19	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.25 / 19-20mm	copë	1		1	
20	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.25 / 28-30mm	copë	1		1	
21	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/14-16 mm	copë	11	10	1	
22	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/18-20 mm	copë	11	10	1	
23	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.5/28-30 mm	copë	6	5	1	
24	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.75 / 14-15mm	copë	1		1	
25	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.75 / 19-20mm	copë	1		1	
26	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 3.75 / 28-30mm	copë	1		1	
27	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 14.15mm	copë	1		1	
28	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 19-20mm	copë	1		1	
29	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 28-30mm	copë	1		1	
30	Drug-eluting balloon catheter with 2 markers (Ballon I medikuar me 2 marker) 4.0 / 40-42mm	copë	1		1	
31	Catheter for Aspiration of Thrombus: it should have two lumen, vacuum available in 6F and 7F, length 140-145 cm, compatible with 0.014" wire, in a set with two syringes and two filter basket. (Kateter per aspirim trombi: duhet te kete 2 lumene, vakum te vlefshem ne 6F dhe 7F, gjatesi 140-145 cm, kompatibel me guide 0.014", ne nje set me 2 shiringa dhe 2 filter basket)	copë	30	30		
32	Basket for interventional recovery of foreign bodies from vessels or hollow viscera, diameter 15mm, 3F, length 120cm, 4 helical nitinol wire. - Rrjete per nxjerrjen e trupave te huaj nga enet, diameter 15mm, 3F, gjatesi 120cm, 4 tela spiral ninitoli.	copë	3		3	
33	Snare Set with atraumatic nitinol Loop diameter 25mm – variable, Length 125cm, Introducer 110cm-5F. Set snare me lak atraumatik ninitoli ne diameter 25mm - variabel, gjatesi 125cm, Introduktor 110cm - 5F.	copë	3		3	

### Lot. 5 “Blerje stenta te pamedikuara”



Dokumentat Standarde të Tenderit

Nr	Materiale mjekesore	Njësia	Sasia Totale	Sasia/ QSUT	Sasia/ SUSN	Sasia/ Shkoder
<b>Stenta te pamedikuara</b>						
	Obligatory characteristics: architecture for flexibility, crossing profiles under 0.049 inch, thickness strut under 0.0038 inch, tested in multicentric studies for their efficacy and with American FDA and CE approvals) (Karakteristika te detyrueshme: arkitekture fleksible, me profil kalueshmerie nen 0.045 inch, dhe trashesine e strutit nen 0.0055 inch, te provuara ne studime multicentrike per efikasitet dhe te aprovuara nga FDA amerikane ose komuniteti europian CE)					
1	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.25 mm 12-13 mm	cope	20	20		
2	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.25 mm 14-16 mm	cope	20	20		
3	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.25 mm 18-20 mm	cope	30	30		
4	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.5 mm 8-10 mm	cope	20	20		
5	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.5 mm 12-13 mm	cope	30	30		
6	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.5 mm 14-16 mm	cope	50	50		
7	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.5 mm 18-20 mm	cope	80	80		
8	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.5 mm 23-24 mm	cope	80	80		
9	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.75 mm 8-10 mm	cope	20	20		
10	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.75 mm 12-13 mm	cope	20	20		
11	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.75 mm 14-16 mm	cope	40	40		
12	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.75 mm 18-20 mm	cope	55	55		
13	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.75 mm 23-24 mm	cope	50	50		
14	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 2.75 mm 26-28 mm	cope	70	70		
15	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 3.0 mm 8-10 mm	cope	30	30		
16	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 3.0 mm 12-13 mm	cope	50	50		
17	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 3.0 mm 14-16 mm	cope	50	50		
18	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkembim te shpejte) 3.0 mm 18-20 mm	cope	90	90		

Dokumentat Standarde të Tenderit

19	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.0 mm 23-24 mm	cope	100	100		
20	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.0 mm 26-28 mm	cope	80	80		
21	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.0 mm >30 mm	cope	80	80		
22	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.5 mm 8-10 mm	cope	30	30		
23	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.5 mm 12-13 mm	cope	40	40		
24	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.5 mm 14-16 mm	cope	80	80		
25	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.5 mm 18-20 mm	cope	100	100		
26	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.5 mm 23-24 mm	cope	100	100		
27	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.5 mm 26-28 mm	cope	70	70		
28	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 3.5 mm >30 mm	cope	75	75		
29	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.0 mm 12-13 mm	cope	30	30		
30	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.0 mm 14-16 mm	cope	40	40		
31	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.0 mm 18-20 mm	cope	30	30		
32	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.0 mm 23-24 mm	cope	20	20		
33	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.0 mm 26-28 mm	cope	20	20		
34	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.5 mm 14-16 mm	cope	5	5		
35	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.5 mm 18-20 mm	cope	5	5		
36	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.5 mm 23-24 mm	cope	5	5		
37	Rapid exchange delivery stents (Stent me shkëmbim të shpejtë) 4.5 mm 26-30 mm	cope	5	5		

**Lot. 6 “Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare”**

Nr	Materiale mjekesore	Njësia	Sasia Totale	Sasia/ QSUT	Sasia/ SUSN	Sasia/ Shkoder
	<b>Coronary stent graft system- Graft stente koronare</b>	cope				

## Dokumentat Standarde të Tenderit

	Coronary stent graft system, Micro-porous ePTFE graft material with one layer, CoCr single stent, 100% covered, 3 year shelf life, Guide Catheter Compatibility 5F for all sizes - Graft stente koronare, material mikroporoz ePTFE me nje shtrese, stent teke CoCr, 100% e veshur, jetegjatesi 3 vjet, kompatibel me Guide Kateter 5Fr per te gjitha permasat					
1	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /7-8 mm	cope	1		1	
2	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /11-12 mm	cope	1		1	
3	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /14-16 mm	cope	1	1		
4	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /18-20 mm	cope	1	1		
5	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /21-22 mm	cope	1		1	
6	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /24-26 mm	cope	1	1		
7	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.75 /14-16 mm	cope	1		1	
8	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 2.5 /21-22 mm	cope	1		1	
9	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /14-16 mm	cope	2	1	1	
10	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /18-20 mm	cope	2	1		1
11	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /21-22 mm	cope	1		1	
12	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.0 /24-26 mm	cope	1	1		
13	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /14-16 mm	cope	2	1	1	
14	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /18-20 mm	cope	1	1		

## Dokumentat Standarde të Tenderit

15	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /21-22 mm	cope	1		1	
16	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 3.5 /24-26 mm	cope	1	1		
17	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /14-16 mm	cope	2	1	1	
18	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /18-20 mm	cope	1	1		
19	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /21-22 mm	cope	1		1	
20	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.0 /24-26 mm	cope	1	1		
21	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.5 /14-16 mm	cope	1		1	
22	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 4.5 /21-22 mm	cope	1		1	
23	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 5.0 /14-16 mm	cope	1		1	
24	Coronary stent graft, micro porous ePTFE graft material, 100% covered (Graft Stent koronare material mikroporoz 100 i veshur) 5.0 /21-22 mm	cope	1		1	

### Lot. 7 “Blerje Stenta te medikuara”

Nr	Materiale mjekesore	Njësia	Sasia Totale	Sasia/ QSUT	Sasia/ SUSN	Sasia/ Shkoder
	Stenta te medikuara					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

	Drug-eluting stents covered with cytostatic drugs: serolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus. Obligatory characteristics: architecture for flexibility, cobalt or platinum alloy, crossing profiles under 0.049 inch, thickness strut under 0.0038 inch, tested in multicentric studies for their efficacy and with American FDA and CE approvals) (Stente te veshura me medikamente citostatike: serolimus, everolimus, biolimus ose zotarolimus. Karakteristika te detyrueshme: arkitekture fleksibile, material kobalt ose platinum, me profil kalueshmerie nen 0.049 inch, dhe trashesine e trutit nen 0.0038 inch, te provuar ne studime multicentrike, te randomizuara, per efikasitet dhe te aprovuara nga FDA amerikane ose Komun.Europian CE)	cope				
1	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 8-10 mm	cope	1		1	
2	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 12-14 mm	cope	30	30		
3	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 15-16 mm	cope	60	60		
4	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 18-20 mm	cope	85	80	5	
5	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 21-24 mm	cope	80	70	10	
6	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 25-28 mm	cope	111	110	1	
7	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.5 mm 32 mm	cope	1		1	
8	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 12-14 mm	cope	33	30	3	
9	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 15-16 mm	cope	67	60	7	
10	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 16-18 mm	cope	7		7	
11	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 18-20 mm	cope	110	100	10	
12	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 21-24 mm	cope	85	80	5	

## Dokumentat Standarde të Tenderit

13	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 25-28 mm	cope	101	100	1	
14	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.75 mm 32 mm	cope	1		1	
15	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 12-14 mm	cope	65	50	15	
16	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 15-16 mm	cope	97	80	17	
17	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 18-20 mm	cope	121	120	1	
18	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 21-24 mm	cope	121	120	1	
19	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 25-28 mm	cope	111	110	1	
20	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm >30 mm	cope	60	60		
21	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 32 mm	cope	1		1	
22	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 38 mm	cope	1		1	
23	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.0 mm 48 mm	cope	1		1	
24	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 12-14 mm	cope	71	60	11	
25	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 15-16 mm	cope	110	100	10	
26	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 18-20 mm	cope	121	120	1	
27	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 21-24 mm	cope	121	120	1	
28	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 25-28 mm	cope	81	80	1	

## Dokumentat Standarde të Tenderit

29	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm >30 mm	cope	81	80	1	
30	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 32 mm	cope	3		3	
31	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 38 mm	cope	1		1	
32	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 3.5 mm 48 mm	cope	1		1	
33	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 10-12 mm	cope	1		1	
34	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 14-16 mm	cope	21	20	1	
35	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 18-20 mm	cope	41	40	1	
36	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.0 mm 20-24 mm	cope	41	40	1	
37	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 10-12 mm	cope	1		1	
38	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 14-16 mm	cope	20	20		
39	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 18-20 mm	cope	31	30	1	
40	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 4.5 mm 20-24 mm	cope	30	30		
41	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 12-13 mm	cope	21	20	1	
42	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 15-16 mm	cope	33	30	3	
43	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 18-20 mm	cope	31	30	1	
44	Drug eluting (cytostatic: sirolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus) stents (Stente te veshura me medikament per angioplastike koronare) 2.25 mm 21-24 mm	cope	33	30	3	

## Lot. 8 “Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta te medikuara për restenoze”

Nr	Materiale mjekesore	Njësia	Sasia Totale	Sasia/ QSUT	Sasia/ SUSN	Sasia/ Shkoder
<b>Drug-eluting stent for restenosis- stenta te medikuara per restenoze</b>						
	Drug-eluting stent for restenosis, LM and bifurcation, Obligatory characteristics: Coronary stent that releases drug (drug-eluting) made of cobalt alloy (CoCr), markers of platinum iridium, sinusoidal technology connecting from one wire, or in combination CWT technology with the active component - cytostatic with anti-inflammatory and antiproliferative activity - Everolimus, Zotarolimus or Serolimus, the drug carries BioLinx polymer drug delivery through the 180 days, tested in multicentric studies for their efficacy, CE aproval for use in patients with diabetes or equivalent. (Stente te veshura me medikamente citostatike: Stente te veshura me me dikament per ristenoza, LM dhe bifurkime, Karakteristika te detyrueshme: Stent koronar qe leshon ilac (i medikuar) e perbere prej aliazh kobalti (CoCr), markues platinumium iridium, teknologji sinusoidale me lidhje nga nje tel, ose ne kombinim me teknologjine CWT me komponent aktiv, citostatik Everolimus, Zotarolimus ose Serolimus me aktivitet anti-inflamator dhe anti-proliferativ, mbajtësi i ilacit BioLinx polymer shperndan ilacin ne 180 dite, te provuara ne studime multicentrike per efikasitet, CE per perdorim ne pacient diabetik ose ekuivalent)	cope				
1	Diameter 2.0mm, gjatesi 7-8mm	cope	1		1	
2	Diameter 2.0mm, gjatesi 11-12mm	cope	1		1	
3	Diameter 2.0mm, gjatesi 15-16mm	cope	1		1	
4	Diameter 2.0mm, gjatesi 18-19mm	cope	1		1	
5	Diameter 2.0mm, gjatesi 21-22mm	cope	1		1	
6	Diameter 2.0mm, gjatesi 26-27mm	cope	1		1	
7	Diameter 2.0mm, gjatesi 29-30mm	cope	1		1	
8	Diameter 2.25mm, gjatesi 7-8mm	cope	1		1	
9	Diameter 2.25mm, gjatesi 11-12mm	cope	1		1	
10	Diameter 2.25mm, gjatesi 15-16mm	cope	1		1	
11	Diameter 2.25mm, gjatesi 18-19mm	cope	1		1	
12	Diameter 2.25mm, gjatesi 21-22mm	cope	1		1	
13	Diameter 2.25mm, gjatesi 25-26mm	cope	1		1	
14	Diameter 2.25mm, gjatesi 29-30mm	cope	1		1	
15	Diameter 2.25mm, gjatesi 33-34mm	cope	1		1	
16	Diameter 2.25mm, gjatesi 37-38mm	cope	1		1	
17	Diameter 2.50mm, gjatesi 7-8mm	cope	1		1	
18	Diameter 2.50mm, gjatesi 11-12mm	cope	1		1	
19	Diameter 2.50mm, gjatesi 15-16mm	cope	1		1	
20	Diameter 2.50mm, gjatesi 18-19mm	cope	1		1	



## Dokumentat Standarde të Tenderit

21	Diameter 2.50mm, gjatesi 21-22mm	cope	1		1	
22	Diameter 2.50mm, gjatesi 25-26mm	cope	1		1	
23	Diameter 2.50mm, gjatesi 29-30mm	cope	1		1	
24	Diameter 2.50mm, gjatesi 33-34mm	cope	1		1	
25	Diameter 2.50mm, gjatesi 37-38mm	cope	1		1	
26	Diameter 2.75mm, gjatesi 7-8mm	cope	1		1	
27	Diameter 2.75mm, gjatesi 11-12mm	cope	1		1	
28	Diameter 2.75mm, gjatesi 15-16mm	cope	1		1	
29	Diameter 2.75mm, gjatesi 18-19mm	cope	1		1	
30	Diameter 2.75mm, gjatesi 21-22mm	cope	1		1	
31	Diameter 2.75mm, gjatesi 25-26mm	cope	1		1	
32	Diameter 2.75mm, gjatesi 29-30mm	cope	1		1	
33	Diameter 2.75mm, gjatesi 33-34mm	cope	1		1	
34	Diameter 2.75mm, gjatesi 37-38mm	cope	1		1	
35	Diameter 3.0mm, gjatesi 7-8mm	cope	1		1	
36	Diameter 3.0mm, gjatesi 11-12mm	cope	1		1	
37	Diameter 3.0mm, gjatesi 15-16mm	cope	1		1	
38	Diameter 3.0mm, gjatesi 18-19mm	cope	1		1	
39	Diameter 3.0mm, gjatesi 21-22mm	cope	1		1	
40	Diameter 3.0mm, gjatesi 25-26mm	cope	1		1	
41	Diameter 3.0mm, gjatesi 29-30mm	cope	1		1	
42	Diameter 3.0mm, gjatesi 33-34mm	cope	1		1	
43	Diameter 3.0mm, gjatesi 37-38mm	cope	1		1	
44	Diameter 3.5mm, gjatesi 7-8mm	cope	1		1	
45	Diameter 3.5mm, gjatesi 11-12mm	cope	1		1	
46	Diameter 3.5mm, gjatesi 15-16mm	cope	1		1	
47	Diameter 3.5mm, gjatesi 18-19mm	cope	1		1	
48	Diameter 3.5mm, gjatesi 21-22mm	cope	1		1	
49	Diameter 3.5mm, gjatesi 25-26mm	cope	1		1	
50	Diameter 3.5mm, gjatesi 29-30mm	cope	1		1	
51	Diameter 3.5mm, gjatesi 33-34mm	cope	1		1	
52	Diameter 3.5mm, gjatesi 37-38mm	cope	1		1	
53	Diameter 4.0mm, gjatesi 11-12mm	cope	1		1	
54	Diameter 4.0mm, gjatesi 15-16mm	cope	1		1	
55	Diameter 4.5mm, gjatesi 18-19mm	cope	1		1	
56	Diameter 4.5mm, gjatesi 21-22mm	cope	1		1	
57	Diameter 5.0mm, gjatesi 11-12mm	cope	1		1	

### Afatet e lëvrimit:

Për arsye të krijimit të një sigurie në lëvrimin e mallit pa krijuar vonesa dhe mbulimin në kohe dhe pa probleme të shërbimit, Autoritetet Kontraktore do të lidhin me operatorin ekonomik fitues të dalë nga procedura e prokurimit, kontratë bazuar në nevojat e tyre për materialet objekt

## Dokumentat Standarde të Tenderit

i kësaj procedure prokurimi çdo 4 muaj, ku 50% e sasisë totale të parashikuar, duhet të kontraktohet që në 4 mujorin e pare, në 4 mujorin e dytë të kontraktohet jo më shumë se 25%, në 4 mujorin e tretë të kontraktohet 25% i fundit i sasisë së materialeve të planifikuara, përveç QSUT-se e cila do të lidhë kontratë në bazë të nevojave të saj në çdo 4 mujor.

Perjashtimisht këtij përcaktimi, autoritetet kontraktore mund të lidhin kontratë për çdo nevojë për materiale të listes së planifikuar, që del e parashikuar dhe është e domosdoshme në çdo kohë.

Per çdo kontratë të lidhur sipas përcaktimit më sipër afatet e lëvrimit do të jënë si më poshtë:

- 15% e sasisë duhet të levrohet brenda 20 diteve nga data e nënshkrimit të kontratës.
- pjesa e mbetur e sasisë duhet të levrohet deri në përfundim të kontratës dhe sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.



### Shtojca 13

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

## NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR<sup>1</sup>

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

---

---

---

---

---

---

---

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt  
< **Emri** >



### Shtojca 14

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

## FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Dokumentat Standarde të Tenderit

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*numri i NIPT-it*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*numri i NIPT-it*

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Public Health Sector

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues*] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [*shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*]/pikët totale të marra [\_\_\_\_\_]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [*vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

\* \* \*

[ Titullari i autoritetit kontraktor]



**Shtojca 15**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM  
NË MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i referencës së procedurës/lotit: \_\_\_\_\_

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

\_\_\_\_\_

*numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_

*(me numra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

\_\_\_\_\_

*numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_

*(me numra dhe fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

\_\_\_\_\_

*numri i NIPT-it*

Dokumentat Standarde të Tenderit

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_ *numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyt e mëposhtme:

---

---

---

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_ *numri i NIPT-it*  
Vlera \_\_\_\_\_ / Pikët totale të marra \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_ *numri i NIPT-it*  
Vlera \_\_\_\_\_ / Pikët totale të marra \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*], brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_  
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

[Titullari i autoritetit kontraktor]

## Shtojca 16

### **KUSHTET E PËRGJITHSHME** **Mallrat – Tender i Hapur**

#### **Neni 1: Qëllimi**

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruarra me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

#### **Neni 2: Përkufizime**

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi, tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi,



kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.

- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizime të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

### **Neni 3: Hartimi i Kontratës**

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

### **Neni 4: Praktikant e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve**

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

## **Neni 5: Informacioni Konfidencial**

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

## **Neni 6: Pronësia Intelektuale**

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruar nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

## **Neni 7: Origjina e Mallrave**

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

#### **Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet**

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

#### **Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike**

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës së shitesit (Kontraktuesit).

#### **Neni 10: Pjesët e Këmbimit**

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.

- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

#### **Neni 11: Ambalazhimi**

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe paketuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe paketuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

#### **Neni 12: Testimet dhe Inspektimet**

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës.
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimin.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

#### **Neni 13: Kushtet e Dorëzimit**

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit

përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

#### **Neni 14 Transportimi i Mallrave**

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuar në kontratë.
- 14.2 Në Autoriteti Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e rrishtit.

#### **Neni 15: Siguracioni**

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

#### **Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave**

- 16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.
- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

## **Neni 17: Garancitë**

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defektoze ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

## **Neni 18: Çmimi i Kontratës**

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.
- 18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin,

udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

### **Neni 19: Afatet e Pagesës**

- 19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.
- 19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.
- 19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.
- 19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

### **Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës**

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

### **Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve**

- 21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

### **Neni 22: Forca Madhore**

- 22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.
- 22.2 Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të

Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor goftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

### **Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit**

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbrësë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shumja e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

### **Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar**

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
  - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
  - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.



### **Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet**

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

### **Neni 26: Ndryshimi i Porosisë**

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

### **Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim**

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
  - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

### **Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit**

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

### **Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..

29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndër marrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

### **Neni 30: Nënkontraktimi**

30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.

30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.

30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

### **Neni 31: Transferimi i të Drejtave**

31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

### **Neni 32: Sigurimi i Kontratës**

32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.

32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

### **Neni 33: Baza Ligjore**

33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

**Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve**

- 34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.
- 34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

**Neni 35: Përfaqësimi i Palëve**

- 35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.
- 35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

**Neni 36: Lajmërimet**

- 36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

**Neni 37: Llogaritja e Afateve**

- 37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

## Shtojca 17

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### **KUSHTET E VEÇANTA Mallrat – Procedurë e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

#### **Neni 1: Përkufizime**

1.1 Autoriteti Kontraktor është \_\_\_\_\_

1.2 Kontraktuesi është \_\_\_\_\_

#### **Neni 2: Sigurimi i Kontrates**

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 3: Fillimi i Zbatimit**

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më \_\_\_\_\_. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

#### **Neni 4: Inspektimet dhe Testimet**

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 5: Kushtet e Dorëzimit**

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimit të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor \_\_\_\_\_ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.

5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 6: Kushtet e Pagesës**

6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vone që të vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

6.2 Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

#### **Neni 7. Pagesa Paraprake**

7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.

7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to**

8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës**

9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

## Shtojca 18

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

#### Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

##### 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja në Internet \_\_\_\_\_

##### 1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:



#### Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit \_\_\_\_\_

##### 2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

##### 2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

**Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo**

**2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës**

1. Fondi limit \_\_\_\_\_
2. Burimi i Financimit \_\_\_\_\_
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

**2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:**

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

**2.6 Ndarja në LOTE:**



Nëse Po, numri i LOTEVE:

**2.7 Opsionet:**

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

ose: nga në

**2.8 Kontrate me nenkontraktim:**

Po

Jo

**Seksioni 3. Procedura**

**3.1 Lloji i procedurës: E Hapur**

**3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme


lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë  
etj. pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

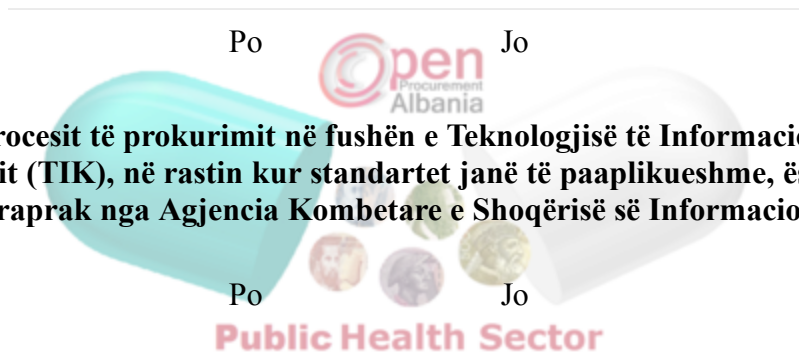

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: \_\_\_\_\_ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri \_\_\_\_\_



## Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

### 4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_  
Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

#### 4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_  
Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

### 4.4 Informacione shtesë

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //

**Public Health Sector**

**Shtojca 18/1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja në Internet \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër** \_\_\_\_\_

**4. Numri i referencës së procedurës/lotit** \_\_\_\_\_

**5. Fondi limit** \_\_\_\_\_

**6. Vlera totale përfundimtare e kontratës** (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

Vlera e nenkontraktimit \_\_\_\_\_ me Tvsh Monedha \_\_\_\_\_

**7. Data e lidhjes së kontratës** \_\_\_\_\_

**7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Nr. NIPT \_\_\_\_\_

## Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]


Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

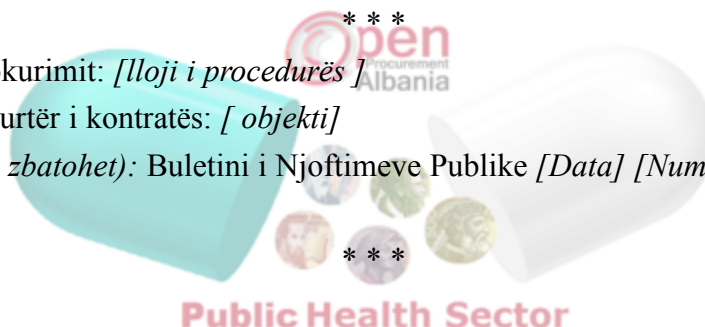

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

## Shtojca 20

### FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

*Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor*

#### Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti



Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

**Public Health Sector**

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

## Seksioni II. Informacion për Procedurën

### 1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

### 2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

### 3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

### 4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

### 5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

### 6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita)

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

## Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

### 1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkëljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

### 2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

## Dokumentat Standarde të Tenderit

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.*

### 3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

**Nr. Faks:** \_\_\_\_\_

**E-mail:** \_\_\_\_\_

**Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit**

**Shtojca 21**

**DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR  
( KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)  
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr \_\_

**DATA:**

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

**Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:


---

**Neni 2 Çmimi**

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

**Nënshkrimet dhe Datat**

<b>Për Kontraktuesin</b>		<b>Për Autoritetin Kontraktues</b>	
<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

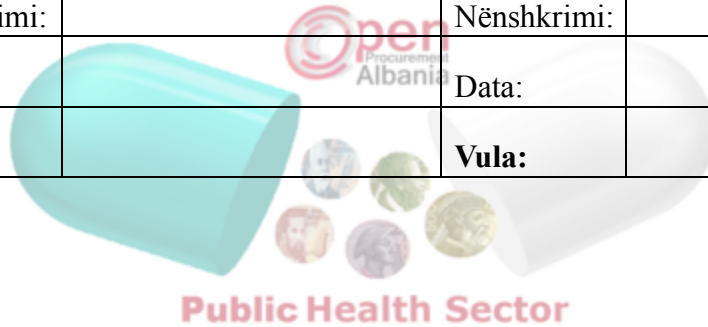

**Shtojca 22**

**DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR  
( KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)  
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**



## **Emri i Autoritetit Kontraktues,**

Dhe

## **Emri i Kontraktuesit**

Bien dakord si vijon:

**Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin :** < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

## **Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

## **Neni 2 Detyrimet e Palëve**

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

## **Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër**

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

## **Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës**

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor

duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

**Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër**

**Nënshkrimet dhe datat**

<b>Për Kontraktuesin</b>		<b>Për Autoritetin Kontraktues</b>	
<b>Emri :</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

**Shtojca 23**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT**

**1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
 Adresa \_\_\_\_\_  
 Tel/Fax \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_

Faqja në Internet \_\_\_\_\_

1. **Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

2. **Numri i Referencës:** \_\_\_\_\_

3. **Objekti i kontratës** \_\_\_\_\_

4. **Fondi limit** \_\_\_\_\_

5. **Arsyet e Anulimit:**

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. \_\_\_\_\_

6. **Informacione shtesë**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi \_\_\_\_\_

  
**Public Health Sector**