



## REPUBLIKA E SHQIPERISË AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK



### DOKUMENTAT STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR SHËRBIME

**OBJEKTI:** Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2018 e ndare ne lote

**FOND LIMIT:** 116.987.234,50 (njeqind e gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e tridhjetë e katër pikë pesëdhjetë) lekë pa TVSH

**NR.REF:** REF-66028-04-30-2018

## I. NJOFTIMI I KONTRATËS

### Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

#### 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza”  
 Adresa Rruga e Dibres Nr. 372, Tirane  
 Tel/Fax Tel. +355 42 362 627 Fax. +355 42 363 644  
 E-mail [sek.juridik.qsut@gmail.com](mailto:sek.juridik.qsut@gmail.com)  
 Faqja e Internetit [www.qsut.gov.al](http://www.qsut.gov.al)

#### 1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror

Institucion i pavarur

Njësi e qeverisjes vendore

Tjetër

#### 1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër



### Seksioni 2

#### Objekti i kontratës

Public Health Sector

#### 2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit REF-66028-04-30-2018

Nr	Lotet	Nr Ref se lotit
1	Loti 1: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike prodhuesi ACL 9000/ ose ekuivalent	REF-66033-04-30-2018
2	Loti 2: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike, prodhuesit ABX/ ose ekuivalent	REF-66035-04-30-2018
3	Loti 3: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike prodhuesi BECKMAN COULTER/ ose ekuivalent	REF-66038-04-30-2018
4	Loti 4: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike te prodhuesi DPC (Siemens)/ ose ekuivalent	REF-66041-04-30-2018
5	Loti 5: Mirëmbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi DRAGER/ ose ekuivalent	REF-66044-04-30-2018
6	Loti 6: Mirëmbajtje e pajisjeve te anestezise prodhuesi MEDEC/ ose ekuivalent	REF-66046-04-30-2018
7	Loti 7: Mirëmbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi SIARE PERSEO/ ose ekuivalent	REF-66048-04-30-2018
8	Loti 8: Mirëmbajtje e pajisjeve te Dializes prodhuesi FRESENIUS/ ose ekuivalent	REF-66050-04-30-2018
9	Loti 9: Mirëmbajtje e pajisjes te Dializes prodhuesi HOSPAL/ ose ekuivalent	REF-66052-04-30-2018
10	Loti 10: Mirëmbajtje e pajisjes EEG EMG te prodhuesi NIHON KOHDEN/ ose ekuivalent	REF-66055-04-30-2018

## Dokumentat standarde të tenderit

11	Loti 11: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM/ ose ekuivalent	REF-66060-04-30-2018
12	Loti 12: Mirëmbajtje e pajisjes Grafi prodhuesit Shimadzu/ ose ekuivalent	REF-66071-04-30-2018
13	Loti 13: Mirëmbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSENS/ ose ekuivalent	REF-66075-04-30-2018
14	Loti 14: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator prodhuesi ACOMA/ ose ekuivalent	REF-66078-04-30-2018
15	Loti 15: Mirëmbajtje e pajisjes Aspirator Ultrasonic prodhuesi INTEGRA LifeSciences Corporation/ ose ekuivalent	REF-66080-04-30-2018
16	Loti 16: Mirëmbajtje e pajisjeve Aspirator prodhuesi MIZUHO/ ose ekuivalent	REF-66082-04-30-2018
17	Loti 17: Mirëmbajtje e pajisjeve Autoanalizator prodhuesi OLYMPUS/ ose ekuivalent	REF-66084-04-30-2018
18	Loti 18: Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	REF-66086-04-30-2018
19	Loti 19: Mirëmbajtje e pajisjes CO2 Laser prodhuesi LUMENIS/ ose ekuivalent	REF-66088-04-30-2018
20	Loti 20: Mirëmbajtje e disa pajisjeve te prodhuesi GE/ ose ekuivalent	REF-66090-04-30-2018
21	Loti 21: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ ose ekuivalent	REF-66092-04-30-2018
22	Loti 22: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	REF-66095-04-30-2018
23	Loti 23: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	REF-66099-04-30-2018
24	Loti 24: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi ESAOTE/ ose ekuivalent	REF-66101-04-30-2018
25	Loti 25: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SIEMENS/ ose ekuivalent	REF-66103-04-30-2018
26	Loti 26: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SAMSUNG MEDISON/ ose ekuivalent	REF-66105-04-30-2018
27	Loti 27: Mirëmbajtje e pajisje Imazherike prodhuesi TOSHIBA/ ose ekuivalent	REF-66107-04-30-2018
28	Loti 28: Mirëmbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET/ ose ekuivalent	REF-66109-04-30-2018
29	Loti 29: Mirëmbajtje e pajisjeve te KardioKirurgjise prodhuesi TERUMO/ ose ekuivalent	REF-66111-04-30-2018
30	Loti 30: Mirëmbajtje e pajisjeve Elektroforeze prodhuesi SEBIA/ ose ekuivalent	REF-66113-04-30-2018
31	Loti 31: Mirëmbajtje e pajisjes neuroendoskopike prodhuesi Aesculap/ ose ekuivalent	REF-66115-04-30-2018
32	Loti 32: Mirëmbajtje e pajisjes Endoskopike prodhuesi PENTAX/ ose ekuivalent	REF-66117-04-30-2018
33	Loti 33: Mirëmbajtje e pajisjes FAKO prodhuesi ALCON/ ose ekuivalent	REF-66119-04-30-2018
34	Loti 34: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi CARL STORZ/ ose ekuivalent	REF-66121-04-30-2018
35	Loti 35: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi OLYMPUS/ ose ekuivalent	REF-66123-04-30-2018
36	Loti 36: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	REF-66125-04-30-2018
37	Loti 37: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi/Skopi te prodhuesi Philips/ ose ekuivalent	REF-66127-04-30-2018
38	Loti 38: Mirëmbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave/ ose ekuivalent	REF-66129-04-30-2018
39	Loti 39: Mirëmbajtje e pajisjes intraaortik Ballon prodhuesit ARROË Telefles/ ose ekuivalent	REF-66132-04-30-2018
40	Loti 40: Mirëmbajtje e pajisjeve Inhalator prodhuesi KOUSHIN INDUSTRIES/ ose ekuivalent	REF-66135-04-30-2018

## Dokumentat standarde të tenderit

41	Loti 41: Mirëmbajtje e pajisjeve Inkubator prodhuesi NAKAMURA dhe ATOM/ ose ekuivalent	REF-66137-04-30-2018
42	Loti 42: Mirëmbajtje e pajisjes Lithotripter prodhuesi STORZ MEDICAL/ ose ekuivalent	REF-66139-04-30-2018
43	Loti 43: Mirëmbajtje e pajisjes MAMOGRAF prodhuesi IMS GIOTTO/ ose ekuivalent	REF-66142-04-30-2018
44	Loti 44: Mirëmbajtje e pajisjes Mikroskop, prodhuesi ZEISS/ ose ekuivalent	REF-66144-04-30-2018
45	Loti 45: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden/ ose ekuivalent	REF-66146-04-30-2018
46	Loti 46: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti, prodhuesi DRAGER/ ose ekuivalent	REF-66148-04-30-2018
47	Loti 47: Mirëmbajtje e pajisjes Neuronavigator prodhuesi MEDTRONIC/ ose ekuivalent	REF-66150-04-30-2018
48	Loti 48: Mirëmbajtje e pajisjes EMG prodhuesi MICROMED/ ose ekuivalent	REF-66152-04-30-2018
49	Loti 49: Mirëmbajtje e pajisjes Body Box prodhuesi JAEGER/ ose ekuivalent	REF-66155-04-30-2018
50	Loti 50: Mirëmbajtje e pajisjeve Pompa Infuzioni, prodhuesi NAKAMURA MEDICAL/ ose ekuivalent	REF-66157-04-30-2018
51	Loti 51: Mirëmbajtje e pajisjes C-Arm te prodhuesit SIEMENS/ ose ekuivalent	REF-66159-04-30-2018
52	Loti 52: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesit DRAGER/ ose ekuivalent	REF-66161-04-30-2018
53	Loti 53: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesi NEWPORT/ ose ekuivalent	REF-66164-04-30-2018
54	Loti 54: Mirëmbajtje e pajisjeve respirator te prodhuesit VIASYS Healthcare/ ose ekuivalent	REF-66166-04-30-2018
55	Loti 55: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre prodhuesi AESCULAP/ ose ekuivalent	REF-66168-04-30-2018
56	Loti 56: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre Oshilante prodhuesi DE SOUTER/ ose ekuivalent	REF-66170-04-30-2018
57	Loti 57: Mirëmbajtje e Shiringave Elektrike prodhuesi ATOM MEDICAL/ ose ekuivalent	REF-66172-04-30-2018
58	Loti 58: Mirëmbajtje e monitoreve dhe sistemit te monitorimit te pacientit prodhuesi Philips/ ose ekuivalent	REF-66174-04-30-2018
59	Loti 59: Mirëmbajtje e pajisjes Spirometer prodhuesi CHEST/ ose ekuivalent	REF-66176-04-30-2018
60	Loti 60: Mirëmbajtje e pajisjes TREADMILL prodhuesit CARDIOLINE/ ose ekuivalent	REF-66179-04-30-2018
61	Loti 61: Mirëmbajtje e pajisjes endoskopike prodhuesi FUJINON/ ose ekuivalent	REF-66181-04-30-2018
62	Loti 62: Mirëmbajtje e pajisjes video EEG prodhuesi Viasys Healthcare/ ose ekuivalent	REF-66183-04-30-2018
63	Loti 63: Furnizim vendosje e kokes goditese e litotripterit Modulith SLX-F2/ ose ekuivalent Nr. Inventari 19241	REF-66185-04-30-2018
64	Loti 64: Furnizim Vendosje Sonde Lineare për Eko prodhuesi Philips/ ose ekuivalent, Modeli EnVisor CHD nr. inventari 30988.	REF-66187-04-30-2018
65	Loti 65: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko prodhuesi GE/ ose ekuivalent, Modeli VIVID E9 nr. inventari 21970.	REF-66189-04-30-2018
66	Loti 66: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko Prodhuiesi ESAOTE/ ose ekuivalent, modeli MYLAB 50 XVISION me nr. inventari 19445	REF-66191-04-30-2018
67	Loti 67: Furnizim Vendosje te motorit te ventilimit dhe bordit kryeso për incubator prodhuesi GE/ ose ekuivalent, Modeli GIRAFFE INCUBATOR me nr. inventari 20953	REF-66193-04-30-2018
68	Loti 68: Furnizim Vendosje TouchScreen dhe Bateri për Defibrilatorin prodhuesi	REF-66195-04-30-

Philips/ ose ekuivalent, modeli MRX me nr. inventari 21975	2018
------------------------------------------------------------	------

## 2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

<b>Konkurs Projektimi</b>	<b>Shërbime Konsulence</b>	<b>Shërbime të tjera</b>
		✓

## 2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po	Jo	✓
----	----	---

## 2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë \_\_\_\_\_

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara **Po** **Jo**

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: \_\_\_\_\_ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike	
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2.7 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: \_\_\_\_\_

## 2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit **116.987.234,50** (njqind e gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e tridhjetë e katër pikë pesëdhjetë) **lekë pa TVSH**
2. Burimi i Financimit **Buxheti i Shtetit për vitin 2018**
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: **“Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2018”** e ndare ne lote

## 2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë **30 dite** (per lotet 63-68)

ose

duke filluar nga **16/05/2018** me përfundim në **31/12/2018** (per lotet 1- 62. Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per keto lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)

### 2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

**Kohëzgjatja në muaj:** ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)

Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)

### 2.10 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:

### 2.11 Ndarja në Lote:

Nëse po,

### 2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

“Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2018” e ndare ne lote si më poshtë:

Nr	Lotet	Vlera pa TVSH
1	Loti 1: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike prodhuesi ACL 9000/ ose ekuivalent	565.818,40
2	Loti 2: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike, prodhuesit ABX/ ose ekuivalent	569.516,80
3	Loti 3: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike prodhuesi BECKMAN COULTER/ ose ekuivalent	2.100.665,90
4	Loti 4: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike te prodhuesi DPC (Siemens)/ ose ekuivalent	909.889,20
5	Loti 5: Mirëmbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi DRAGER/ ose ekuivalent	2.103.299,40
6	Loti 6: Mirëmbajtje e pajisjeve te anestezise prodhuesi MEDEC/ ose ekuivalent	3.072.687,30
7	Loti 7: Mirëmbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi SIARE PERSEO/ ose ekuivalent	1.840.002,30
8	Loti 8: Mirëmbajtje e pajisjeve te Dializes prodhuesi FRESENIUS/ ose ekuivalent	4.267.314,20
9	Loti 9: Mirëmbajtje e pajisjes te Dializes prodhuesi HOSPAL/ ose ekuivalent	5.088.543,00
10	Loti 10: Mirëmbajtje e pajisjes EEG EMG te prodhuesi NIHON KOHDEN/ ose ekuivalent	788.111,10
11	Loti 11: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM/ ose ekuivalent	2.791.546,80
12	Loti 12: Mirëmbajtje e pajisjes Grafi prodhuesit Shimadzu/ ose ekuivalent	418.600,00
13	Loti 13: Mirëmbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSSENS/ ose ekuivalent	1.381.759,50
14	Loti 14: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator prodhuesi ACOMA/ ose ekuivalent	559.668,20
15	Loti 15: Mirëmbajtje e pajisjes Aspirator Ultrasonic prodhuesi INTEGRA LifeSciences Corporation/ ose ekuivalent	1.497.914,10
16	Loti 16: Mirëmbajtje e pajisjeve Aspirator prodhuesi MIZUHO/ ose ekuivalent	428.582,00



## Dokumentat standarde të tenderit

17	Loti 17: Mirëmbajtje e pajisjeve Autoanalizator prodhuesi OLYMPUS/ ose ekuivalent	1.595.914,80
18	Loti 18: Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	1.402.530,80
19	Loti 19: Mirëmbajtje e pajisjes CO2 Laser prodhuesi LUMENIS/ ose ekuivalent	592.344,30
20	Loti 20: Mirëmbajtje e disa pajisjeve te prodhuesi GE/ ose ekuivalent	1.199.645,50
21	Loti 21: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ ose ekuivalent	453.744,00
22	Loti 22: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	786.682,80
23	Loti 23: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	6.100.165,80
24	Loti 24: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi ESAOTE/ ose ekuivalent	832.022,70
25	Loti 25: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SIEMENS/ ose ekuivalent	2.523.960,20
26	Loti 26: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SAMSUNG MEDISON/ ose ekuivalent	2.747.428,20
27	Loti 27: Mirëmbajtje e pajisje Imazherike prodhuesi TOSHIBA/ ose ekuivalent	3.158.668,20
28	Loti 28: Mirëmbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET/ ose ekuivalent	1.045.626,00
29	Loti 29: Mirëmbajtje e pajisjeve te KardioKirurgjise prodhuesi TERUMO/ ose ekuivalent	1.346.668,40
30	Loti 30: Mirëmbajtje e pajisjeve Elektroforeze prodhuesi SEBIA/ ose ekuivalent	694.928,90
31	Loti 31: Mirëmbajtje e pajisjes neuroendoskopike prodhuesi Aesculap/ ose ekuivalent	1.484.196,90
32	Loti 32: Mirëmbajtje e pajisjes Endoskopike prodhuesi PENTAX/ ose ekuivalent	121.334,20
33	Loti 33: Mirëmbajtje e pajisjes FAKO prodhuesi ALCON/ ose ekuivalent	1.014.263,20
34	Loti 34: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi CARL STORZ/ ose ekuivalent	7.353.967,10
35	Loti 35: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi OLYMPUS/ ose ekuivalent	1.402.195,00
36	Loti 36: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	798.895,80
37	Loti 37: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi/Skopi te prodhuesi Philips/ ose ekuivalent	6.512.289,00
38	Loti 38: Mirëmbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave/ ose ekuivalent	1.394.830,40
39	Loti 39: Mirëmbajtje e pajisjes intraaortik Ballon prodhuesit ARROË Teleflës/ ose ekuivalent	385.604,20
40	Loti 40: Mirëmbajtje e pajisjeve Inhalator prodhuesi KOUCHIN INDUSTRIES/ ose ekuivalent	604.750,50
41	Loti 41: Mirëmbajtje e pajisjeve Inkubator prodhuesi NAKAMURA dhe ATOM/ ose ekuivalent	843.329,50
42	Loti 42: Mirëmbajtje e pajisjes Lithotripter prodhuesi STORZ MEDICAL/ ose ekuivalent	3.277.060,70
43	Loti 43: Mirëmbajtje e pajisjes MAMOGRAF prodhuesi IMS GIOTTO/ ose ekuivalent	3.090.447,90
44	Loti 44: Mirëmbajtje e pajisjes Mikroskop, prodhuesi ZEISS/ ose ekuivalent	1.686.665,90
45	Loti 45: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden/ ose ekuivalent	1.154.519,50
46	Loti 46: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti, prodhuesi DRAGER/ ose ekuivalent	560.873,40
47	Loti 47: Mirëmbajtje e pajisjes Neuronavigator prodhuesi MEDTRONIC/ ose ekuivalent	3.847.118,00
48	Loti 48: Mirëmbajtje e pajisjes EMG prodhuesi MICROMED/ ose ekuivalent	511.492,40
49	Loti 49: Mirëmbajtje e pajisjes Body Box prodhuesi JAEGER/ ose ekuivalent	537.947,00
50	Loti 50: Mirëmbajtje e pajisjeve Pompa Infuzioni, prodhuesi NAKAMURA MEDICAL/ ose ekuivalent	439.415,00
51	Loti 51: Mirëmbajtje e pajisjes C-Arm te prodhuesit SIEMENS/ ose ekuivalent	1.149.802,20
52	Loti 52: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesit DRAGER/ ose ekuivalent	3.234.393,40
53	Loti 53: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesi NEWPORT/ ose ekuivalent	1.298.120,00
54	Loti 54: Mirëmbajtje e pajisjeve respirator te prodhuesit VIASYS Healthcare/ ose ekuivalent	4.291.294,00
55	Loti 55: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre prodhuesi AESCULAP/ ose ekuivalent	989.466,90
56	Loti 56: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre Oshilante prodhuesi DE SOUTER/ ose ekuivalent	153.334,10
57	Loti 57: Mirëmbajtje e Shiringave Elektrike prodhuesi ATOM MEDICAL/ ose ekuivalent	2.099.083,50

Dokumentat standarde të tenderit

58	Loti 58: Mirëmbajtje e monitoreve dhe sistemit të monitorimit të pacientit prodhuesi Philips/ ose ekuivalent	5.356.654,00
59	Loti 59: Mirëmbajtje e pajisjes Spirometer prodhuesi CHEST/ ose ekuivalent	260.665,90
60	Loti 60: Mirëmbajtje e pajisjes TREADMILL prodhuesit CARDIOLINE/ ose ekuivalent	806.906,70
61	Loti 61: Mirëmbajtje e pajisjes endoskopike prodhuesi FUJINON/ ose ekuivalent	1.181.919,40
62	Loti 62: Mirëmbajtje e pajisjes video EEG prodhuesi Viasys Healthcare/ ose ekuivalent	438.150,00
63	Loti 63: Furnizim vendosje e kokës goditese e litotripterit Modulith SLX-F2/ ose ekuivalent Nr. Inventari 19241	2.870.000,00
64	Loti 64: Furnizim Vendosje Sonde Lineare për Eko prodhuesi Philips/ ose ekuivalent, Modeli EnVisor CHD nr. inventari 30988.	850.000,00
65	Loti 65: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko prodhuesi GE/ ose ekuivalent, Modeli VIVID E9 nr. inventari 21970.	1.000.000,00
66	Loti 66: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko Prodhuuesi ESAOTE/ ose ekuivalent, modeli MYLAB 50 XVISION me nr. inventari 19445	425.000,00
67	Loti 67: Furnizim Vendosje të motorit të ventilimit dhe bordit kryeso për incubator prodhuesi GE/ ose ekuivalent, Modeli GIRAFFE INCUBATOR me nr. inventari 20953	400.000,00
68	Loti 68: Furnizim Vendosje TouchScreen dhe Bateri për Defibrilatorin prodhuesi Philips/ ose ekuivalent, modeli MRX me nr. inventari 21975	297.000,00

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

(per lotet 1- 62, duke qene se perlllogaritja e fondit limit per keto lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)

**2.13 Opsionet:**

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në

**2.14 Do të pranohen variantet:**

Po Jo ✓

**2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:**

Po Jo ✓

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: \_\_\_\_\_

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo

**Shenime te tjera**

---



---



**2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po

Jo

**2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po

Jo

### **Seksioni 3      Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik**

#### **3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 8**

**3.2 Sigurimi i Ofertës<sup>1</sup>:** ( i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor) Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është \_\_\_\_\_ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ Lekë

Loti 2 \_\_\_\_\_ Lekë

### **Seksioni 4      Procedura**

#### **4.1 Lloji i procedurës: E hapur**

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po

Jo

✓

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

**4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A) çmimi më i ulët ✓

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë

etj. pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

**4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

Data: **25/05/2018** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

**4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

Data: **25/05/2018** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

Informacioni mbi ofertate paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

**4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150** (njqind e pesedhjetë) ditë

**4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

Shqip	✓	Anglisht
Tjetër	_____	

**Seksioni 5 Informacione plotësuese**

**5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):**

Po Jo

Nëse Po

## Dokumentat standarde të tenderit

Monedha \_\_\_\_\_ Çmimi \_\_\_\_\_

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

### 5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **02/05/2018**



**Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike**

#### 1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza”  
Adresa Rruga e Dibres Nr. 372, Tirane  
Tel/Fax Tel. +355 42 362 627 Fax. +355 42 363 644  
E-mail [sek.juridik.qsut@gmail.com](mailto:sek.juridik.qsut@gmail.com)  
Faqa e Internetit [www.qsut.gov.al](http://www.qsut.gov.al)

#### 2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedure e Hapur

#### 3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2018” e ndare në lote si më poshtë

Nr	Lotet	Vlera pa TVSH
1	Loti 1: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike prodhuesi ACL 9000/ ose ekuivalent	565.818,40
2	Loti 2: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike, prodhuesit ABX/ ose ekuivalent	569.516,80
3	Loti 3: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike prodhuesi BECKMAN COULTER/ ose ekuivalent	2.100.665,90

## Dokumentat standarde të tenderit

4	Loti 4: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike te prodhuesi DPC (Siemens)/ ose ekuivalent	909.889,20
5	Loti 5: Mirëmbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi DRAGER/ ose ekuivalent	2.103.299,40
6	Loti 6: Mirëmbajtje e pajisjeve te anestezise prodhuesi MEDEC/ ose ekuivalent	3.072.687,30
7	Loti 7: Mirëmbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi SIARE PERSEO/ ose ekuivalent	1.840.002,30
8	Loti 8: Mirëmbajtje e pajisjeve te Dializes prodhuesi FRESENIUS/ ose ekuivalent	4.267.314,20
9	Loti 9: Mirëmbajtje e pajisjes te Dializes prodhuesi HOSPAL/ ose ekuivalent	5.088.543,00
10	Loti 10: Mirëmbajtje e pajisjes EEG EMG te prodhuesi NIHON KOHDEN/ ose ekuivalent	788.111,10
11	Loti 11: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM/ ose ekuivalent	2.791.546,80
12	Loti 12: Mirëmbajtje e pajisjes Grafi prodhuesit Shimadzu/ ose ekuivalent	418.600,00
13	Loti 13: Mirëmbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSSENS/ ose ekuivalent	1.381.759,50
14	Loti 14: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator prodhuesi ACOMA/ ose ekuivalent	559.668,20
15	Loti 15: Mirëmbajtje e pajisjes Aspirator Ultrasonic prodhuesi INTEGRA LifeSciences Corporation/ ose ekuivalent	1.497.914,10
16	Loti 16: Mirëmbajtje e pajisjeve Aspirator prodhuesi MIZUHO/ ose ekuivalent	428.582,00
17	Loti 17: Mirëmbajtje e pajisjeve Autoanalizator prodhuesi OLYMPUS/ ose ekuivalent	1.595.914,80
18	Loti 18: Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	1.402.530,80
19	Loti 19: Mirëmbajtje e pajisjes CO2 Laser prodhuesi LUMENIS/ ose ekuivalent	592.344,30
20	Loti 20: Mirëmbajtje e disa pajisjeve te prodhuesi GE/ ose ekuivalent	1.199.645,50
21	Loti 21: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ ose ekuivalent	453.744,00
22	Loti 22: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	786.682,80
23	Loti 23: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	6.100.165,80
24	Loti 24: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi ESAOTE/ ose ekuivalent	832.022,70
25	Loti 25: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SIEMENS/ ose ekuivalent	2.523.960,20
26	Loti 26: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SAMSUNG MEDISON/ ose ekuivalent	2.747.428,20
27	Loti 27: Mirëmbajtje e pajisje Imazherike prodhuesi TOSHIBA/ ose ekuivalent	3.158.668,20
28	Loti 28: Mirëmbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET/ ose ekuivalent	1.045.626,00
29	Loti 29: Mirëmbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi TERUMO/ ose ekuivalent	1.346.668,40
30	Loti 30: Mirëmbajtje e pajisjeve Elektroforeze prodhuesi SEBIA/ ose ekuivalent	694.928,90
31	Loti 31: Mirëmbajtje e pajisjes neuroendoskopike prodhuesi Aesculap/ ose ekuivalent	1.484.196,90
32	Loti 32: Mirëmbajtje e pajisjes Endoskopike prodhuesi PENTAX/ ose ekuivalent	121.334,20
33	Loti 33: Mirëmbajtje e pajisjes FAKO prodhuesi ALCON/ ose ekuivalent	1.014.263,20
34	Loti 34: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi CARL STORZ/ ose ekuivalent	7.353.967,10
35	Loti 35: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi OLYMPUS/ ose ekuivalent	1.402.195,00
36	Loti 36: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	798.895,80
37	Loti 37: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi/Skopi te prodhuesi Philips/ ose ekuivalent	6.512.289,00
38	Loti 38: Mirëmbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave/ ose ekuivalent	1.394.830,40
39	Loti 39: Mirëmbajtje e pajisjes intraaortik Ballon prodhuesit ARROË Teleflès/ ose ekuivalent	385.604,20
40	Loti 40: Mirëmbajtje e pajisjeve Inhalator prodhuesi KOUSHIN INDUSTRIES/ ose ekuivalent	604.750,50
41	Loti 41: Mirëmbajtje e pajisjeve Inkubator prodhuesi NAKAMURA dhe ATOM/ ose ekuivalent	843.329,50
42	Loti 42: Mirëmbajtje e pajisjes Lithotripter prodhuesi STORZ MEDICAL/ ose ekuivalent	3.277.060,70
43	Loti 43: Mirëmbajtje e pajisjes MAMOGRAF prodhuesi IMS GIOTTO/ ose ekuivalent	3.090.447,90
44	Loti 44: Mirëmbajtje e pajisjes Mikroskop, prodhuesi ZEISS/ ose ekuivalent	1.686.665,90
45	Loti 45: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden/ ose ekuivalent	1.154.519,50
46	Loti 46: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti, prodhuesi DRAGER/ ose ekuivalent	560.873,40

## Dokumentat standarde të tenderit

47	Loti 47: Mirëmbajtje e pajisjes Neuronavigator prodhuesi MEDTRONIC/ ose ekuivalent	3.847.118,00
48	Loti 48: Mirëmbajtje e pajisjes EMG prodhuesi MICROMED/ ose ekuivalent	511.492,40
49	Loti 49: Mirëmbajtje e pajisjes Body Box prodhuesi JAEGER/ ose ekuivalent	537.947,00
50	Loti 50: Mirëmbajtje e pajisjeve Pompa Infuzioni, prodhuesi NAKAMURA MEDICAL/ ose ekuivalent	439.415,00
51	Loti 51: Mirëmbajtje e pajisjes C-Arm te prodhuesit SIEMENS/ ose ekuivalent	1.149.802,20
52	Loti 52: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesit DRAGER/ ose ekuivalent	3.234.393,40
53	Loti 53: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesi NEWPORT/ ose ekuivalent	1.298.120,00
54	Loti 54: Mirëmbajtje e pajisjeve respirator te prodhuesit VIASYS Healthcare/ ose ekuivalent	4.291.294,00
55	Loti 55: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre prodhuesi AESCULAP/ ose ekuivalent	989.466,90
56	Loti 56: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre Oshilante prodhuesi DE SOUTER/ ose ekuivalent	153.334,10
57	Loti 57: Mirëmbajtje e Shiringave Elektrike prodhuesi ATOM MEDICAL/ ose ekuivalent	2.099.083,50
58	Loti 58: Mirëmbajtje e monitoreve dhe sistemit te monitorimit te pacientit prodhuesi Philips/ ose ekuivalent	5.356.654,00
59	Loti 59: Mirëmbajtje e pajisjes Spirometer prodhuesi CHEST/ ose ekuivalent	260.665,90
60	Loti 60: Mirëmbajtje e pajisjes TREADMILL prodhuesit CARDIOLINE/ ose ekuivalent	806.906,70
61	Loti 61: Mirëmbajtje e pajisjes endoskopike prodhuesi FUJINON/ ose ekuivalent	1.181.919,40
62	Loti 62: Mirëmbajtje e pajisjes video EEG prodhuesi Viasys Healthcare/ ose ekuivalent	438.150,00
63	Loti 63: Furnizim vendosje e kokes goditese e litotripterit Modulith SLX-F2/ ose ekuivalent Nr. Inventari 19241	2.870.000,00
64	Loti 64: Furnizim Vendosje Sonde Lineare për Eko prodhuesi Philips/ ose ekuivalent, Modeli EnVisor CHD nr. inventari 30988.	850.000,00
65	Loti 65: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko prodhuesi GE/ ose ekuivalent, Modeli VIVID E9 nr. inventari 21970.	1.000.000,00
66	Loti 66: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko Prodhuesi ESAOTE/ ose ekuivalent, modeli MYLAB 50 XVISION me nr. inventari 19445	425.000,00
67	Loti 67: Furnizim Vendosje te motorit te ventilimit dhe bordit kryeso për incubator prodhuesi GE/ ose ekuivalent, Modeli GIRAFFE INCUBATOR me nr. inventari 20953	400.000,00
68	Loti 68: Furnizim Vendosje TouchScreen dhe Bateri për Defibrilatorin prodhuesi Philips/ ose ekuivalent, modeli MRX me nr. inventari 21975	297.000,00

#### 4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-66028-04-30-2018

Nr	Lotet	Nr Ref se lotit
1	Loti 1: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike prodhuesi ACL 9000/ ose ekuivalent	REF-66033-04-30-2018
2	Loti 2: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike, prodhuesit ABX/ ose ekuivalent	REF-66035-04-30-2018
3	Loti 3: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike prodhuesi BECKMAN COULTER/ ose ekuivalent	REF-66038-04-30-2018
4	Loti 4: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike te prodhuesi DPC (Siemens)/ ose ekuivalent	REF-66041-04-30-2018
5	Loti 5: Mirëmbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi DRAGER/ ose ekuivalent	REF-66044-04-30-2018
6	Loti 6: Mirëmbajtje e pajisjeve te anestezise prodhuesi MEDEC/ ose ekuivalent	REF-66046-04-30-2018
7	Loti 7: Mirëmbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi SIARE PERSEO/ ose ekuivalent	REF-66048-04-30-2018
8	Loti 8: Mirëmbajtje e pajisjeve te Dializes prodhuesi FRESENIUS/ ose ekuivalent	REF-66050-04-30-2018
9	Loti 9: Mirëmbajtje e pajisjes te Dializes prodhuesi HOSPAL/ ose ekuivalent	REF-66052-04-30-2018
10	Loti 10: Mirëmbajtje e pajisjes EEG EMG te prodhuesi NIHON KOHDEN/ ose	REF-66055-04-30-

## Dokumentat standarde të tenderit

	ekuivalent	2018
11	Loti 11: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM/ ose ekuivalent	REF-66060-04-30-2018
12	Loti 12: Mirëmbajtje e pajisjes Grafi prodhuesit Shimadzu/ ose ekuivalent	REF-66071-04-30-2018
13	Loti 13: Mirëmbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSENS/ ose ekuivalent	REF-66075-04-30-2018
14	Loti 14: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator prodhuesi ACOMA/ ose ekuivalent	REF-66078-04-30-2018
15	Loti 15: Mirëmbajtje e pajisjes Aspirator Ultrasonic prodhuesi INTEGRA LifeSciences Corporation/ ose ekuivalent	REF-66080-04-30-2018
16	Loti 16: Mirëmbajtje e pajisjeve Aspirator prodhuesi MIZUHO/ ose ekuivalent	REF-66082-04-30-2018
17	Loti 17: Mirëmbajtje e pajisjeve Autoanalizator prodhuesi OLYMPUS/ ose ekuivalent	REF-66084-04-30-2018
18	Loti 18: Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	REF-66086-04-30-2018
19	Loti 19: Mirëmbajtje e pajisjes CO2 Laser prodhuesi LUMENIS/ ose ekuivalent	REF-66088-04-30-2018
20	Loti 20: Mirëmbajtje e disa pajisjeve te prodhuesi GE/ ose ekuivalent	REF-66090-04-30-2018
21	Loti 21: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ ose ekuivalent	REF-66092-04-30-2018
22	Loti 22: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	REF-66095-04-30-2018
23	Loti 23: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	REF-66099-04-30-2018
24	Loti 24: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi ESAOTE/ ose ekuivalent	REF-66101-04-30-2018
25	Loti 25: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SIEMENS/ ose ekuivalent	REF-66103-04-30-2018
26	Loti 26: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SAMSUNG MEDISON/ ose ekuivalent	REF-66105-04-30-2018
27	Loti 27: Mirëmbajtje e pajisje Imazherike prodhuesi TOSHIBA/ ose ekuivalent	REF-66107-04-30-2018
28	Loti 28: Mirëmbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET/ ose ekuivalent	REF-66109-04-30-2018
29	Loti 29: Mirëmbajtje e pajisjeve te KardioKirurgjise prodhuesi TERUMO/ ose ekuivalent	REF-66111-04-30-2018
30	Loti 30: Mirëmbajtje e pajisjeve Elektroforeze prodhuesi SEBIA/ ose ekuivalent	REF-66113-04-30-2018
31	Loti 31: Mirëmbajtje e pajisjes neuroendoskopike prodhuesi Aesculap/ ose ekuivalent	REF-66115-04-30-2018
32	Loti 32: Mirëmbajtje e pajisjes Endoskopike prodhuesi PENTAX/ ose ekuivalent	REF-66117-04-30-2018
33	Loti 33: Mirëmbajtje e pajisjes FAKO prodhuesi ALCON/ ose ekuivalent	REF-66119-04-30-2018
34	Loti 34: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi CARL STORZ/ ose ekuivalent	REF-66121-04-30-2018
35	Loti 35: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi OLYMPUS/ ose ekuivalent	REF-66123-04-30-2018
36	Loti 36: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	REF-66125-04-30-2018
37	Loti 37: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi/Skopi te prodhuesi Philips/ ose ekuivalent	REF-66127-04-30-2018
38	Loti 38: Mirëmbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave/ ose ekuivalent	REF-66129-04-30-2018
39	Loti 39: Mirëmbajtje e pajisjes intraaortik Ballon prodhuesit ARROË Telefles/ ose ekuivalent	REF-66132-04-30-2018
40	Loti 40: Mirëmbajtje e pajisjeve Inhalator prodhuesi KOUSHIN INDUSTRIES/ ose	REF-66135-04-30-



Dokumentat standarde të tenderit

	ekuivalent	2018
41	Loti 41: Mirëmbajtje e pajisjeve Inkubator prodhuesi NAKAMURA dhe ATOM/ ose ekuivalent	REF-66137-04-30-2018
42	Loti 42: Mirëmbajtje e pajisjes Lithotripter prodhuesi STORZ MEDICAL/ ose ekuivalent	REF-66139-04-30-2018
43	Loti 43: Mirëmbajtje e pajisjes MAMOGRAF prodhuesi IMS GIOTTO/ ose ekuivalent	REF-66142-04-30-2018
44	Loti 44: Mirëmbajtje e pajisjes Mikroskop, prodhuesi ZEISS/ ose ekuivalent	REF-66144-04-30-2018
45	Loti 45: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden/ ose ekuivalent	REF-66146-04-30-2018
46	Loti 46: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti, prodhuesi DRAGER/ ose ekuivalent	REF-66148-04-30-2018
47	Loti 47: Mirëmbajtje e pajisjes Neuronavigator prodhuesi MEDTRONIC/ ose ekuivalent	REF-66150-04-30-2018
48	Loti 48: Mirëmbajtje e pajisjes EMG prodhuesi MICROMED/ ose ekuivalent	REF-66152-04-30-2018
49	Loti 49: Mirëmbajtje e pajisjes Body Box prodhuesi JAEGER/ ose ekuivalent	REF-66155-04-30-2018
50	Loti 50: Mirëmbajtje e pajisjeve Pompa Infuzioni, prodhuesi NAKAMURA MEDICAL/ ose ekuivalent	REF-66157-04-30-2018
51	Loti 51: Mirëmbajtje e pajisjes C-Arm te prodhuesit SIEMENS/ ose ekuivalent	REF-66159-04-30-2018
52	Loti 52: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesit DRAGER/ ose ekuivalent	REF-66161-04-30-2018
53	Loti 53: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesi NEWPORT/ ose ekuivalent	REF-66164-04-30-2018
54	Loti 54: Mirëmbajtje e pajisjeve respirator te prodhuesit VIASYS Healthcare/ ose ekuivalent	REF-66166-04-30-2018
55	Loti 55: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre prodhuesi AESCULAP/ ose ekuivalent	REF-66168-04-30-2018
56	Loti 56: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre Oshilante prodhuesi DE SOUTER/ ose ekuivalent	REF-66170-04-30-2018
57	Loti 57: Mirëmbajtje e Shiringave Elektrike prodhuesi ATOM MEDICAL/ ose ekuivalent	REF-66172-04-30-2018
58	Loti 58: Mirëmbajtje e monitoreve dhe sistemit te monitorimit te pacientit prodhuesi Philips/ ose ekuivalent	REF-66174-04-30-2018
59	Loti 59: Mirëmbajtje e pajisjes Spirometer prodhuesi CHEST/ ose ekuivalent	REF-66176-04-30-2018
60	Loti 60: Mirëmbajtje e pajisjes TREADMILL prodhuesit CARDIOLINE/ ose ekuivalent	REF-66179-04-30-2018
61	Loti 61: Mirëmbajtje e pajisjes endoskopike prodhuesi FUJINON/ ose ekuivalent	REF-66181-04-30-2018
62	Loti 62: Mirëmbajtje e pajisjes video EEG prodhuesi Viasys Healthcare/ ose ekuivalent	REF-66183-04-30-2018
63	Loti 63: Furnizim vendosje e kokes goditese e litotripterit Modulith SLX-F2/ ose ekuivalent Nr. Inventari 19241	REF-66185-04-30-2018
64	Loti 64: Furnizim Vendosje Sonde Lineare për Eko prodhuesi Philips/ ose ekuivalent, Modeli EnVisor CHD nr. inventari 30988.	REF-66187-04-30-2018
65	Loti 65: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko prodhuesi GE/ ose ekuivalent, Modeli VIVID E9 nr. inventari 21970.	REF-66189-04-30-2018
66	Loti 66: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko Prodhuiesi ESAOTE/ ose ekuivalent, modeli MYLAB 50 XVISION me nr. inventari 19445	REF-66191-04-30-2018
67	Loti 67: Furnizim Vendosje te motorit te ventilimit dhe bordit kryeso për incubator prodhuesi GE/ ose ekuivalent, Modeli GIRAFFE INCUBATOR me nr. inventari 20953	REF-66193-04-30-2018

Dokumentat standarde të tenderit

68	Loti 68: Furnizim Vendorsje TouchScreen dhe Bateri për Defibrilatorin prodhuesi Philips/ ose ekuivalent, modeli MRX me nr. inventari 21975	REF-66195-04-30-2018
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

**5. Fondi limit: 116.987.234,50** (njqind e gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e tridhjetë e katër pikë pesëdhjetë) **lekë pa TVSH**

**6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 30 dite** nga nenshkrimi i kontrates (per lotet 63-68) dhe nga data **16.05.2018** deri ne daten **31.12.2018** (per lotet 1- 62)  

**7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:** data 25.05.2018 ora 10:00

**8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:** data 25.05.2018 ora 10:00



## II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

### Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.
- 1.5 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
- a) Formulari i Ofertës Ekonomike, plotësuar sipas **Shtojcës 1 të DT.**
- b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.
- c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara **në Shtojcën 7**
- ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
- Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.
- 1.6 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për kryerjen e \_\_\_\_\_ shërbimeve; Nr e Njoftimit \_\_\_\_\_

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA \_\_\_\_\_ (dd/mm/vv) orës \_\_\_\_\_”.**

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

## **Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike**

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të ekzekutohen dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës Ekonomike, çmimet totale të ofertës të të gjitha Shërbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4 Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkurrimi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare
- b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

## 2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, *të paktën 5 ditë nga përpara* përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

## 2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

### Seksioni 3. Vlerësimi i ofertave

#### 3.1 Kriteret e përzgjedhjes

**(Opsioni 1)** Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

**(Opsioni 2)** Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

## Dokumentat standarde të tenderit

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

$P_o$  - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$  - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{min k1} \times P_{max k1} / O_{k1}$$

$P_{k1}$ _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{min k1}$	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
$P_{max k1}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
$O_{k1}$	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

### Sqarim

Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

Në rastin e prokurimit të marrëveshjes kuadër, kur objekt i kësaj marrëveshje janë biletat e transportit ajror ndërkombëtar, në vend të çmimit do të përdoret marzhi i fitimit i shprehur në përqindje.

### 3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më poshtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të



refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korigjimeve janë më shumë se  $\pm 2\%$  e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

### 3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me shërbimet e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

#### Public Health Sector

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

$M_O$  – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

$Z_M$  – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots + O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

**Vlera e Ofertës që vlerësohet  $< Z_M$ ..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët**

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.3.3 Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

#### **Seksioni 4. Nënshkrimi i kontratës**

##### **4.1 Njoftimi i fituesit**

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në **Shtojcën 14**. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

##### **4.2 Sigurimi i kontratës**

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas **Shtojcës 20 të DT**, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare,
- ii. garanci sigurimi,

**Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.**

##### **4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar**

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

**Shënim:** Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

### III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë (në rastin e Marrëveshjes Kuadër)

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike dhe të Termave të Referencës nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Deklaratë për konfliktin e interesit

Shtojca 7: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 8: Kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit

Shtojca 9: Specifikimet teknike

Shtojca 10: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 11: Sherbimet dhe Grafiku i ekzekutimit

Shtojca 12: Termat e Referencës

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin e Skualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Shtojca 19: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 21: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 24: Formulari i Njoftimit të Anullimit

**Shtojca 1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

**FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE**

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_


Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-se



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i Shërbimeve	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
<b>Çmimi Neto )</b>					
<b>TVSH (%)</b>					
<b>Çmimi Total</b>					

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

## Dokumentat standarde të tenderit

Shënim:

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën \_\_\_\_ ( e kerkuar ne dokumentat e tenderit)

### Shtojca 2

*[Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]*

### FTESA PËR OFERTË

*(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)*

fton për të paraqitur oferta në procedurën për kryerjen e shërbimeve të mëposhtme:

.....  
.....  
.....

*(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasise siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).*

Vendi i kryerjes së shërbimit

*(jepni një përshkrim të shkurtër)*

Kohëzgjatja e shërbimit \_\_\_\_\_

Oferta duhet të paraqitet

*[Jep adresën e saktë]*

Përpara

*[Përcaktoni datën dhe orën përfundimtare]*

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim \_\_\_\_

Elektronik ( email, fax etj.) \_\_\_\_\_

### Shtojca 3

[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik, kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

#### FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data \_\_\_\_\_]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-se

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].



**Shtojca 4**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

**LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL**

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

**KUJDES**

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

## Shtojca 5

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

### DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e \_\_\_\_\_ të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

V ula

## Shtojca 6

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

### **DEKLARATË** **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvmministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit

## Dokumentat standarde të tenderit

të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi \_\_\_\_\_

Public Health Sector

Vula

## Shtojca 7

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik* ]

### DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilesinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale,
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është në proces falimentimi (statusi \_\_\_\_\_ aktiv),
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatorit ekonomik si më sipër.**

**Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_**

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

## Vula

### Shtojca 8

#### 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

**Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.**

**Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.**

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

**Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:**

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

**LOTI 1: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike prodhuesi ACL 9000/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 565.818,40 (pesëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e tetëmbëdhjetë presje dyzet) lekë pa TVSH**

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

---

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre të jetë **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### **3.3 Kapaciteti teknik:**

a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 për keto periudha ku të kete jo me pak se 3(tre) punonjës).

c) Të vertetoje që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vete të trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do të kryej shërbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nepermjet diplomes,



certificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton venien ne dispozicion te manualit te servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve qe do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) qe i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve qe kryhen, pjesët e këmbimit qe duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shenim 1: Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shenim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikoje ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi qe merr persiper zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 2: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike, prodhuesit ABX/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 569.516,80 (pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë presje tetëdhjetë) lekë pa TVSH*

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.  
*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2015, 2016 dhe 2017**) ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.4 Kapaciteti teknik:

- a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.
  - Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqëruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
  - Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formularet E-sig 025 për keto periudha ku të kete jo më pak se 3(tre) punonjës).
- c) Te vërtetoje që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.
- ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jete original i

perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

**d)** Ofertuesi duhet të paraqesë mirembajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë minimumin e ofertuar për atë lot dhe të jete e detajuar me cmimet perkatese për çdo pajisje sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qene se përlogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të përlogaritet për këto periudha dhe vlera e mirembajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rrikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të specifikojë në formular ofertës dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertës gjatë tenderimit)*

e) Autodeklarata nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 3: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike prodhuesi BECKMAN COULTER/ ose ekuivalent**

*Fond limit: **2.100.665,90** (dy milion e njëqind mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë presje nëntëdhjetë) lekë pa TVSH*

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të

kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre te jete **sa 40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### 3.5 Kapaciteti teknik:

- a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.
  - Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
  - Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).
- c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej sherbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, certificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.
- ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.
- d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

## Dokumentat standarde të tenderit

**Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshësinë e kontrolleve etj

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet përkatëse për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

**(Shenim 1:** Duke qenë se përlogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalohen datën 16.05.2018, oferta do të përlogaritet për këto periudha dhe vlera e mirembajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rrikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pjesët)

**(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të specifikojë në formularin e ofertës dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertës gjatë tenderimit)

e) Autodeklarata nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

Public Health Sector

**Loti 4: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike të prodhuesit DPC (Siemens)/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 909.889,20 (nëntëqind e nëntë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e nëntë presje njëzet) lekë pa TVSH**

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

**(Shenim:** Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezultojnë se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2015, 2016 dhe 2017**) ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.6 Kapaciteti teknik:

a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjes).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të behet mirëmbajtja.

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpesh tësinë e kontrolleve etj*



**dh)** Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shënim 1: Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shënim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 5: Mirëmbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi DRAGER/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 2.103.299,40 (dy milion e njëqind e tre mijë e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë presje dyzet) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**



### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa 40% i vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet.

### 3.7 Kapaciteti teknik:

- a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.
    - Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
    - Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
  - b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 të shoqeruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3 (tre) punonjes).
  - c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore të cilin do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, çertifikatës së trajnimit, CV-së, kontratës individuale të punës.
  - ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen e cilesore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.
  - d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.
- Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*
- dh) Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jete e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

*(Shënim 1: Duke qenë se perlllogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të perlllogaritet*

## Dokumentat standarde të tenderit

per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)

*(Shënim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofrojë uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 6: Mirëmbajtje e pajisjeve te anestezise prodhuesi MEDEC/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 3.072.687,30 (tre milion e shtatëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e shtatë presje tridhjetë) lekë pa TVSH*

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;

d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të balanceve të tre viteve te fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit

(2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre te jete sa **40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### 3.8 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej shërbimin e mirembajtjes dhe furnizimit vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, certifikates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shenim 1: Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shenim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikoje ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve te këmbimit dhe

konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 7: Mirëmbajtje e pajisjeve të Anestezisë prodhuesi SIARE PERSEO/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 1.840.002,30 (një milion e tetëqind e dyzet mijë e dy pike tridhjetë) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### **3.9 Kapaciteti teknik:**

- a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe

qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

**b)** Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

**c)** Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej shërbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, certificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

**ç)** Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

**d)** Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualet e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

***(Shenim 2.** Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojte ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 8: Mirëmbajtje e pajisjeve të Dializes prodhuesi FRESINIUS/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 4.267.314,20 (katër milion e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e treqind e katërmbëdhjetë presje njëzet) lekë pa TVSH*

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

Public Health Sector

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### **3.10 Kapaciteti teknik:**

a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura



tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

**b)** Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku te ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

**c)** Te vertetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vertetuara nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

**ç)** Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

**d)** Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku te jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpejtësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qenë se perlllogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit e tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të perlllogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë në formular ofertë dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertës gjatë tenderimit)*

**e)** Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë certifikatën CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.



**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 9: Mirëmbajtje e pajisjes te Dializes prodhuesi HOSPAL/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 5.088.543,00 (pesë milion e tetëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e dyzet e tre) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.  
*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezultojnë se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### **3.11 Kapaciteti teknik:**

- a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.
  - Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
  - Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej sherbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

*Shenim: Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shenim 1: Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedureve se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perllogarithet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shenim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojte ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 10: Mirëmbajtje e pajisjes EEG EMG te prodhuesi NIHON KOHDEN/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 788.111,10 (shtatëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e njëqind e njëmbëdhjetë presje dhjetë) lekë pa TVSH**

**2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

**3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**



**3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2015, 2016 dhe 2017**) ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

**3.12 Kapaciteti teknik:**

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 për keto periudha ku të kete jo me pak se 3(tre) punonjës).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej sherbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton venien në dispozicion të manualit të servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

***(Shenim 2.** Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

### Public Health Sector

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 11: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM/ ose ekuivalent**

*Fond limit: **2.791.546,80** (dy milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e një mijë e pesëqind e dyzet e gjashtë presje tetëdhjetë) lekë pa TVSH*

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

Public Health Sector

### 3.13 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqëruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 të shoqëruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për keto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore të cili do të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i

autorizuar nga prodhuesi për mirembajtjen cilesore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekesore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

**d)** Ofertuesi duhet të paraqesë mirembajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qenë se perlllogaritja e fondit limit për këtë lot është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit e tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të perlllogaritet për këtë periudhë dhe vlera e mirembajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbarsht ai duhet ta specifikojë në formularin e oferteve dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikatën CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 12: Mirëmbajtje e pajisjes Grafi prodhuesit Shimadzu/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 418.600,00 (katërqind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;



ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;

d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre te jete **sa 40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### 3.14 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatëse te shoqeruar me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej shërbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.



**d)** Ofertuesi duhet të paraqese mirembajtjen preventive për secilen lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyerat të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jete e detajuar me cmimet përkatëse për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qene se perlllogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit e tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të perlllogaritet për këto periudha dhe vlera e mirembajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbarsht ai duhet ta specifikojë në formularin e ofertës dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertës gjatë tenderimit)*

e) Autodeklarata nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të përdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikatën CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 13: Mirëmbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSENS/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 1.381.759,50 (një milion e treqind e tetëdhjetë e një mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e nëntë presje pesëdhjetë) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të

kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre te jete **sa 40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### 3.15 Kapaciteti teknik:

- a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.
  - Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
  - Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).
- c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej shërbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.
- ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.
- d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

## Dokumentat standarde të tenderit

**Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshësinë e kontrolleve etj

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet përkatëse për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

**(Shenim 1:** Duke qenë se përlogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të përlogaritet për këto periudha dhe vlera e mirembajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rrikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)

**(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbarsht ai duhet ta specifikojë në formularin e ofertës dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertës gjatë tenderimit)

e) Autodeklarata nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 14: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator prodhuesi ACOMA/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 559.668,20 (pesëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë presje njëzet) lekë pa TVSH**

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

**(Shënim:** Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezultojnë se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.16 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qartë datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qartë datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të behet mirëmbajtja.

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpesh të cilin e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shenim 1: Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shenim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojte ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 15: Mirëmbajtje e pajisjes Aspirator Ultrasonic prodhuesi INTEGRA LifeSciences Corporation/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 1.497.914,10 (një milion e katërqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e katërbëdhjetë presje dhjetë) lekë pa TVSH*

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

#### 3.17 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jete e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.



## Dokumentat standarde të tenderit

*(Shënim 1: Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shënim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 16: Mirëmbajtje e pajisjeve Aspirator prodhuesi MIZUHO/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 428.582,00 (katërqind e njëzet e tetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e dy) lekë pa TVSH**

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.

- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vleres se fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.18 Kapaciteti teknik:

- a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

- b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjes).

- c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vete të trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nepermjet diplomes, çertificates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

- ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen çilesore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekesore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

- d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të behet mirëmbajtja.

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nepermjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

- dh) Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jete e detajuar me cmimet perkatese për çdo pajisje sipas specifikimeve teknike.

***(Shënim 1:** Duke qene se perlllogaritja e fondit limit për këto lote është bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të perlllogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marre parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shënim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marre pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë në formularin e oferte dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 17: Mirëmbajtje e pajisjeve Autoanalizator prodhuesi OLYMPUS/ ose ekuivalent**

*Fond limit: **1.595.914,80** (një milion e pesëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë nëntëqind e katërbëdhjetë presje tetëdhjetë) **lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

---

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2015, 2016 dhe 2017**) ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vleres se fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.19 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nepermjet diplomes, çertifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja. **Public Health Sector**

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

***(Shënim 1:** Duke qenë se perlllogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit e tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të perlllogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shënim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë në formular ofertë dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertës gjatë tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

## Dokumentat standarde të tenderit

- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 18: Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 1.402.530,80 (një milion e katërqind e dy mijë e pesëqind e tridhjetë presje tetëdhjetë) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezultoni se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vleres se fondit limit** të lotit që prokurohet.

### **3.20 Kapaciteti teknik:**

- Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe

që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

**b)** Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

**c)** Te vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

**ç)** Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

**d)** Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet perkatese për çdo pajisje sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qenë se përlogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të përlogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rrikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbarsht ai duhet ta specifikojë në formularin e ofertes dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

**e)** Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.



- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 19: Mirëmbajtje e pajisjes CO2 Laser prodhuesi LUMENIS/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 592.344,30 (pesëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e treqind e dyzet e katër presje tridhjetë) lekë pa TVSH*

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

Public Health Sector

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2015, 2016 dhe 2017**) ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

#### **3.21 Kapaciteti teknik:**

**a)** Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqëruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

## Dokumentat standarde të tenderit

- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

**b)** Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

**c)** Te vertetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vertetuara nepermjet diplomes, çertifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

**ç)** Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen e cilesore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

**d)** Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qenë se perlllogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit e tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të perlllogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë në formular oferte dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

**e)** Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikatën CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e**

mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

**Loti 20: Mirëmbajtje e disa pajisjeve të prodhuesi GE/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 1.199.645,50 (një milion e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e dyzet e pesë presje pesëdhjetë) lekë pa TVSH*

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezultojnë se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të certifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.22 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars

## Dokumentat standarde të tenderit

2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej sherbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

*Shenim: Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualet e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shenim 1: Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shenim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojte ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 21: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 453.744,00 (katërqind e pesëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzet e katër) lekë pa TVSH**

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

Public Health Sector

### 3.23 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 të shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

c) Të vertetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vete të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nepermjet diplomes,

certificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton venien ne dispozicion te manualit te servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve qe do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) qe i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve qe kryhen, pjesët e këmbimit qe duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shenim 1: Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit te tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shenim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofrojë uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi qe merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 22: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 786.682,80 (shatëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e dy presje tetëshjetë) lekë pa TVSH*

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**



1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre te jete **sa 40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### 3.24 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej shërbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes

mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

**d)** Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton venien ne dispozicion te manualit te servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perllogarithet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

***(Shenim 2.** Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 23: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 6.100.165,80 (gjashtë milion e njëqind mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e pesë presje tetëdhjetë) lekë pa TVSH*

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;

ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;

d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre te jete sa **40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### 3.25 Kapaciteti teknik:

a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej sherbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar

## Dokumentat standarde të tenderit

procedura e kontrollit, pjeset që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

**Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet përkatëse për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

**(Shënim 1:** Duke qenë se perlllogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të perlllogaritet për këtë periudhë dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)

**(Shënim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë në formularin e ofertës dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertës gjatë tenderimit)

e) Autodeklarata nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

### Public Health Sector

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 24: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi ESAOTE/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 832.022,70 (tetëqind e tridhjetë e dy mijë e njëzet e dy presje shtatëdhjetë) lekë pa TVSH**

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

**(Shënim:** Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezultojnë se detyrimet e paguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre te jete **sa 40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### 3.26 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej shërbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes*

## Dokumentat standarde të tenderit

*parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet përkatëse për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

*(Shënim 1: Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shënim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 25: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SIEMENS/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 2.523.960,20 (dy milion e pesëqind e njëzet e tre mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë presje njëzet) lekë pa TVSH*

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
  - b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
  - c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
  - ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
  - d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
- (Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezultojnë se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:



### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2015, 2016 dhe 2017**) ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.27 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjes).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, çertifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpejtësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet përkatëse për çdo paisje sipas specifikimeve teknike.

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**



**Loti 26: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SAMSUNG MEDISON/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 2.747.428,20 (dy milion e shtatëqind e dyzet e shtatë mijë e katërqind e njëzet e tetë presje njëzet) lekë pa TVSH*

**2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;

*(Shënim: Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë në formular ofertë dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4

c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;

ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;

d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

**3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2015, 2016 dhe 2017**) ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

#### 3.28 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjes).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jete e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

## Dokumentat standarde të tenderit

*(Shënim 1: Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shënim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 27: Mirëmbajtje e pajisje Imazherike prodhuesi TOSHIBA/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 3.158.668,20 (tre milion e njëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë presje njëzet) lekë pa TVSH*

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky

autoritet.

- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.29 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për keto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjes).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vete të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certificate të trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të behet mirëmbajtja.

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jete e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

*(Shënim 1: Duke qenë se perlllogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit e tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të perlllogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

*(Shënim 2. Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbarsht ai duhet ta specifikojë në formularin e ofertes dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 28: Mirëmbajtje e pajisjeve të Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 1.045.626,00 (një milion e dyzet e pesë mijë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

---

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vleres së fondit limit** të lotit që prokurohet.



### 3.30 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja. **Public Health Sector**

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpejtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

*(Shënim 1: Duke qenë se perlllogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit e tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të perlllogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

*(Shënim 2. Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë në formularin e ofertes dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

## Dokumentat standarde të tenderit

- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 29: Mirëmbajtje e pajisjeve të KardioKirurgjise prodhuesi TERUMO/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 1.346.668,40 (një milion e treqind e dyzet e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë presje dyzet) lekë pa TVSH*

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;

*(Shënim: Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë në formular ofertë dhe të ofrojë uljen e çmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4

c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;

ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;

d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.31 Kapaciteti teknik:

## Dokumentat standarde të tenderit

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen çilesore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta për lotin duhet të ketë çmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me çmimet perkatese për çdo pajisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shënim 1: Duke qenë se perlllogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit e tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të perlllogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

*(Shënim 2. Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të specifikojë në formularin e ofertes dhe të ofrojë uljen e çmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

e) Autodeklarata nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë certifikatën CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të

përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 30: Mirëmbajtje e pajisjeve Elektroforeze prodhuesi SEBIA/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 694.928,90 (gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e nëntëqind e njëzet e tetë presje nëntëdhjetë) lekë pa TVSH*

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

Public Health Sector

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2015, 2016 dhe 2017**) ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### **3.32 Kapaciteti teknik:**

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura

tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

**b)** Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku te ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

**c)** Te vertetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vertetuara nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontratës individuale të punës.

**ç)** Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

**d)** Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku te jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpejtësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qenë se përlogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të përlogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të specifikojë në formularin e ofertes dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

**e)** Autodeklarata nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

**Loti 31: Mirëmbajtje e pajisjes neuroendoskopike prodhuesi Aesculap/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 1.484.196,90 (një milion e katërqind e tetëdhjetë e katër mijë e njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë presje nëntëdhjetë) lekë pa TVSH*

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet perkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre te jete sa **40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### 3.33 Kapaciteti teknik:

a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.



b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej sherbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

*Shenim: Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shenim 1: Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedurese se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perllogarithet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shenim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojte ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 32: Mirëmbajtje e pajisjes Endoskopike prodhuesi PENTAX/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 121.334,20 (njëqind e njëzet e një mijë e treqind e tridhjetë e katër presje njëzet) lekë pa TVSH**

**2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezultojnë se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

**3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**



**3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

**3.34 Kapaciteti teknik:**

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 për keto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej sherbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

*Shenim: Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shenim 1: Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shenim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofrojë uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

### Public Health Sector

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 33: Mirëmbajtje e pajisjes FAKO prodhuesi ALCON/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 1.014.263,20 (një milion e katërbëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e tre presje njëzet) lekë pa TVSH***

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

Public Health Sector

### 3.35 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 të shoqeruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për keto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjes).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore të cilin do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i

autorizuar nga prodhuesi për mirembajtjen cilesore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekesore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

**d)** Ofertuesi duhet të paraqesë mirembajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të behet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qenë se përlogaritja e fondit limit për këtë lot është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit e tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të përlogaritet për këtë periudhë dhe vlera e mirembajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbarsht ai duhet ta specifikojë në formularin e oferteve dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikatën CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 34: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi CARL STORZ/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 7.353.967,10 (shtatë milion e treqind e pesëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë presje dhjetë) lekë pa TVSH*

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertes, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4

- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.  
*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre te jete sa **40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### 3.36 Kapaciteti teknik:

- a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.
  - Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
  - Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).
- c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej shërbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.
- ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.
- d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve



te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

**Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshësinë e kontrolleve etj

**dh)** Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

**(Shenim 1:** Duke qene se perlogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)

**(Shenim 2.** Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 35: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi OLYMPUS/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 1.402.195,00 (një milion e katërqind e dy mijë e njëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH**

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

---

---

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### **3.37 Kapaciteti teknik:**

- a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.
  - Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
  - Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për keto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjes).
- c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.
- ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.
- d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilen lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të behet mirëmbajtja.

## Dokumentat standarde të tenderit

**Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshësinë e kontrolleve etj

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet përkatëse për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

**(Shenim 1:** Duke qenë se përlogaritja e fondit limit për këtë lotë është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të përlogaritet për këtë periudhë dhe vlera e mirembajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rrikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)

**(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbarsht ai duhet ta specifikojë në formularin e ofertës dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertës gjatë tenderimit)

e) Autodeklarata nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 36: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 798.895,80 (shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e pesë pjesë të tetëdhjetë) lekë pa TVSH**

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

**(Shënim:** Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezultojnë se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2015, 2016 dhe 2017**) ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.38 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qartë datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qartë datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjes).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të behet mirëmbajtja.

**Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpesh tësinë e kontrolleve etj

**dh)** Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shenim 1: Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimet te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shenim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojte ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 37: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi/Skopi te prodhuesi Philips/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 6.512.289,00 (gjashtë milion e pesëqind e dymbëdhjetë mijë e dyqind e tetëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.39 Kapaciteti teknik:

- a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.
  - Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
  - Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).
- c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.
- ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.
- d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*
- dh) Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jete e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.



## Dokumentat standarde të tenderit

*(Shënim 1: Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shënim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 38: Mirëmbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 1.394.830,40 (një milion e treqind e nëntëdhjetë e katër mijë e tetëqind e tridhjetë presje dyzet) lekë pa TVSH*

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të balanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky

autoritet.

- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre te jete sa **40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### 3.40 Kapaciteti teknik:

a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej shërbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, certificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shenim 1: Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perllogarithet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shenim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 39: Mirëmbajtje e pajisjes intraaortik Ballon prodhuesit ARROË Teleflës/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 385.604,20 (treqind e tetëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e katër presje njëzet) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

---

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vleres së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.41 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nepermjet diplomes, çertifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja. **Public Health Sector**

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

***(Shënim 1:** Duke qenë se perlllogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit e tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të perlllogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shënim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë në formular oferte dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

## Dokumentat standarde të tenderit

- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 40: Mirëmbajtje e pajisjeve Inhalator prodhuesi KOUSHIN INDUSTRIES/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 604.750,50 (gjashtëqind e katër mijë e shtatëqind e pesëdhjetë presje pesëdhjetë) lekë pa TVSH***

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;

*(Shënim: Ne rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë në formular oferte dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4

c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;

ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;

d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të balanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vleres se fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.42 Kapaciteti teknik:

## Dokumentat standarde të tenderit

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen çilesore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta për lotin duhet të ketë çmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me çmimet perkatese për çdo pajisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shënim 1: Duke qenë se përlogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit e tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të përlogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rrikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

*(Shënim 2. Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë në formularin e ofertes dhe të ofrojë uljen e çmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

e) Autodeklarata nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë certifikatën CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të



përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 41: Mirëmbajtje e pajisjeve Inkubator prodhuesi NAKAMURA dhe ATOM/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 843.329,50 (tetëqind e dyzet e tre mijë e treqind e njëzet e nëntë presje pesëdhjetë) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;

d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

Public Health Sector

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### **3.43 Kapaciteti teknik:**

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura

tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

**b)** Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për këto periudha ku te ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

**c)** Te vertetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vertetuara nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontratës individuale të punës.

**ç)** Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

**d)** Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku te jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpejtësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qenë se përlogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të përlogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rrikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbarsht ai duhet ta specifikojë në formular ofertë dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertës gjatë tenderimit)*

**e)** Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

**Loti 42: Mirëmbajtje e pajisjes Lithotripter prodhuesi STORZ MEDICAL/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 3.277.060,70 (tre milion e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëdhjetë presje shtatëdhjetë) lekë pa TVSH**

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet perkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre te jete sa **40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### 3.44 Kapaciteti teknik:

a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej sherbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

*Shenim: Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualet e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shenim 1: Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedurese se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shenim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojte ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 43: Mirëmbajtje e pajisjes MAMOGRAF prodhuesi IMS GIOTTO/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 3.090.447,90 (tre milion e nentëdhjetë mijë e katërqind e dyzet e shtatë presje nëntëdhjetë) lekë pa TVSH**

**2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezultojnë se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

**3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**



**3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2015, 2016 dhe 2017**) ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

**3.45 Kapaciteti teknik:**

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 të shoqeruara me listepagesat (formularet E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej sherbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perllogarithet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

***(Shenim 2.** Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojte ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

### Public Health Sector

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 44: Mirëmbajtje e pajisjes Mikroskop, prodhuesi ZEISS/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 1.686.665,90 (një milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë presje nëntëdhjetë) lekë pa TVSH*



## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

Public Health Sector

### 3.46 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 të shoqeruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për keto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore të cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i

autorizuar nga prodhuesi për mirembajtjen cilesore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekesore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

**d)** Ofertuesi duhet të paraqesë mirembajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të behet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qenë se përlogaritja e fondit limit për këtë lot është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalohen datën 16.05.2018, oferta do të përlogaritet për këtë periudhë dhe vlera e mirembajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbarsht ai duhet të specifikojë në formularin e oferteve dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

e) Autodeklarata nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikatën CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 45: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 1.154.519,50 (një milion e njëqind e pesëdhjetë e katër mijë e pesëqind e nëntëmbëdhjetë pesëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertes, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4

- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.  
*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre te jete sa **40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### 3.47 Kapaciteti teknik:

- a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.
  - Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
  - Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).
- c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej shërbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.
- ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.
- d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve

te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

**Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton venien ne dispozicion te manualit te servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshësinë e kontrolleve etj

**dh)** Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

**(Shenim 1:** Duke qene se perlogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)

**(Shenim 2.** Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 46: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti, prodhuesi DRAGER/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 560.873,40 (pesëqind e gjashtëdhjetë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e tre presje dyzet) lekë pa TVSH**

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre te jete **sa 40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### 3.48 Kapaciteti teknik:

- a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.
  - Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
  - Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).
- c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej sherbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, certificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.
- ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.
- d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

## Dokumentat standarde të tenderit

**Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshësinë e kontrolleve etj

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet përkatëse për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

**(Shenim 1:** Duke qenë se përlogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të përlogaritet për këto periudha dhe vlera e mirembajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rrikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)

**(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbarsht ai duhet ta specifikojë në formularin e ofertës dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertës gjatë tenderimit)

e) Autodeklarata nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 47: Mirëmbajtje e pajisjes Neuronavigator prodhuesi MEDTRONIC/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 3.847.118,00 (tre milion e tetëqind e dyzet e shtatë mijë e njëqind e tetëmbëdhjetë) lekë pa TVSH**

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

**(Shënim:** Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezultojnë se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:



### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2015, 2016 dhe 2017**) ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.49 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qartë datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qartë datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjes).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të behet mirëmbajtja.

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpesh të cilin e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shenim 1: Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimet te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shenim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojte ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 48: Mirëmbajtje e pajisjes EMG prodhuesi MICROMED/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 511.492,40 (pesëqind e njëmbëdhjetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e dy presje dyzet) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2015, 2016 dhe 2017**) ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.50 Kapaciteti teknik:

- a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.
  - Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
  - Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjes).
- c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.
- ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekesore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.
- d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*
- dh) Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jete e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

## Dokumentat standarde të tenderit

*(Shënim 1: Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shënim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 49: Mirëmbajtje e pajisjes Body Box prodhuesi JAEGER/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 537.947,00 (pesëqind e tridhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e dyzet e shtatë) lekë pa TVSH**

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.

- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa 40% i vleres së fondit limit të lotit që prokurohet.

### 3.51 Kapaciteti teknik:

- a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

- b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 të shoqeruara me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjes).

- c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizimit vendosjes, të vërtetuar nepermjet diplomes, çertifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

- ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen çilesore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

- d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpejtesinë e kontrolleve etj*

- dh) Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jete e detajuar me cmimet perkatese për çdo pajisje sipas specifikimeve teknike.

***(Shënim 1:** Duke qenë se perlllogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të perlllogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shënim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë në formular ofertë dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertës gjatë tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 50: Mirëmbajtje e pajisjeve Pompa Infuzioni, prodhuesi NAKAMURA MEDICAL/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 439.415,00 (katërqind e tridhjetë e nëntë mijë e katërqind e pesëmbëdhjetë) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

---

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të balanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vleres se fondit limit** të lotit që prokurohet.



### 3.52 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja. **Public Health Sector**

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpejtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

*(Shënim 1: Duke qenë se perlllogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të perlllogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

*(Shënim 2. Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të specifikojë në formularin e ofertes dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

## Dokumentat standarde të tenderit

- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 51: Mirëmbajtje e pajisjes C-Arm te prodhuesit SIEMENS/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 1.149.802,20 (një milion e njëqind e dyzet e nëntë mijë e tetëqind e dy presje njëzet) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vleres se fondit limit** të lotit që prokurohet.

### **3.53 Kapaciteti teknik:**

- a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe

që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

**b)** Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

**c)** Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

**ç)** Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

**d)** Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet perkatese për çdo pajisje sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qenë se përlogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të përlogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbarsht ai duhet ta specifikojë në formularin e ofertës dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertës gjatë tenderimit)*

**e)** Autodeklarata nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë certifikatën CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 52: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator të prodhuesit DRAGER/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 3.234.393,40 (tre milion e dyqind e tridhjetë e katër mijë e treqind e nëntëdhjetë e tre presje dyzet) lekë pa TVSH*

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

Public Health Sector

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet perkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2015, 2016 dhe 2017**) ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vleres së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### **3.54 Kapaciteti teknik:**

**a)** Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

## Dokumentat standarde të tenderit

- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

**b)** Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

**c)** Te vertetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vertetuara nëpërmjet diplomes, çertifikatës së trajnimit, CV-se, kontratës individuale të punës.

**ç)** Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen e cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

**d)** Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qenë se përlogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit e tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të përlogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rrikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë në formular oferte dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

**e)** Autodeklarata nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikatën CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e**

**mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 53: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesi NEËPORT/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 1.298.120,00 (një milion e dyqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e njëqind e njëzet) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

---

---

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet perkatese dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre te jete sa **40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### **3.55 Kapaciteti teknik:**

a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjate tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars



2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej shërbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

*Shenim: Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualet e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shenim 1: Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shenim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 54: Mirëmbajtje e pajisjeve respirator te prodhuesit VIASYS Healthcare/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 4.291.294,00 (katër milion dyqind e nëntëdhjetë e një mijë e dyqind e nëntëdhjetë e katër) lekë pa TVSH**

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

---

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve te fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre te jete **sa 40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### **3.56 Kapaciteti teknik:**

a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej sherbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes,

certificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton venien ne dispozicion te manualit te servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve qe do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shenim 1: Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit te tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shenim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojte ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 55: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre prodhuesi AESCULAP/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 989.466,90 (nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje nëntëdhjetë) lekë pa TVSH*

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre te jete **sa 40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### 3.57 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej shërbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes

mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

**d)** Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perllogarithet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

***(Shenim 2.** Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 56: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre Oshilante prodhuesi DE SOUTER/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 153.334,10 (njëqind e pesëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e katër pika dhjetë) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;

ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;

d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezultoni se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.58 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

c) Te vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nepermjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekesore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i përthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të përthyerat të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar



procedura e kontrollit, pjeset që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

**Shenim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet përkatëse për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

**(Shenim 1:** Duke qenë se përlogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të përlogaritet për këtë periudhë dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)

**(Shenim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbarsht ai duhet ta specifikojë në formularin e ofertës dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertës gjatë tenderimit)

e) Autodeklarata nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga momenti i vendosjes ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

### Public Health Sector

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 57: Mirëmbajtje e Shiringave Elektrike prodhuesi ATOM MEDICAL/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 2.099.083,50 (dy milion e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëdhjetë e tre pjesë pesëdhjetë) lekë pa TVSH**

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

**(Shënim:** Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e paguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar

nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2015, 2016 dhe 2017**) ku vlera mesatare e tyre të jetë **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.59 Kapaciteti teknik:

- a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.
  - Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
  - Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 të shoqeruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për keto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).
- c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nepermjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.
- ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.
- d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilen lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të behet mirëmbajtja.

**Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes

## Dokumentat standarde të tenderit

parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshësinë e kontrolleve etj

**dh)** Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet përkatëse për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

*(Shënim 1: Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shënim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofrojë uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 58: Mirëmbajtje e monitoreve dhe sistemit të monitorimit të pacientit prodhuesi Philips/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 5.356.654,00 (pesë milion e treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e katër) lekë pa TVSH**

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezultojnë se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2015, 2016 dhe 2017**) ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.60 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qartë datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qartë datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjes).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të behet mirëmbajtja.

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpesh të cilin e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

*(Shenim 1: Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimet te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shenim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojte ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 59: Mirëmbajtje e pajisjes Spirometer prodhuesi CHEST/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 260.665,90 (dyqind e gjashtëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë presje nëntëdhjetë) lekë pa TVSH*

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2015, 2016, 2017**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2015, 2016 dhe 2017**) ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

#### 3.61 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjes).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja.

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jete e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.



## Dokumentat standarde të tenderit

*(Shënim 1: Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perlllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

*(Shënim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë ne formular oferte dhe te ofroje uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesoreve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 60: Mirëmbajtje e pajisjes TREADMILL prodhuesit CARDIOLINE/ ose ekuivalent**

**Fond limit: 806.906,70 (tetëqind e gjashtë mijë e nëntëqind e gjashtë presje shtatëdhjetë) lekë pa TVSH**

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.

- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vleres se fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.62 Kapaciteti teknik:

- a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

- b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjes).

- c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirembajtjes dhe furnizimit vendosjes, të vërtetuar nepermjet diplomes, çertificates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

- ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirembajtjen çilesore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

- d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirembajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jete percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirembajtja.

***Shënim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nënkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

- dh) Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jete e detajuar me cmimet perkatese për çdo pajisje sipas specifikimeve teknike.

***(Shënim 1:** Duke qene se perllogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit të tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të perllogarithet për këto periudha dhe vlera e mirembajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shënim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë në formular ofertë dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertës gjatë tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zevendesimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 61: Mirëmbajtje e pajisjes endoskopike prodhuesi FUJINON/ ose ekuivalent**

*Fond limit: 1.181.919,40 (një milion e njëqind e tetëdhjetë e një mijë e nëntëqind e nëntëmbëdhjetë presje dyzet) lekë pa TVSH*

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

---

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa 40% i vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet.

### 3.63 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nepermjet diplomes, çertifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për mirëmbajtjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi për vitin 2018. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilin lloj pajisje sipas manualeve të percaktuara nga prodhuesi, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë percaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur është percaktuar të bëhet mirëmbajtja. **Public Health Sector**

***Shënim:** Paraqitja e mirëmbajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por vënien në dispozicion të shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualin e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

dh) Oferta për lotin duhet të ketë cmimin e ofertuar për atë lot dhe të jetë e detajuar me cmimet perkatese për çdo pjesë sipas specifikimeve teknike.

***(Shënim 1:** Duke qenë se perlllogaritja e fondit limit për këto lote është bërë nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 ditë) dhe afatet ligjore të procedurës së prokurimit e tejkalojnë datën 16.05.2018, oferta do të perlllogaritet për këto periudha dhe vlera e mirëmbajtjes përpara nënshkrimit të kontratës do të rikalkulohet duke marrë parasysh vlerën ditore për pajisjet)*

***(Shënim 2.** Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet ta specifikojë në formular oferte dhe të ofrojë uljen e cmimit të ofertes gjatë tenderimit)*

e) Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

## Dokumentat standarde të tenderit

- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve të pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 62: Mirëmbajtje e pajisjes video EEG prodhuesi Viasys Healthcare/ ose ekuivalent**

***Fond limit: 438.150,00 (katërqind e tridhjetë e tetë mijë e njëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### **3.64 Kapaciteti teknik:**

- a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

## Dokumentat standarde të tenderit

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

**b)** Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularët E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

**c)** Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej shërbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vërtetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

**ç)** Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi per vitin 2018. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

**d)** Ofertuesi duhet te paraqese mirembajtjen preventive per secilen lloj pajisje sipas manualeve te percaktuara nga prodhuesi, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e kontrollit, pjeset qe do te nderrohen dhe shpejtesia, intervalet kohore kur eshte percaktuar te behet mirembajtja.

***Shenim:** Paraqitja e mirembajtjes preventive nuk nenkupton vënien në dispozicion të manualit të servisit por venien ne dispozicion te shërbimeve që do të kryhen sipas protokollit të mirëmbajtjes parandaluese (sipas prodhuesit) që i duhet kryer pajisjes dhe të cilën do ta kryejë ofertuesi në rastin e kontratës së plotë. Kjo zakonisht paraqitet/tregohet në manualët e prodhuesit nëpërmjet llojeve të kontrolleve që kryhen, pjesët e këmbimit që duhet të ndërrohen, shpeshtësinë e kontrolleve etj*

**dh)** Oferta per lotin duhet te kete cmimin e ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve teknike.

***(Shenim 1:** Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, oferta do te perllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

***(Shenim 2.** Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai duhet ta specifikojte ne formular oferte dhe te ofrojte uljen e cmimit te ofertes gjate tenderimit)*

**e)** Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

- Pjesët do të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
- Pjesët do të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose



aksesorëve.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 63: Furnizim vendosje e kokës goditese e litotripterit Modulith SLX-F2/ ose ekuivalent Nr. Inventari 19241**

***Fond limit: 2.870.000,00 (dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

Public Health Sector

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve te fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre te jete sa **40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### **3.3 Kapaciteti teknik:**

a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të kontrates qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura

tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqëruar me listepagesat (formulet E-sig 025 për këto periudha ku te ketë jo më pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vertetuar nëpërmjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontratës individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për furnizim vendosjen çilesore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi. Autorizimi duhet të jetë origjinal i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi mund të paraqesë manualin e vendosjes për secilën pjesë sipas rekomandimeve të prodhuesit, të perkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë percaktuar procedura e vendosjes.

dh) Ofertuesi duhet të paraqesë autodeklarate që pjesët e ofetuara janë të reja, të papërdorura dhe kompatibël me aparatën e pajisjes mjekësore.

e) Ofertuesi duhet të paraqesë për çdo pjesë të ofertuar, certifikatën e konformitetit CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian, e fotokopjuar, e perkthyer dhe e noterizuar.

ë) Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratën e garancisë për pjesët që oferton, në të cilën duhet të saktësojë se periudha e garancisë për pjesët e ofertuar të jetë jo më pak se 1 (një) vit, sipas afatit të percaktuar në specifikimet teknike, për pjesët objekt prokurimi, ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 64: Furnizim Vendosje Sonde Lineare për Eko prodhuesi Philips/ ose ekuivalent, Modeli EnVisor CHD nr. inventari 30988**

***Fond limit: 850.000,00 (tetëqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;

- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.  
*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

---

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të balanceve të tre viteve të fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### **3.4 Kapaciteti teknik:**

- a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.
  - Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
  - Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjesve të siguruar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për keto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjes).
- c) Te vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vete të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nepermjet diplomes, certifikates së trajnimit, CV-se, kontrates individuale të punës.
- ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për furnizim vendosjen çilesore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi. Autorizimi duhet të jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi mund të paraqesë manualin e vendosjes për secilën pjesë sipas rekomandimeve të prodhuesit, të perkthyer në fotokopjuar dhe noterizuar ku të jetë percaktuar procedura e vendosjes.

dh) Ofertuesi duhet të paraqesë autodeklarate që pjesët e ofetuara janë të reja, të paperdorura dhe kompatibel me aparatoren e pajisjes mjekësore.

e) Ofertuesi duhet të paraqesë për çdo pjesë të ofertuar, certifikatën e komformitetit CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian, e fotokopjuar, e perkthyer dhe e noterizuar.

ë) Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratën e garancisë për pjesët që oferton, në të cilën duhet të saktesojë se periudha e garancisë për pjesët e ofertuar të jetë jo më pak se 1 (një) vit, sipas afatit të percaktuar në specifikimet teknike, për pjesët objekt prokurimi, ku të perfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 65: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko prodhuesi GE/ ose ekuivalent, Modeli VIVID E9 nr. inventari 21970**

***Fond limit: 1.000.000,00 (një milion) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit

ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.

- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre të jete sa **40% i vlerës së fondit limit** të lotit që prokurohet.

### 3.5 Kapaciteti teknik:

a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të kontrates që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat përkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguar për periudhën Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularët E-sig 025 për këto periudha ku të ketë jo më pak se 3(tre) punonjës).

c) Të vërtetojë që ka të paktën 1 Inxhinier në stafin e vetë të trajnuar për pajisjet mjekësore i cili do të kryej shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes, të vërtetuar nëpërmjet diplomes, çertifikatës së trajnimit, CV-se, kontratës individuale të punës.

ç) Autorizim për operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për furnizim vendosjen cilësore, të sigurte dhe pjesë origjinale të pajisjes mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi. Autorizimi duhet të jetë original i përkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi mund të paraqesë manualin e vendosjes për secilën pjesë sipas rekomandimeve të prodhuesit, të përkthyer të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e vendosjes.

dh) Ofertuesi duhet të paraqesë autodeklarate që pjesët e ofetuara janë të reja, të papërdorura dhe kompatibel me aparaturnë e pajisjes mjekësore.

e) Ofertuesi duhet të paraqesë për çdo pjesë të ofertuar, certifikatën e konformitetit CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian, e fotokopjuar, e përkthyer dhe e noterizuar.

ë) Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratën e garancisë për pjesët që oferton, në të cilën duhet të saktësojë se periudha e garancisë për pjesët e ofertuar të jetë jo më pak se 1 (një) vit, sipas afatit të përcaktuar në specifikimet teknike, për pjesët objekt prokurimi, ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e**

**mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 66: Furnizim Vendorsje Sonde Abdominale për Eko Prodhuesi ESAOTE/ ose ekuivalent, modeli MYLAB 50 XVISION me nr. inventari 19445**

**Fond limit: 425.000,00 (katërqind e njëzet e pesë mijë) lekë pa TVSH**

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre te jete **sa 40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### **3.6 Kapaciteti teknik:**

**a)** Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të kontrates qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.



b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej sherbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, certificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per furnizim vendosjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi mund te paraqese manualin e vendosjes per secilen pjese sipas rekomandimeve te prodhuesit, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e vendosjes.

dh) Ofertuesi duhet te paraqese autodeklarate qe pjeset e ofetuara jane te reja, te paperdorura dhe kompatibel me aparatoren e pajisjes mjekesore.

e) Ofertuesi duhet te paraqese per cdo pjese te ofertuar, certifikaten e komformitetit CE per aprovim te standarteve, direktivave ne tregun Europian, e fotokopjuar, e perkthyer dhe e noterizuar.

ë) Operatori ekonomik duhet te paraqese deklaraten e garancise per pjeset qe oferton, ne te cilen duhet te saktesoje se periudha e garancise per pjeset e ofertuar te jete jo me pak se 1 (nje) vit, sipas afatit te percaktuar ne specifikimet teknike, per pjeset objekt prokurimi, ku te perfshihen te gjitha defektet e mundeshme te tyre.

### Public Health Sector

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 67: Furnizim Vendosje te motorit te ventilimit dhe bordit kryeso për incubator prodhuesi GE/ ose ekuivalent, Modeli GIRAFFE INCUBATOR me nr. inventari 20953**

***Fond limit: 400.000,00 (katërqind mijë) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;

b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4

c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;

ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;

d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

---

### 3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit **(2015, 2016 dhe 2017)** ku vlera mesatare e tyre te jete sa **40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### 3.7 Kapaciteti teknik:

a) Shërbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të kontrates qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formulet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej shërbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per furnizim vendosjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi mund te paraqese manualin e vendosjes per secilen pjese sipas rekomandimeve te

prodhuesit, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e vendosjes.

dh) Ofertuesi duhet te paraqese autodeklarate qe pjeset e ofetuara jane te reja, te paperdorura dhe kompatibel me aparaturen e pajisjes mjekesore.

e) Ofertuesi duhet te paraqese per cdo pjese te ofertuar, certifikaten e komformitetit CE per aprovim te standarteve, direktivave ne tregun European, e fotokopjuar, e perkthyer dhe e noterizuar.

ë) Operatori ekonomik duhet te paraqese deklaraten e garancise per pjeset qe oferton, ne te cilen duhet te saktesoje se periudha e garancise per pjeset e ofertuar te jete jo me pak se 1 (nje) vit, sipas afatit te percaktuar ne specifikimet teknike, per pjeset objekt prokurimi, ku te perfshihen te gjitha defektet e mundeshme te tyre.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

**Loti 68: Furnizim Vendosje TouchScreen dhe Bateri për Defibrilatorin prodhuesi Philips/ ose ekuivalent, modeli MRX me nr. inventari 21975**

***Fond limit: 297.000,00 (dyqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë) lekë pa TVSH***

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Listën e informacionit konfidencial sipas Shtojcës 4
- c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

---

### **3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2015, 2016, 2017)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.

- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit (2015, 2016 dhe 2017) ku vlera mesatare e tyre te jete sa **40% i vleres se fondit limit** të lotit qe prokurohet.

### 3.8 Kapaciteti teknik:

a) Sherbime të ngjashme në një vlerë sa 30% e vlerës së fondit limit të kontrates qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre dhe/ose fatura tatimore të shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetem faturat tatimore te shitjes, ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Mars 2017 – Mars 2018 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 3(tre) punonjes).

c) Te vertetoje qe ka te pakten 1 Inxhinier në stafin e vete te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej sherbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates individuale te punes.

ç) Autorizim per operatorin ekonomik ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi per furnizim vendosjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjes mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

d) Ofertuesi mund te paraqese manualin e vendosjes per secilen pjese sipas rekomandimeve te prodhuesit, te perkthyer te fotokopjuara dhe noterizuara ku te jete percaktuar procedura e vendosjes.

dh) Ofertuesi duhet te paraqese autodeklarate qe pjeset e ofetuara jane te reja, te paperdorura dhe kompatibel me aparatoren e pajisjes mjekesore.

e) Ofertuesi duhet te paraqese per cdo pjese te ofertuar, certifikaten e komformitetit CE per aprovim te standarteve, direktivave ne tregun European, e fotokopjuar, e perkthyer dhe e noterizuar.

ë) Operatori ekonomik duhet te paraqese deklaraten e garancise per pjeset qe oferton, ne te cilen duhet te saktesoje se periudha e garancise per pjeset e ofertuar te jete jo me pak se 1 (nje) vit, sipas afatit te percaktuar ne specifikimet teknike, per pjeset objekt prokurimi, ku te perfshihen te gjitha defektet e mundeshme te tyre.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

Shtojca 9

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**

**Loti 1: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike prodhuesi ACL 9000 / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
20801	Analizator ACL	Analizator	IL INSTRUMENT LABORATORY	ACL 9000	4E+06		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

**Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në

probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.

- **Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive** për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe



tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.

- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Loti 2: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike, prodhuesit ABX / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
20607	Analizat or Hemato logjik	Analizator	ABX	Micros 60	409CT 75559		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik
19905	Analizat or Hemato logjik	Analizator	ABX	Micros 60	409CT 75614		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen

parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoretë të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.

- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Public Health Sector

#### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

#### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### Loti 3: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike prodhuesi BECKMAN COULTER / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19819	Analizat or Imunologjik	Analizator	BECKMAN COULTER	4700 Image	2479	2005	Spitali Patologjik (6 kateshi)	Shërbimi i Lab. Imunologjik
19703	Citometer Laser	CITOMETER	BECKMAN COULTER	XL-MCL			Spitali Patologjik (6kateshi)	Shërbimi i Lab. Imunologjik

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

#### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

#### Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret e cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparatat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### Loti 4: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike te prodhuesi DPC (Siemens) / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
20786	Analizator Imunologjik	Analizator	DPC (SIEMENS)	IMMULITE 1000	C0510		Spitali I Urgjencë Pranimi	Shërbimi I Labororit Klinik Biokimik
20785	Analizator Imunologjik	Analizator	DPC (SIEMENS)	IMMULITE 1000	C0509		Spitali I Urgjencë Pranimi	Shërbimi I Labororit Klinik Biokimik

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

#### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia,*



*intervalat kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*

- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalat e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbalin duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**

## Dokumentat standarde të tenderit

- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Public Health Sector

### **Loti 5: Mirëmbajtje e pajisjeve të Anestezise prodhuesi DRAGER / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
11796	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	DRAGER	FABIUS PLUS	ASBL-0309	2012	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 -Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
11729	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	DRAGER	FABIUS PLUS	ASBL-0308	2012	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 -Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
19815	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	DRAGER	FABIUS PLUS	ASBL-0310	2012	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 -Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
19948	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	DRAGER	FABIUS PLUS	ASCF-0027	2011	19 - Godina e Djegje Plastikes	19 - 77 - Shërbimi I Djegje Plastikës
19947	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	DRAGER	FABIUS PLUS	ASCF-0026	2011	19 - Godina e Djegje Plastikes	19 - 77 - Shërbimi I Djegje Plastikës

## Dokumentat standarde të tenderit

19735	APARAT ANESTE ZIE	Aparat Anestezie	DRAGER	FABIUS PLUS	USCA-0161	2011	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 27 - Shërbimi i Kirurgjise se Pergjithshme
-------	-------------------	------------------	--------	-------------	-----------	------	------------------------------	------------------------------------------------

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24

orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.

- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

## Dokumentat standarde të tenderit

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### Loti 6: Mirëmbajtje e pajisjeve të anestezisë prodhuesi MEDEC / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19839	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	NEPTUNE	1E+06	2005	1 - Spitali Francez	1 - 1 - Shërbimi i ORL
19837	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	NEPTUNE	1E+06	2005	1 - Spitali Francez	1 - 1 - Shërbimi i ORL
19838	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	NEPTUNE	12-05439	2005	1 - Spitali Francez	1 - 1 - Shërbimi i ORL
19840	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	NEPTUNE	18-05487	2005	1 - Spitali Francez	1 - 3 - Shërbimi i Okulistikes
19817	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	NEPTUNE	1E+06		15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion
30948	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	NEPTUNE	12/28972		4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise
11640	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	NEPTUNE	12/27519		8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 29 - Shërbimi i Kirurgjise Digjестive
12267	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	Saturn EVO	1E+08	1E+08	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion
21107	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	Saturn EVO	1E+07		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	22 - 82 - Shërbimi I Urgjencës Kirurgjikale
19721	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	SATURN EVO	10/17163		8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 27 - Shërbimi i Kirurgjise se Pergjithshme
31289	APARAT NARKOZE	Aparat Anestezie	MEDEC	SATURN EVO	12-06572		4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

#### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku*

*të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*

- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**



## Dokumentat standarde të tenderit

- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Public Health Sector

### **Loti 7: Mirëmbajtje e pajisjeve të Anestezise prodhuesi SIARE PERSEO / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
11657	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	SIARE PERSEO	VM2000	6E+06		8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 28 - Sherbimi i Urologjise
19273	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	SIARE PERSEO	VM2000	6E+07		8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 28 - Sherbimi i Urologjise
11758	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	SIARE PERSEO	VM2000	6E+06		8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 28 - Sherbimi i Urologjise

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.

## Dokumentat standarde të tenderit

- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## **Loti 8: Mirëmbajtje e pajisjeve të Dializes prodhuesi FRESINIUS / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
--------------	---------------	----------------	-----------	--------	-----------	----------------	------------------	----------

## Dokumentat standarde të tenderit

19258	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	Fresenius	4008S	9VCARF 82	2010	10 - Godina e Pediatrie se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19257	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	Fresenius	4008S	9VCARF 81	2010	10 - Godina e Pediatrie se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19256	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	Fresenius	4008S	9VCARF 80	2010	10 - Godina e Pediatrie se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19255	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	Fresenius	4008S	9VCARF 84	2010	10 - Godina e Pediatrie se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19254	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	Fresenius	4008S	9VCARF 83	2010	10 - Godina e Pediatrie se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19246	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	FRESENIUS	4008S	5VCAY0 88	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
31327	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	FRESENIUS	4008S	5VCAY0 88	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
31326	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	FRESENIUS	4008S	5VCAY0 95	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19247	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	FRESENIUS	4008S	5VCAY0 85	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
31410	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	FRESENIUS	4008S	5VCAY0 92	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
31328	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	FRESENIUS	4008S	5VCAY0 84	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
31409	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	FRESENIUS	4008S	5VCAY0 90	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19242	Pajisje e Impiantit te ujit te dializes	Impiant Uji	Fresenius	Aqua B 1250		2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19251	Pajisje e Impiantit te ujit te dializes	Impiant Uji	Fresenius	Aqua B 500		2010	10 - Spitali Pediatrik	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj*

*pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*

- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë**

**originale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**

- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

**Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

**Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

**Loti 9: Mirëmbajtje e pajisjes te Dializes prodhuesi HOSPAL / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19824	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	790546	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19858	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	757058	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19827	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	791299	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19829	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	757867	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19857	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	759035	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19825	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	793885	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise



## Dokumentat standarde të tenderit

19862	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	756139	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19859	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	757708	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19861	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	757561	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19828	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	757870	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19830	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	791298	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
31323	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	757054	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19860	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	791300	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19831	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	793884	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19832	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	711301	2005	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuar nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë

mirëmbajtjen.

- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret e cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Loti 10: Mirëmbajtje e pajisjes EEG EMG te prodhuesi NIHON KOHDEN / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19570	Aparat ezhe elektroencefa logram	EEG	NIHON-KOHDEN	EEG-4419K	769	2001	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 44 - Shërbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
19550	Elektromiogr af (EMG)	EMG	NIHON-KOHDEN	MEB-9102K	24	2001	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 44 - Shërbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
19551	EMG	EMG	NIHON-KOHDEN	MEB-9102K	23	2001	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 44 - Shërbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i

pajisjeve.

- **Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive** për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverballi duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

#### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverballit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.

- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

### **Public Health Sector**

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## **Loti 11: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
31235	Aparat Grafie C-Arm	Grafi	GMM	MCA PRIME	65-12-04-08		10 - Spitali Pediatrik	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
20670	Sistem Radiografi	Grafi	GMM	CS15SL	1824RE V46	2009	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.



## Dokumentat standarde të tenderit

- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Loti 12: Mirëmbajtje e pajisjes Grafi prodhuesit Shimadzu / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
--------------	---------------	----------------	-----------	--------	-----------	----------------	------------------	----------

## Dokumentat standarde të tenderit

19912	APARAT RONGENI PORTATIV	APARAT RONGENI	Shimadzu	MUX-10	0462P81 610	2009	12 - Spitali Infektiv	12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv
-------	-------------------------	----------------	----------	--------	----------------	------	-----------------------	--------------------------------------------

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të

ndryshme apo difekte të pajisjes.

- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha

aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### **Loti 13: Mirëmbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSENS / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19235	APARAT SKANIMI HEPATIK	FIBROSCAN	ECHOSENS	FIBROSCA N 502	FO 1372	2012	12 - Spitali Infektiv	12 - 50 - Shërbimi Infektiv

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

#### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuar nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

#### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret e cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametereve sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparatat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### Loti 14: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator prodhuesi ACOMA / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
20931	Respirator	Respirator	Acoma (Nakamura)	ICV-60	1059	2001	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
20995	RESPIRATOR	RESPIRATOR	Acoma (Nakamura)	ICV-60	325	2001	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

#### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

#### Public Health Sector

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e



mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.

- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoretë të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo

kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Loti 15: Mirëmbajtje e pajisjes Aspirator Ultrasonic prodhuesi INTEGRA LifeSciences Corporation / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19431	Aspirator Ultrasonik	Aspirator Ultrasonik	INTEGRA LifeSciences Corporation	Dissectron	FCL1000 103		15 - Spitali Neurokirurgjise	Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.

- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbalit duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret e cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.

- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

### Public Health Sector

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Loti 16: Mirëmbajtje e pajisjeve Aspirator prodhuesi MIZUHO / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19393	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514500	2001	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Peditrike
19660	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	BSM-4101K	514499	2001	11 - Godina e Peditrise se vjeter	11 - 48 - Shërbimi i Peditrise Infektive
19383	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514496	2001	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Peditrike
20924	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514504	2001	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Peditrike

## Dokumentat standarde të tenderit

19983	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514500	2001	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
20918	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514489	2001	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike(Reanimaci on)
20943	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514491	2001	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike(Reanimaci on)
20923	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514498	2001	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike(Reanimaci on)
20917	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514507	2001	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike(Reanimaci on)
19558	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514497	2001	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 40 - Sherbimi i Onkohematologjise Pediatrike
31065	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	511490	2001	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike
31061	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	5E+06	2001	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike
31071	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	5E+06	2001	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike
11532	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514486	2001	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
11530	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514494	2001	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
19577	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514509	2001	10 - Godina e Pediatrie se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19560	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514508	2001	10 - Godina e Pediatrie se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
31198	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514511	2001	10 - Spitali Pediatrik	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
31197	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514501	2001	10 - Spitali Pediatrik	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
31196	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514506	2001	10 - Spitali Pediatrik	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
19637	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514468	2001	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19332	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514484	2001	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19333	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514495	2001	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19636	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514493	2001	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19674	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514510	2001	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Pediatrie Infektive

## Dokumentat standarde të tenderit

19792	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514487	2001	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Pediatrie Infektive
19388	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514492	2001	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Pediatrie Infektive
19348	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514505	2001	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Pediatrie Infektive

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë



- drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
  - Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
  - Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
  - Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
  - Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
  - **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
  - Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
  - Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
  - Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### **Loti 17: Mirëmbajtje e pajisjeve Autoanalizator prodhuesi OLYMPUS / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19822	Autoanalizat or Kimik	Autoanalizat or	OLYMPUS	Au640		2005	Spitali I Urgjencë Pranimi	Laboratorit Klinik Biokimik
19821	Autoanalizat or Kimik	Autoanalizat or	OLYMPUS	Au640		2005	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	Laboratorit Klinik Biokimik

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

#### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret e cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

#### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të çertifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë**

**shërbimet e furnizim vendosje.**

**Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

**Loti 18: Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
21488	C-Arm	C-Arm	Philips	BV Libra	119	2004	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 27 - Shërbimi i Kirurgjise se Pergjithshme
11635	C-ARM	C-Arm	PHILIPS	BV LIBRA	118	2004	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 29 - Shërbimi i Kirurgjise Digjестive
11676	C-ARM	C-Arm	PHILIPS	BV LIBRA	121	2004	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 28 - Shërbimi i Urologjise
19942	C-Arm portativ SISTEM	C-Arm	PHILIPS	BV LIBRA	120	2004	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion

**Public Health Sector**

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

**Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuar nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia,*

*intervallet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*

- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervallet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverballi duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverballit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**

## Dokumentat standarde të tenderit

- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Public Health Sector

### **Loti 19: Mirëmbajtje e pajisjes CO2 Laser prodhuesi LUMENIS / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19864	CO2 Diode Laser	Laser	Lumenis	SA-1021190 AcuPulse 30	106	2012	1 - Spitali Francez	1 - 1 - Shërbimi i ORL

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e



mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.

- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.

## Dokumentat standarde të tenderit

- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Loti 20: Mirëmbajtje e disa pajisjeve te prodhuesi GE / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
21037	Ekokardiogra f	EKO	GE	VIVID S5	1428VS5	2010	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	19 -91 - Mjekesia Interne HTA
20979	INKUBATOR	Inkubator	GE	GIRAFFE INCUBATOR	HDHR52731	-	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike

## Dokumentat standarde të tenderit

19262	Aparat Anestezie	Aparat Anestezie	GE	AESPIRE VIEW	APHR00 580		10 - Spitali Pediatrik	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
-------	------------------	------------------	----	--------------	------------	--	------------------------	--------------------------------------------

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoretë të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të

ndryshme apo difekte të pajisjes.

- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha

aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

**Loti 21: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
21981	Defibrilator	Defibrilator	NIHON-KOHDEN	CARDIOLINE TEC7721K	80548		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	19 -91 - Mjekesia Interne HTA
20958	DEFIBRILATOR	Defibrilator	NIHON-KOHDEN	CARDIOLIFE TEL-7521K	2930	2001	11 - Godina e Pediatrise se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme(Reanimacion)
31057	DEFIBRILATOR	Defibrilator	NIHON-KOHDEN	TEC-SS21K	87092		4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise
19723	DEFIBRILATOR	Defibrilator	NIHON-KOHDEN	TEC-7721K	80551		8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme
31292	DEFIBRILATORI	Defibrilator	NIHON-KOHDEN	CARDIOLIFE ACTIBIPHASIC TEC 5521K	11467		4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise
11513	DEFIBRILATORI	Defibrilator	NIHON-KOHDEN	CARDIOLIFE TEC-7721K	80547		19 - Godina e Djegie Plastikes	19 - 77 - Shërbimi I Djegie Plastikës

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

**Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuar nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të

mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.

- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit



## Dokumentat standarde të tenderit

të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## **Loti 22: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19747	Defibrilator	Defibrilator	PHILIPS	HEART START XL	US00448591		4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise
20096	Defibrilator	Defibrilator	PHILIPS	HEARTSTART MRX	US00559537		3 - Spitali Patologjik (6 - kateshi)	3 - 10 - Reparti i Hemodinamikës
21471	Defibrilator	Defibrilator	PHILIPS	HEARTSTART MRX	US00559332		3 - Spitali Patologjik (6 - kateshi)	3 - 10 - Reparti i Hemodinamikës

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet

inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.

- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbalit duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport

servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.

- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Loti 23: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi PHILIPS / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19940	ECHO	EKO	PHILIPS	HD7	CI 54110197		3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 14 - Shërbimi i Gastrohepatologjise
19846	ECHO	EKO	PHILIPS	HDI 5000 SONO CT		2002	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	19 -91 - Mjekesia Interne HTA

## Dokumentat standarde të tenderit

19843	ECHO	EKO	PHILIPS	HDI 5000 SONO CT	02BHW	2002	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 12 - Kardiologji I
31044	ECHO	EKO	PHILIPS	IMAGE POINT HX	US 50203151	2001	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 11 - Reanimacioni Kardiologjise
19844	ECHO	EKO	PHILIPS	SONOS 4000	A46001149	2004	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	Sherbimi i Imazherise , Semundjet e brendshme
20215	ECHO DOPPLER	EKO	PHILIPS	HD7	S C 150080050		14 - Spitali Neurologjise	14 - 58 - Shërbimi I Neurologjisë
30988	ECHO KARDIAKE	EKO	PHILIPS	EnVisor C HD		2004	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise
21739	EKO	EKO	PHILIPS	HDI 4000	A460001146	2004	9 - Spitali Petrit Selenica	9 - 32 - Shërbimi i Imazherisë

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuar nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret e cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparatat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### Loti 24: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi ESAOTE / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
20768	ECHO	EKO	ESAOTE	MEGAS GP 7251	1089		24 - Qendra e Konsultave	Kabineti i citologjise
30930	ECHO KARDIAKE	EKO	ESAOTE	7340	4314		4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise (salle, Reanimacion)

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

#### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

#### Public Health Sector

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuar nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e



mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.

- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoretë të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo

## Dokumentat standarde të tenderit

kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Loti 25: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SIEMENS / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
21879	EKO ZEMRE KARDIAKE	EKO	SIEMENS	ACUSON SC 2000	400935		3 - Spitali Patologjik (6 - kateshi)	3 - 11 - Shërbimi i Kardiokirurgjise II
20228	ECHO E PERGJITHS HME (3+1 SONDE)	EKO	SIEMENS	10348631 ACUSON X300	317447	2010	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 64 - Reparti I Konsultave Neurokirurgjike
31051	Eko Kardiake	EKO	SIEMENS	ACUSON X300 PE	348958	2014	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise
21784	EKO	EKO	SIEMENS	ACUSON X300	342739		3 - Spitali Patologjik (6 - kateshi)	3 - 12 - Kardiologji I
21757	EKO	EKO	SIEMENS	ACUSON X 300	342760		24 - Qendra e Konsultave	24 - 1 - Qendra e Konsultave
31957	EKO	EKO	SIEMENS	ACUSON X300	1E+07	2015	3 - Spitali Patologjik (6 - kateshi)	3 - 11 - Reanimacioni Kardiologjise

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet,

mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.

- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

Public Health Sector

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

**Loti 26: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SAMSUNG MEDISON / ose ekuivalent**

## Dokumentat standarde të tenderit

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
20915	ECHO DOPPLER PORTATIVE	EKO	SAMSUNG MEDISON	SONOACE R3 SAR3-EXP-1P-00	SOH9M 3HCA00 00IT	-	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
19418	EKO	EKO	SAMSUNG MEDISON	SONOACE X8	B025083 0000455 6	2010	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë
19946	EKO	EKO	SAMSUNG MEDISON	SONOACE X8	B025083 0000455 5	2011	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë
19297	Eko	EKO	SAMSUNG MEDISON	Sonoace X8	B025083 0000455 4	-	24 - Qendra e Konsultave	Qendra e Konsultave
19209	EKO	EKO	SAMSUNG MEDISON	SONOACE X8 SAXC3H/W R	SOMLM 3HCA00 00IT		18 - Spitali Onkologjik	18 - 70 - Shërbimi Onkologjik
19932	EKO	EKO	SAMSUNG MEDISON	SONOACE X8SAX8EX -EXP-CW-20	SOMLM 3HCA00 002B		12 - Spitali Infektiv	12 - 50 - Shërbimi Infektiv
21885	EKO	EKO	SAMSUNG MEDISON	SONOACE 9900	A 6950330 0000452	2006	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Shërbimi i Nefrologjise

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë

mirëmbajtjen.

- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret e cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo ripari apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:



### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### Loti 27: Mirëmbajtje e pajisje Imazherike prodhuesi TOSHIBA / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
21651	Tomografi	Tomografi	Toshiba	TS-TA-5A	D1562529		10 - Godina e Pediatrise se Re	21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë
21660	Eko Doppler	EKO	Toshiba	Power vision 6000	A1562817		10 - Godina e Pediatrise se Re	21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj*

*pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*

- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë**

**originale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**

- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

**Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

**Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

**Loti 28: Mirëmbajtje e pajisjeve të Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
31278	Ekstrakorporal	Ekstrakorporal	MAQUET	HL 20	9E+07	2014	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

**Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e

mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.

- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.

- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## **Loti 29: Mirëmbajtje e pajisjeve te KardioKirurgjise prodhuesi TERUMO / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
31278	Ekstrakorporal	Ekstrakorporal	MAQUET	HL 20	9E+07	2014	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoretë të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më



vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.

- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### Loti 30: Mirëmbajtje e pajisjeve Elektroforeze prodhuesi SEBIA / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
20877	Elektroforeze	Analizator	SEBIA	HYDRASY S	C0510		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik
20821	Lexues	Analizator	SEBIA	Hyrays 2	846		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

#### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

#### Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret e cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparatat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### Loti 31: Mirëmbajtje e pajisjes neuroendoskopike prodhuesi Aesculap / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
21465	Endoskop	Neuroendoskop	AESCLAP	PV 890	1216		15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

#### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- **Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuar nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.**
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të

mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.

- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit

të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Loti 32: Mirëmbajtje e pajisjes Endoskopike prodhuesi PENTAX / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19420	ENDOSKOP PORTATIV	Endoskop	PENTAX	FI-168S	G110843		12 - Spitali Infektiv	12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i



pajisjeve.

- **Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive** për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuar nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverballi duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

#### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverballit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.

- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

### Public Health Sector

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Loti 33: Mirëmbajtje e pajisjes FAKO prodhuesi ALCON / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
20149	FAKO	Fako	ALCON	INFINITI	1202711 301X		1 - Spitali Francez	1 - 3 - Shërbimi i Okulistikes

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës

pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori

duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.

- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

**Loti 34: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi CARL STORZ / ose**

**ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19435	Endoskopi	Endoskop	CARL STORZ	Calcutrip (AUTOCO N-11400)	KB01345	-	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 28 - Shërbimi i Urologjise
19239	KOLONA ENDOSKOPI SE	Kolona Endoskopise	CARL STORZ	Calcutript	27080	2006	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 28 - Shërbimi i Urologjise
19576	Fibro-Bronkoskop me burim drite	Fibro-Bronkopskopi	CARL STORZ	20045020	WX2882	2012	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 44 - Shërbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
19234	VIDEO KOLONOSKOP	Endoskop	CARL STORZ	XENON 20132620	UX1843	2012	12 - Spitali Infektiv	12 - 50 - Shërbimi Infektiv
19265	Set Endoskopie (Burim Drite)	Endoskopi	CARL STORZ	XENON 100/20136220	NX1722		10 - Spitali Pediatrik	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
31218	Set Laparoskopie (Burim Drite)	Laparoskopie	CARL STORZ	XENON NOVA 300/20134020	PX 0679630		10 - Spitali Pediatrik	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

**Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë

mirëmbajtjen.

- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret e cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:



### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### Loti 35: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi OLYMPUS / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
30900	Fibroskopi	Fibroskopi	OLYMPUS	CV-100	11515		8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 29 - Sherbimi i Kirurgjise Digjestive
11953	Sistem Laparoskopie (Burim Drite)	Sistem Laparoskopie	OLYMPUS	CLV-180	7E+06		8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 29 - Sherbimi i Kirurgjise Digjestive

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj*

*pajisje sipas manualeve të përcaktuar nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*

- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë**

**originale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**

- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

**Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

**Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

**Loti 36: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILIPS / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
21489	Grafi Portative	Grafi	Philips	Practix 300	254	2004	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme
19763	Grafi Portative	Grafi Portative	Philips	Practix 160		2004	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise(Reanimacion)

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

**Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e

mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.

- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.

- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## **Loti 37: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi/Skopi te prodhuesi Philips / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19958	Grafi/Skopi	Grafi/Skopi	Philips	Duo Diagnost		2004	12 - Spitali Infektiv	Kabineti Grafi-Skopi

## Dokumentat standarde të tenderit

20219	Grafi/Skopi	Grafi/Skopi	Philips	Duo Diagnost		2004	14 - Spitali Neurologjise	14 - 58 - Shërbimi I Neurologjisë
20836	Grafi/Skopi	Grafi/Skopi	Philips	Duo Diagnost		2004	18 - Spitali Onkologjik	18 - 70 - Shërbimi Onkologjik
31434	Grafi/Skopi	Grafi/Skopi	Philips	Duo Diagnost		2004	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 9 - Shërbimi i Kardiokirurgjise I
21722	Grafi/Skopi	Grafi/Skopi	Philips	Duo Diagnost		2004	9 - Spitali Petrit Selenica	9 - 32 - Shërbimi i Imzherisë

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuar nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në



mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.

- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit. Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### **Loti 38: Mirëmbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19250	Hidroklave	Hidroklave	Hydrocllave	H-15	HSC-09121512	-	1 - Spitali Francez	1 - Spitali Francez

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

#### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.

- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret e cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparatat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### Loti 39: Mirëmbajtje e pajisjes intraaortik Ballon prodhuesit ARROW Teleflex / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19796	IABP (INTRAOR TIK BALLON POMP)	IABP (INTRAOR TIK BALLON POMP)	ARROW Teleflex	AUTOCAT II	60946V	2011	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku*

*të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*

- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**

## Dokumentat standarde të tenderit

- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

Public Health Sector

## Loti 40: Mirëmbajtje e pajisjeve Inhalator prodhuesi KOUSHIN INDUSTRIES / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
20926	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE S	COMFORT 2000 KU-400	106014	-	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike (Reanimacion)
20928	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE S	COMFORT 2000 KU-400	106013	-	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike (Reanimacion)
20925	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE	COMFORT 2000 KU-400	106018	-	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
20927	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE	COMFORT 2000 KU-400	106015	-	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike



## Dokumentat standarde të tenderit

20987	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE	COMFORT 2000 KU-400	106012	-	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Peditrike
19390	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE S	COMFORD 2000 KU-400	106016		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 40 - Sherbimi i Onkohematologjise Peditrike
20948	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE S	COMFORT 2000 KU-400	106017	-	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Peditrike(Reanimacion)
31060	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE S	COMFORT 2000 KU-400	106005		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Peditrike
31075	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE S	COMFORT 2000 KU-400	106008		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Peditrike
31073	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE S	COMFORT 2000 KU-400	106011		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Peditrike
31064	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE S	COMFORT 2000 KU-400	106009		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Peditrike
19541	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE S	COMFORT 2000 KU-400	106003		10 - Godina e Peditrise se Re	11 - 46 - Sherbimi i Peditrise se Pergjithshme
30905	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE S	COMFORT 2000 KU-400	1E+06	-	10 - Spitali Peditrik	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Peditrike
19676	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE S	COMFORT 2000 KU-400	106002		11 - Godina e Peditrise se vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Peditrise Infektive
19399	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE S	COMFORT 2000 KU-400	106001		11 - Godina e Peditrise se vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Peditrise Infektive

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuar nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*

- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoreve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.

## Dokumentat standarde të tenderit

- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

Public Health Sector

## Loti 41: Mirëmbajtje e pajisjeve Inkubator prodhuesi NAKAMURA dhe ATOM / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
20936	Inkubator A	Inkubator	Nakamura	H-1000	1522	-	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Peditrike (REANIMACIONI)
20952	Inkubator A	Inkubator	Nakamura	H-1000	1523	-	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Peditrike (REANIMACIONI)
20946	Inkubator B	Inkubator	ATOM MEDICAL	V-88	1E+06	2001	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Peditrike (REANIMACIONI)
19394	Inkubator Kirurgjikal	Inkubator	ATOM MEDICAL	V-850	10605	2001	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Peditrike (REANIMACIONI)
20963	Inkubator Kirurgjikal	Inkubator	ATOM MEDICAL	V-88	1E+06	2001	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Peditrike (REANIMACIONI)

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret e cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.

- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo ripari apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparatat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparatë ose të gjitha aparatat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Loti 42: Mirëmbajtje e pajisjes Lithotripter prodhuesi STORZ MEDICAL / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19241	Lithotripter	Lithotripter	STROZ MEDICAL	Modulith SLX-F2	OR.547	2009	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 28 - Shërbimi i Urologjise

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e



mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.

- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.  
 Pjesët të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.  
 Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.  
 Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.  
 Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### **Loti 43: Mirëmbajtje e pajisjes MAMOGRAF prodhuesi IMS GIOTTO / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19853	Mamograf	Mamograf	IMS GIOTTO	6902	44397	2010	18 - Spitali Onkologjik	18 - 70 - Shërbimi Onkologjik

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

#### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverballi duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.

- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret e cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparatat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### **Loti 44: Mirëmbajtje e pajisjes Mikroskop, prodhuesi ZEISS / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19900	Mikroskop	Mikroskop	Zeiss	S7	1087-851	2005	1 - Spitali Francez	Salla operacioni

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuar nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe

përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.

- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoretë të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë

## Dokumentat standarde të tenderit

uljen e çmimit të ofertës.

- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të çertifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## **Loti 45: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19571	Monitor pacienti kardiak	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4101K	87		10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 44 - Shërbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
19534	Monitor pacienti kardiak	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4101K	42		10 - Godina e Pediatrise se Re	11 - 46 - Shërbimi i Pediatrise se Pergjithshme
19580	Monitor pacienti kardiak	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4101K	86		10 - Godina e Pediatrise se Re	11 - 46 - Shërbimi i Pediatrise se Pergjithshme
19775	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4113K	1629		4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion)
19753	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4113K	1628		4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion)
19775	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4113K	1726		4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion)
18773	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4113K			4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion)



## Dokumentat standarde të tenderit

19798	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-5105K	382		4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion)
20988	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4101K	19		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Peditrike
20984	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4101K	93	-	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Peditrike
20999	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4101K	88		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Peditrike
20967	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4101K	23		10 - Godina e Peditrise se Re	11 - 46 - Sherbimi i Peditrise se Pergjithshme
19622	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4101K	0050AA		11 - Godina e Peditrise se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Peditrise se Pergjithshme
19745	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-3763K	00675		4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion)
19766	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-3763K	00890		4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion)

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal

të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Loti 46: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti, prodhuesi DRAGER / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19809	MONITOR PACIENTI	MONITOR	DRAGER	INFINITY DELTA XL	6E+09	2010	15 - Spitali Neurokirurgjise	Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
19411	MONITOR PACIENTI	MONITOR	DRAGER	INFINITY DELTA XL	6E+09	2010	15 - Spitali Neurokirurgjise	Shërbimi Neurokirurgjise(Reanimacion)
19364	MONITOR PACIENTI	MONITOR	DRAGER	INFINITY DELTA XL	6E+09	2010	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
19936	MONITOR PACIENTI	MONITOR	DRAGER	INFINITY DELTA XL	6E+09	-	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
19935	MONITOR PACIENTI	MONITOR	DRAGER	INFINITY DELTA XL	6E+09	-	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
19808	MONITOR PACIENTI	MONITOR	DRAGER	INFINITY DELTA XL	6E+09	-	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin

dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.

- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka,

kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.

- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## **Loti 47: Mirëmbajtje e pajisjes Neuronavigator prodhuesi MEDTRONIC / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
11933	Neuronavigat or	Neuronavigat or	MEDTRONIC	STEALTH STATION S7	N00861129		15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës

pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori



duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.

- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

**Loti 48: Mirëmbajtje e pajisjes EMG prodhuesi MICROMED / ose ekuivalent**

## Dokumentat standarde të tenderit

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
21690	NJESI QENDRORE EMG+PE	EMG	MIKROMED	MATRIX 1009	MX3- 0016/02- 08		15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 64 - Reparti I Konsultave Neurokirurgjike

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë

- drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
  - Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
  - Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
  - Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
  - Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
  - **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
  - Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
  - Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
  - Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### **Loti 49: Mirëmbajtje e pajisjes Body Box prodhuesi JAEGER / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
21530	PAJISJE PER MATJEN E RRUGEVE RESPIRATORE	BODY BOX	JAEGER	MASTER SCREEN BODY	705425-08V00011	2010	12 - Spitali Infektiv	12 - 54 - Shërbimi I Alergologjisë

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

#### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuar nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

#### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit

## Dokumentat standarde të tenderit

për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Loti 50: Mirëmbajtje e pajisjeve Pompa Infuzioni, prodhuesi NAKAMURA MEDICAL / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19542	Pompe infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		10 - Godina e Pediatrise se Re	11 - 46 - Shërbimi i Pediatrise se Pergjithshme
19557	Pompe infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		10 - Godina e Pediatrise se Re	11 - 46 - Shërbimi i Pediatrise se Pergjithshme
19543	Pompe infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		10 - Godina e Pediatrise se Re	11 - 46 - Shërbimi i Pediatrise se Pergjithshme
20920	POMPE INFUSIONI	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06	-	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
20921	POMPE INFUSIONI	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06	-	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
20919	POMPE INFUSIONI	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06	-	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
20937	POMPE INFUSIONI	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06	-	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
31077	POMPE INFUSIONI	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 43 - Shërbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike
31076	POMPE INFUSIONI	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 43 - Shërbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike
31078	POMPE INFUSIONI	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 43 - Shërbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike
19639	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06	-	11 - Godina e Pediatrise se vjeter	11 - 46 - Shërbimi i Pediatrise se Pergjithshme



## Dokumentat standarde të tenderit

19791	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
19367	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
19323	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 40 - Sherbimi i Onkohematologjise Pediatrike
11533	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
11536	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
19538	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
11534	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
11538	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
11556	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
19641	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19343	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19645	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19423	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19331	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuar nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku*

*të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*

- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**

## Dokumentat standarde të tenderit

- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparatat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparatë ose të gjitha aparatat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

**Loti 51: Mirëmbajtje e pajisjes C-Arm te prodhuesit SIEMENS / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
21449	Radioskopi Portative (C-Arm)	C-Arm	SIEMENS	ARCADIS ORBIC, 10143407	22354	2011	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin

dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.

- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka,

kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.

- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparatat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparatë ose të gjitha aparatat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## **Loti 52: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesit DRAGER / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19349	Respirator	Respirator	DRAGER	EVITA XL	ASBL-0350		15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion
19270	Respirator	Respirator	DRAGER	EVITA XL	ASBL-0353		15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion

## Dokumentat standarde të tenderit

19272	Respirator	Respirator	DRAGER	EVITA XL	ABSL-0351	2010	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
21682	Respirator	Respirator	DRAGER	EVITA XL	ASBL - 0352		15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
19777	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	ASCD-0076		15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
19760	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	ASCD-0085	2011	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
21157	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	ASCD-0072		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm
21158	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	ASCD-0078		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm
21371	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	ASCD-0077		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm
21189	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	ASCD-0074		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm
19794	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	8414000-07		4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise(Reanimacion)
19788	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	8414000-07ARRD-0035		4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise(Reanimacion)
30991	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	8414000-07		4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise(Reanimacion)
19949	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	ASCE-0131		19 - Godina e Djeje Plastikës	19 - 77 - Shërbimi I Djeje Plastikës

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe



përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.

- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret e cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë

## Dokumentat standarde të tenderit

uljen e çmimit të ofertës.

- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparatat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparatë ose të gjitha aparatat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## **Loti 53: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesi NEWPORT / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
20986	Respirator	RESPIRATOR	NEW PORT	eE360e	N113601 17607	-	10 - Godina e Pediatrie se Re	Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
20965	Respirator	RESPIRATOR	NEW PORT	eE360e	M11360 117608	-	Godina e Pediatrie se Re	1Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
19762	Respirator	RESPIRATOR	NEW PORT	e360	6E+09		4 - Kardiokirurgjia	Sherbimi i Kardiokirurgjise
19774	Respirator	RESPIRATOR	NEW PORT	e360	6E+09		4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet,

mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.

- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

Public Health Sector

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## **Loti 54: Mirëmbajtje e pajisjeve respirator te prodhuesit VIASYS Healthcare / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
--------------	---------------	----------------	-----------	--------	-----------	----------------	------------------	----------

## Dokumentat standarde të tenderit

19203	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA COMPREHENSIVE 16532-02	AKT041 25		12 - Spitali Infektiv	12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv
19509	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA COMPREHENSIVE 16532-02	AKT041 51		12 - Spitali Infektiv	12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv
19986	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA COMPREHENSIVE 16532-02	AKT042 02		12 - Spitali Infektiv	12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv
19929	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA COMPREHENSIVE 16532-02	AKT042 02		12 - Spitali Infektiv	12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv
19204	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA COMPREHENSIVE 16532-02	AKT042 15		12 - Spitali Infektiv	12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv
19299	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA COMPREHENSIVE 16532-02	AKT004 218		12 - Spitali Infektiv	12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv
19211	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA 16532-02	BAT 02053		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm
19215	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA 16532-02	BAT 02052		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm
19212	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA 16532-02	BAT 01916		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm
19214	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA 16532-02	BAT 02016		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm
21193	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA 16532-02	BAT 02034		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm
19218	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA 16532-02	BAT 02040		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm
21173	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA 16532-02	BAT019 70		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm
19217	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA 16532-02	BAT 02029		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në

probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.

- **Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive** për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuar nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe



tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.

- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohej nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## **Loti 55: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre prodhuesi AESCULAP / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
11705	Sharre	Sharre	AESCULAP	Microspeed Uni	4245		15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

#### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoretë të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për

garantimin e funksionimit normal të pajisjes.

- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## **Loti 56: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre Oshilante prodhuesi DE SOUTER / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
31059	SHARRE OSHILANTE	SHARRE	DE SOUTER	DBR-700	14/00519	2014	4 - Kardiokirurgjia	Shërbimi i Kardiokirurgjise(Salle Operacioni)

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më

vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.

- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

**Loti 57: Mirëmbajtje e Shiringave Elektrike prodhuesi ATOM MEDICAL / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
19621	Shiringe elektrike	Shiringa Elektrike	ATOM MEDICAL	SP8800	0D13C0 123		11 - Godina e Peditrise se vjeter	11 - 46 - Shërbimi i Peditrise se Pergjithshme
20993	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 44 - Shërbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
20980	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 44 - Shërbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
20989	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+07		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 44 - Shërbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
11531	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 44 - Shërbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
11560	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 44 - Shërbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
11559	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 44 - Shërbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
20992	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 44 - Shërbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
20971	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Peditrike
19338	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 40 - Shërbimi i Onkohematologjise Peditrike
31444	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		10 - Godina e Peditrise se Vjeter	10 - 44 - Shërbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
31412	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		10 - Godina e Peditrise se Vjeter	10 - 44 - Shërbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
19386	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		10 - Godina e Peditrise se Vjeter	11 - 48 - Shërbimi i Peditrise Infektive
19387	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		10 - Godina e Peditrise se Vjeter	11 - 48 - Shërbimi i Peditrise Infektive
31176	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		10 - Godina e Peditrise se Vjeter	11 - 48 - Shërbimi i Peditrise Infektive
19665	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		10 - Godina e Peditrise se Vjeter	11 - 48 - Shërbimi i Peditrise Infektive
21920	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	SP8800	OD1080 011		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 40 - Shërbimi i Onkohematologjise Peditrike
21639	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	SP8800	OD10B0 036		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 40 - Shërbimi i Onkohematologjise Peditrike
19545	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	SP8800	OD10A0 113		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 40 - Shërbimi i Onkohematologjise Peditrike
21638	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	SP8800	OD10B0 005		10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 40 - Shërbimi i Onkohematologjise Peditrike



Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret e cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.

- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo ripari apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparatat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparatë ose të gjitha aparatat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## Loti 58: Mirëmbajtje e monitoreve dhe sistemit te monitorimit te pacientit prodhuesi Philips / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
	Sistem Monitorim pacienti (Server + 19 Monitor pacienti)	Sistem	Philips	UT4800 (Monitor pacienti G60)		2012	4 - Kardiokirurgjia	Reanimacioni Kardiologjise

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret e cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparatat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë çertifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### Loti 59: Mirëmbajtje e pajisjes Spirometer prodhuesi CHEST / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
31067	SPIROMETE R	SPIROMETE R	CHEST	CHEST GRAPH	1E+06		10 - Godina e Pediatrise se Re	Shërbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

#### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuar para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuar nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë

mirëmbajtjen.

- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret e cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo ripari apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparaturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:



### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standardeve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparaturë ose të gjitha aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

### Loti 60: Mirëmbajtje e pajisjes TREADMILL prodhuesit CARDIOLINE / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
21800	TREADMILL	TREADMILL	CARDIOLINE	CC XR 600	6E+06		3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 10 - Reparti i Hemodinamikës
31507	TREADMILL	TREADMILL	CARDIOLINE	XR600M	631200		24 - Qendra e Konsultave	24 - 1 - Qendra e Konsultave
21958	TreadMill	TreadMill	CARDIOLINE	CXR 600	KEY037 58		21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	19 -91 - Mjekesia Interne HTA

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i

pajisjeve.

- **Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive** për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverballi duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverballit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.

- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

### **Public Health Sector**

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## **Loti 61: Mirëmbajtje e pajisjes endoskopike prodhuesi FUJINON / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
21916	Unit Endoskopie	Endoskop	FUJINON	NDS	1E+07	-	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	Shërbimi i Gastrohepatologjise

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- ***Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.***
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korrigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesoret të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo difekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet,

mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.

- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### Specifikime të përgjithshme

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

Public Health Sector

### Specifikime të Veçanta

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha aparataturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

## **Loti 62: Mirëmbajtje e pajisjes video EEG prodhuesi Viasys Healthcare / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Vendodhja Godine	Shërbimi
--------------	---------------	----------------	-----------	--------	-----------	----------------	------------------	----------

## Dokumentat standarde të tenderit

20192	VIDEO EEG	EEG	VIASYS HEALTHCARE	NIKOLET ONE			14 - Spitali Neurologjise	14 - Spitali Neurologjise Pavion
-------	-----------	-----	-------------------	-------------	--	--	---------------------------	----------------------------------

Mirëmbajtja e plotëe pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

### **Mirëmbajtjen parandaluese/preventive të pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekti i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi të çdo pajisje dhe përbërësit e saj nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
- *Ofertuesi duhet të paraqesë gjatë tenderimit mirëmbajtjen preventive për secilën lloj pajisje sipas manualeve të përcaktuara nga prodhuesi, të fotokopjuara dhe noterizuara ku të jetë përcaktuar procedura e kontrollit, pjesët që do të ndërrohen dhe shpejtësia, intervalet kohore kur është përcaktuar të bëhet mirëmbajtja.*
- Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e NJIK dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet në intervalet e përcaktuara nga prodhuesi.
- Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Proçesverbali duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
- Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes.

### **Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore**

- Në mirëmbajtjen korigjuese shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo difekti të mundshëm gjatë periudhës së kontratës për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen në mënyrë që pajisja të jetë në shërbim të stafit mjekësor (printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice (larës filmash)) dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga NJIK për mosfunksionimin normal, probleme të



ndryshme apo difekte të pajisjes.

- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi korrigjimi i difektit duhet të realizohet jo më vonë 24 orë ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një difekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë difektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit.
- Pas riparimeve, ndërhyrjeve të kryera shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e difektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes, dhe shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i NJIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
- **Shoqëria e kontraktuar duhet të jetë e autorizuar nga prodhuesi dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale. Të ketë staf të trajnuar për pajisjet mjekësore.**
- Çmimet e ofertuara duhet të jenë për çdo lot dhe për çdo pajisje.
- Në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht ai duhet të ofertojë uljen e çmimit të ofertës.
- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë dhe vetëm për një pajisje të grupit të pajisjeve që përmban loti lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor

Për furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për aparataturat mjekësore komisioni përcaktoi specifikimet si më poshtë:

### **Specifikime të përgjithshme**

Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.

**Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore, i cili do të kryejë shërbimet e furnizim vendosje.**

### **Specifikime të Veçanta**

Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.

Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun Europian.

Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

Pajisja të jetë në gjendje të plotë pune pas instalimeve pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën ta heqi nga regjimi i mirëmbajtjes këtë aparataturë ose të gjitha

aparaturat dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

**Loti 63: Furnizim vendosje e kokes goditese e litotripterit Storz Medical / ose ekuivalent Nr. Inventari 19241**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Shërbimi
19241	Furnizim vendosje e kokes goditese e litotripterit Storz Medical Nr. Inventari 19241	STORZ MEDICAL	Modulith SLX	OR.547	2009	8 - 28 - Shërbimi i Urologjise

**Specifikimet**

- **Specifikime të përgjithshme**
- Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.
- **Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar nga firma prodhuese, i cili do të kryejë shërbimet e instalimit.**
- **Specifikime të Veçanta**
- Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me aparaturën.
- Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.
- Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pas instalimit pajisja të lihet në gjëndje të plotë pune.

**Loti 64: Furnizim Vendosje Sonde Lineare për Eko prodhuesi Philips / ose ekuivalent, Modeli EnVisor CHD nr. inventari 30988**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Shërbimi
30988	Furnizim Vendosje Sonde Lineare për Eko prodhuesi Philips, Modeli EnVisor CHD nr. inventari 30988.	Philips	EnVisor CHD			4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise

**Specifikimet**

- **Specifikime të përgjithshme**

## Dokumentat standarde të tenderit

- Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.
- **Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar nga firma prodhuese, i cili do të kryejë shërbimet e instalimit.**
- **Specifikime të Veçanta**
- Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me aparaturën.
- Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.
- Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pas instalimit pajisja të lihet në gjëndje të plotë pune.

### **Loti 65: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko prodhuesi GE/ ose ekuivalent, Modeli VIVID E9 nr. inventari 21970**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Shërbimi
21970	Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko prodhuesi GE, Modeli VIVID E9 nr. inventari 21970.	GE	VIVID E9			19 -91 - Mjekesia Interne HTA

#### **Specifikimet**

- **Specifikime të përgjithshme**
- Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.
- **Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar nga firma prodhuese, i cili do të kryejë shërbimet e instalimit.**
- **Specifikime të Veçanta**
- Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me aparaturën.
- Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.
- Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pas instalimit pajisja të lihet në gjëndje të plotë pune.

### **Loti 66: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko Prodhuesi ESAOTE / ose ekuivalent, modeli MYLAB 50 XVISION me nr. inventari 19445**

## Dokumentat standarde të tenderit

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Shërbimi
19445	Furnizim Vendorsje Sonde Abdominale për Eko Prodhuesi ESAOTE, modeli MYLAB 50 XVISION me nr. inventari 19445	ESAOTE	MYLAB 50 XVISION			8 - 28 - Shërbimi i Urologjise

### Specifikimet

- **Specifikime të përgjithshme**
- Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.
- **Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar nga firma prodhuese, i cili do të kryejë shërbimet e instalimit.**
- **Specifikime të Veçanta**
- Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me aparaturën.
- Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.
- Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pas instalimit pajisja të lihet në gjëndje të plotë pune.

**Loti 67:Furnizim Vendorsje të motorit te ventilimit dhe bordit kryeso për incubator prodhuesi GE / ose ekuivalent, Modeli GIRAFFE INCUBATOR me nr. inventari 20953**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Shërbimi
20953	Furnizim Vendorsje te motorit te ventilimit dhe bordit kryeso për incubator prodhuesi GE, Modeli GIRAFFE INCUBATOR me nr. inventari 20953	GE	GIRAFFE			1	11 - 46 - Shërbimi i Pediatrie se Përgjithshme (Reanimacioni)

### Specifikimet

- **Specifikime të përgjithshme**
- Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.
- **Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar nga firma prodhuese, i cili do të kryejë shërbimet e instalimit.**
- **Specifikime të Veçanta**
- Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me aparaturën.

## Dokumentat standarde të tenderit

- Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.
- Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pas instalimit pajisja të lihet në gjëndje të plotë pune.

### **Loti 68:Furnizim Vendosje TouchScreen dhe Bateri për Defibrilatorin prodhuesi Philips / ose ekuivalent, modeli MRX me nr. inventari 21975**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Shërbimi
21975	Furnizim Vendosje TouchScreen dhe Bateri për Defibrilatorin prodhuesi Philips, modeli MRX me nr. inventari 21975	Philips	MRX			3 - 11 - Reanimacioni Kardiologjise

#### Specifikimet

- **Specifikime të përgjithshme**
- Operatori ekonomik duhet të zotërojë autorizimin e prodhuesit dhe ose distributor i prodhuesit për vitin 2018 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurt si dhe pjesë origjinale.
- **Të ketë të paktën një inxhinier të certifikuar nga firma prodhuese, i cili do të kryejë shërbimet e instalimit.**
- **Specifikime të Veçanta**
- Pjesët të jenë të reja të papërdorura dhe kompatibël me aparaturën.
- Pjesët të kenë certifikata CE për aprovim të standarteve, direktivave në tregun European.
- Pjesët mund të shoqërohen me manualin e vendosjes sipas rekomandimeve të prodhuesit.
- Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.
- Pas instalimit pajisja të lihet në gjëndje të plotë pune.

**Shtojca 10**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në marrëveshjen kuadër]

**PLANIFIKIMI I  
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

Shërbim:  
Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër

<b>Kontrata Nr.</b>	<b>Titulli i Kontratës</b>	<b>Përshkrim i shkurtër i kontratës</b>
<b>01</b>		
<b>02</b>		
<b>03</b>		
<b>...</b>		



Shtojca 11

**SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
20801	Analizator ACL	Analizator	IL INSTRUMENT LABORATORY	ACL 9000	4E+06		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik

**Loti 1: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike prodhuesi ACL 9000 / ose ekuivalent**

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 2: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike, prodhuesit ABX / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
20607	Analizat or Hematologjik	Analizator	ABX	Micros 60	409CT 75559		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik

## Dokumentat standarde të tenderit

19905	Analizat or Hematologjik	Analizator	ABX	Micros 60	409CT 75614		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik
-------	--------------------------	------------	-----	-----------	-------------	--	---	---------------------------------	--------------------------------------------------

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimin te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 3: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike prodhuesi BECKMAN COULTER / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19819	Analizat or Imunologjik	Analizator	BECKMAN COULTER	4700 Image	2479	2005	1	Spitali Patologjik ( 6kateshi)	Shërbimi i Lab. Imunologjik
19703	Citomet er Laser	CITOMET ER	BECKMAN COULTER	XL-MCL			1	Spitali Patologjik ( 6kateshi)	Shërbimi i Lab. Imunologjik

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimin te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

Public Health Sector

### Loti 4: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike te prodhuesi DPC (Siemens) / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
20786	Analizat or Imunologjik	Analizator	DPC (SIEMENS)	IMMULITE 1000	C0510		1	Spitali I Urgjencë Pranimi	Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik
20785	Analizat or Imunologjik	Analizator	DPC (SIEMENS)	IMMULITE 1000	C0509		1	Spitali I Urgjencë Pranimi	Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimin te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 5: Mirëmbajtje e pajisjeve të Anestezise prodhuesi DRAGER / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
11796	APARAT ANESTE ZIE	Aparat Anestezie	DRAGER	FABIUS PLUS	ASBL-0309	2012	1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
11729	APARAT ANESTE ZIE	Aparat Anestezie	DRAGER	FABIUS PLUS	ASBL-0308	2012	1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
19815	APARAT ANESTE ZIE	Aparat Anestezie	DRAGER	FABIUS PLUS	ASBL-0310	2012	1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
19948	APARAT ANESTE ZIE	Aparat Anestezie	DRAGER	FABIUS PLUS	ASCF-0027	2011	1	19 - Godina e Djegje Plastikes	19 - 77 - Shërbimi I Djegje Plastikës
19947	APARAT ANESTE ZIE	Aparat Anestezie	DRAGER	FABIUS PLUS	ASCF-0026	2011	1	19 - Godina e Djegje Plastikes	19 - 77 - Shërbimi I Djegje Plastikës
19735	APARAT ANESTE ZIE	Aparat Anestezie	DRAGER	FABIUS PLUS	USCA-0161	2011	1	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 27 - Shërbimi i Kirurgjise se Pergjithshme

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri në 31.12.2018

*(Duke qene se perllorartija e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimt te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 6: Mirëmbajtje e pajisjeve të anestezise prodhuesi MEDEC / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19839	APARAT ANESTE ZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	NEPTUNE	1E+06	2005	1	1 - Spitali Francez	1 - 1 - Shërbimi i ORL
19837	APARAT ANESTE ZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	NEPTUNE	1E+06	2005	1	1 - Spitali Francez	1 - 1 - Shërbimi i ORL
19838	APARAT ANESTE ZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	NEPTUNE	12-05439	2005	1	1 - Spitali Francez	1 - 1 - Shërbimi i ORL
19840	APARAT ANESTE ZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	NEPTUNE	18-05487	2005	1	1 - Spitali Francez	1 - 3 - Shërbimi i Okulistikes
19817	APARAT ANESTE ZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	NEPTUNE	1E+06		1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)

## Dokumentat standarde të tenderit

30948	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	NEPTUNE	12/28972		1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise
11640	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	NEPTUNE	12/27519		1	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 29 - Sherbimi i Kirurgjise Digjestive
12267	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	Saturn EVO	1E+08	1E+08	1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion
21107	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	Saturn EVO	1E+07		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	22 - 82 - Shërbimi I Urgjencës Kirurgjikale
19721	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	MEDEC	SATURN EVO	10/17163		1	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme
31289	APARAT NARKOZE	Aparat Anestezie	MEDEC	SATURN EVO	12-06572		1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise

### **Kohezgjatja e sherbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimin te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### **Loti 7: Mirëmbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi SIARE PERSEO / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
11657	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	SIARE PERSEO	VM2000	6E+06		1	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 28 - Sherbimi i Urologjise
19273	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	SIARE PERSEO	VM2000	6E+07		1	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 28 - Sherbimi i Urologjise
11758	APARAT ANESTEZIE	Aparat Anestezie	SIARE PERSEO	VM2000	6E+06		1	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 28 - Sherbimi i Urologjise

### **Kohezgjatja e sherbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimin te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### **Loti 8: Mirëmbajtje e pajisjeve te Dializes prodhuesi FRESENIUS / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19258	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	Fresenius	4008S	9VCARF 82	2010	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme

## Dokumentat standarde të tenderit

19257	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	Fresenius	4008S	9VCARF 81	2010	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme
19256	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	Fresenius	4008S	9VCARF 80	2010	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme
19255	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	Fresenius	4008S	9VCARF 84	2010	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme
19254	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	Fresenius	4008S	9VCARF 83	2010	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme
19246	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	FRESENIUS	4008S	5VCAY0 88	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
31327	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	FRESENIUS	4008S	5VCAY0 88	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
31326	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	FRESENIUS	4008S	5VCAY0 95	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19247	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	FRESENIUS	4008S	5VCAY0 85	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
31410	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	FRESENIUS	4008S	5VCAY0 92	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
31328	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	FRESENIUS	4008S	5VCAY0 84	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
31409	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	FRESENIUS	4008S	5VCAY0 90	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19242	Pajisje e Impiantit te ujit te dializes	Impiant Uji	Fresenius	Aqua B 1250		2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19251	Pajisje e Impiantit te ujit te dializes	Impiant Uji	Fresenius	Aqua B 500		2010	1	10 - Spitali Pediatrik	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise

### Public Health Sector

**Kohezgjatja e sherbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlloraritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 9: Mirëmbajtje e pajisjes te Dializes prodhuesi HOSPAL / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19824	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	790546	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19858	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	757058	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19827	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	791299	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19829	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	757867	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise

## Dokumentat standarde të tenderit

19857	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	759035	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19825	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	793885	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19862	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	756139	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19859	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	757708	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19861	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	757561	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19828	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	757870	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19830	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	791298	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
31323	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	757054	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19860	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	791300	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19831	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	793884	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise
19832	Aparat Dialize	APARAT DIALIZE	HOSPAL	INTEGRA	711301	2005	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise

### **Kohezgjatja e sherbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### **Loti 10: Mirëmbajtje e pajisjes EEG EMG te prodhuesi NIHON KOHDEN / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19570	Aparat ezhe elektroencefalogram	EEG	NIHON-KOHDEN	EEG-4419K	769	2001	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
19550	Elektromiograf (EMG)	EMG	NIHON-KOHDEN	MEB-9102K	24	2001	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
19551	EMG	EMG	NIHON-KOHDEN	MEB-9102K	23	2001	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji

### **Kohezgjatja e sherbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*



**Loti 11: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
31235	Aparat Grafie C-Arm	Grafi	GMM	MCA PRIME	65-12-04-08		1	10 - Spitali Pediatrik	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
20670	Sistem Radiografi	Grafi	GMM	CS15SL	1824RE V46	2009	1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë

**Loti 12: Mirëmbajtje e pajisjes Grafi prodhuesit Shimadzu / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19912	APARAT RONGENI PORTATIV	APARAT RONGENI	Shimadzu	MUX-10	0462P81 610	2009	1	12 - Spitali Infektiv	12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 13: Mirëmbajtje e pajisjes Fibrosan prodhuesi ECHOSENS / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19235	APARAT SKANIMI HEPATIK	FIBROSCAN	ECHOSENS	FIBROSCA N 502	FO 1372	2012	1	12 - Spitali Infektiv	12 - 50 - Shërbimi Infektiv

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 14: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator prodhuesi ACOMA / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
--------------	---------------	----------------	-----------	--------	-----------	----------------	------------	------------------	----------

## Dokumentat standarde të tenderit

20931	Respirator	Respirator	Acoma (Nakamura)	ICV-60	1059	2001	1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Peditrike
20995	RESPIRATOR	RESPIRATOR	Acoma (Nakamura)	ICV-60	325	2001	1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Peditrike

**Kohezgjatja e sherbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimet te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 15: Mirëmbajtje e pajisjes Aspirator Ultrasonic prodhuesi INTEGRA LifeSciences Corporation / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19431	Aspirator Ultrasonik	Aspirator Ultrasonik	INTEGRA LifeSciences Corporation	Dissectron	FCL1000 103		1	15 - Spitali Neurokirurgjise	Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion

**Kohezgjatja e sherbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimet te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 16: Mirëmbajtje e pajisjeve Aspirator prodhuesi MIZUHO / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19393	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514500	2001	1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Peditrike
19660	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	BSM-4101K	514499	2001	1	11 - Godina e Peditrise se vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Peditrise Infektive
19383	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514496	2001	1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Peditrike
20924	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514504	2001	1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Peditrike
19983	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514500	2001	1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Peditrike
20918	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514489	2001	1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Peditrike(Reanimacion)
20943	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514491	2001	1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Peditrike(Reanimacion)

## Dokumentat standarde të tenderit

20923	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514498	2001	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike(Reanimacion)
20917	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514507	2001	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike(Reanimacion)
19558	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514497	2001	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 40 - Sherbimi i Onkohematologjise Pediatrike
31065	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	511490	2001	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike
31061	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	5E+06	2001	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike
31071	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	5E+06	2001	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike
11532	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514486	2001	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
11530	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514494	2001	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
19577	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514509	2001	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19560	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514508	2001	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
31198	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514511	2001	1	10 - Spitali Pediatrik	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
31197	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514501	2001	1	10 - Spitali Pediatrik	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
31196	ASPIRATOR	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514506	2001	1	10 - Spitali Pediatrik	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
19637	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514468	2001	1	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19332	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514484	2001	1	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19333	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514495	2001	1	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19636	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514493	2001	1	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19674	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514510	2001	1	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Pediatrie Infektive
19792	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514487	2001	1	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Pediatrie Infektive
19388	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514492	2001	1	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Pediatrie Infektive
19348	Aspirator	Aspirator	MIZUHO	MSP-103B	514505	2001	1	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Pediatrie Infektive

## Dokumentat standarde të tenderit

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 17: Mirëmbajtje e pajisjeve Autoanalizator prodhuesi OLYMPUS / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19822	Autoanalizat or Kimik	Autoanalizat or	OLYMPUS	Au640		2005	1	Spitali I Urgjencë Pranimi	Labororit Klinik Biokimik
19821	Autoanalizat or Kimik	Autoanalizat or	OLYMPUS	Au640		2005	1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	Labororit Klinik Biokimik

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 18: Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
21488	C-Arm	C-Arm	Philips	BV Libra	119	2004	1	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 27 - Shërbimi i Kirurgjise se Pergjithshme
11635	C-ARM	C-Arm	PHILIPS	BV LIBRA	118	2004	1	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 29 - Shërbimi i Kirurgjise Digjестive
11676	C-ARM	C-Arm	PHILIPS	BV LIBRA	121	2004	1	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 28 - Shërbimi i Urologjise
19942	C-Arm portativ SISTEM	C-Arm	PHILIPS	BV LIBRA	120	2004	1	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 19: Mirëmbajtje e pajisjes CO2 Laser prodhuesi LUMENIS / ose

Dokumentat standarde të tenderit

**ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19864	CO2 Diode Laser	Laser	Lumenis	SA-1021190 AcuPulse 30	106	2012	1	1 - Spitali Francez	1 - 1 - Sherbimi i ORL

**Kohezgjatja e sherbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimt te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 20: Mirëmbajtje e disa pajisjeve te prodhuesi GE / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
21037	Ekokardiogra f	EKO	GE	VIVID S5	1428VS5	2010	1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	19 -91 - Mjekesia Interne HTA
20979	INKUBATOR	Inkubator	GE	GIRAFFE INCUBATOR	HDHR52 731	-	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
19262	Aparat Anestezie	Aparat Anestezie	GE	AESPIRE VIEW	APHR00 580		1	10 - Spitali Pediatrik	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike

**Kohezgjatja e sherbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimt te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 21: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
21981	Defibrilator	Defibrilator	NIHON-KOHDEN	CARDIOLINE TEC7721K	80548		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	19 -91 - Mjekesia Interne HTA
20958	DEFIBRIATOR	Defibrilator	NIHON-KOHDEN	CARDIOLIFE TEL-7521K	2930	2001	1	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme(Reanimacion)
31057	DEFIBRIATOR	Defibrilator	NIHON-KOHDEN	TEC-SS21K	87092		1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise
19723	DEFIBRIATOR	Defibrilator	NIHON-KOHDEN	TEC-7721K	80551		1	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme

## Dokumentat standarde të tenderit

31292	DEFRIBILATORI	Defibrilator	NIHON-KOHDEN	CARDIOLIFE ACTIBIPHASIC TEC 5521K	11467		1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise
11513	DEFRIBILATORI	Defibrilator	NIHON-KOHDEN	CARDIOLIFE TEC-7721K	80547		1	19 - Godina e Djegie Plastikes	19 - 77 - Shërbimi I Djegie Plastikës

### **Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### **Loti 22: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19747	Defibrilator	Defibrilator	PHILIPS	HEART START XL	US00448591		1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise
20096	Defibrilator	Defibrilator	PHILIPS	HEARTSTART MRX	US00559537		1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 10 - Reparti i Hemodinamikës
21471	Defibrilator	Defibrilator	PHILIPS	HEARTSTART MRX	US00559332		1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 10 - Reparti i Hemodinamikës

### **Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### **Loti 23: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi PHILIPS / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19940	ECHO	EKO	PHILIPS	HD7	CI54110197		1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 14 - Sherbimi i Gastrohepatologjise
19846	ECHO	EKO	PHILIPS	HDI 5000 SONO CT		2002	1	21 - Spitali I Urgjence Pranimi	19 -91 - Mjekesia Interne HTA
19843	ECHO	EKO	PHILIPS	HDI 5000 SONO CT	02BHW	2002	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 12 - Kardiologji I
31044	ECHO	EKO	PHILIPS	IMAGE POINT HX	US50203151	2001	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 11 - Reanimacioni Kardiologjise
19844	ECHO	EKO	PHILIPS	SONOS 4000	A46001149	2004	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	Sherbimi i Imazherise , Semundjet e brendshme



## Dokumentat standarde të tenderit

20215	ECHO DOPPLER	EKO	PHILIPS	HD7	SC 150080050		1	14 - Spitali Neurologjise	14 - 58 - Shërbimi I Neurologjisë
30988	ECHO KARDIAKE	EKO	PHILIPS	EnVisor C HD		2004	1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise
21739	EKO	EKO	PHILIPS	HDI 4000	A460001146	2004	1	9 - Spitali Petrit Selenica	9 - 32 - Shërbimi i Imazherisë

### **Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimt te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### **Loti 24: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi ESAOTE / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
20768	ECHO	EKO	ESAOTE	MEGAS GP 7251	1089		1	24 - Qendra e Konsultave	Kabineti i citologjise
30930	ECHO KARDIAKE	EKO	ESAOTE	7340	4314		1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise (salle, Reanimacion)

### **Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimt te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

Public Health Sector

### **Loti 25: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SIEMENS / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
21879	EKO ZEMRE KARDIAKE	EKO	SIEMENS	ACUSON SC 2000	400935		1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 11 - Shërbimi i Kardiokirurgjise II
20228	ECHO E PERGJITHS HME ( 3+1 SONDE)	EKO	SIEMENS	10348631 ACUSON X300	317447	2010	1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 64 - Reparti I Konsultave Neurokirurgjike
31051	Eko Kardiake	EKO	SIEMENS	ACUSON X300 PE	348958	2014	1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise
21784	EKO	EKO	SIEMENS	ACUSON X300	342739		1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 12 - Kardiologji I
21757	EKO	EKO	SIEMENS	ACUSON X 300	342760		1	24 - Qendra e Konsultave	24 - 1 - Qendra e Konsultave
31957	EKO	EKO	SIEMENS	ACUSON X300	1E+07	2015	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 11 - Reanimacioni Kardiologjise

## Dokumentat standarde të tenderit

### **Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### **Loti 26: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SAMSUNG MEDISON / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
20915	ECHO DOPPLER PORTATIVE	EKO	SAMSUNG MEDISON	SONOACE R3 SAR3-EXP-1P-00	SOH9M 3HCA00 00IT	-	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
19418	EKO	EKO	SAMSUNG MEDISON	SONOACE X8	B025083 0000455 6	2010	1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë
19946	EKO	EKO	SAMSUNG MEDISON	SONOACE X8	B025083 0000455 5	2011	1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë
19297	Eko	EKO	SAMSUNG MEDISON	Sonoace X8	B025083 0000455 4	-	1	24 - Qendra e Konsultave	Qendra e Konsultave
19209	EKO	EKO	SAMSUNG MEDISON	SONOACE X8 SAXC3H/WR	SOMLM 3HCA00 00IT		1	18 - Spitali Onkologjik	18 - 70 - Shërbimi Onkologjik
19932	EKO	EKO	SAMSUNG MEDISON	SONOACE X8SAX8EX -EXP-CW-20	SOMLM 3HCA00 002B		1	12 - Spitali Infektiv	12 - 50 - Shërbimi Infektiv
21885	EKO	EKO	SAMSUNG MEDISON	SONOACE 9900	A 6950330 0000452	2006	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 16 - Shërbimi i Nefrologjise

### **Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### **Loti 27: Mirëmbajtje e pajisje Imazherike prodhuesi TOSHIBA / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
21651	Tomografi	Tomografi	Toshiba	TS-TA-5A	D156252 9		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë
21660	Eko Doppler	EKO	Toshiba	Power vision 6000	A156281 7		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	21 - 84 - Shërbimi Imazherisë

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimin te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 28: Mirëmbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
31278	Ekstrakorporal	Ekstrakorporal	MAQUET	HL 20	9E+07	2014	1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimin te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 29: Mirëmbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi TERUMO / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
31278	Ekstrakorporal	Ekstrakorporal	MAQUET	HL 20	9E+07	2014	1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimin te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 30: Mirëmbajtje e pajisjeve Elektroforeze prodhuesi SEBIA / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
20877	Elektroforeze	Analizator	SEBIA	HYDRASY S	C0510		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 85 - Shërbimi I Labororit Klinik Biokimik
20821	Lexues	Analizator	SEBIA	Hyryst 2	846		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 85 - Shërbimi I Labororit Klinik Biokimik

## Dokumentat standarde të tenderit

### **Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### **Loti 31: Mirëmbajtje e pajisjes neuroendoskopike prodhuesi Aesculap / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
21465	Endoskop	Neuroendoskop	AESULAP	PV 890	1216		1	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion

### **Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### **Loti 32: Mirëmbajtje e pajisjes Endoskopike prodhuesi PENTAX / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19420	ENDOSKOP PORTATIV	Endoskop	PENTAX	FI-168S	G110843		1	12 - Spitali Infektiv	12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv

### **Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### **Loti 33: Mirëmbajtje e pajisjes FAKO prodhuesi ALCON / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
20149	FAKO	Fako	ALCON	INFINITI	1202711 301X		1	1 - Spitali Francez	1 - 3 - Shërbimi i Okulistikes

### **Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe*

## Dokumentat standarde të tenderit

*afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimt te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 34: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi CARL STORZ / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19435	Endoskopi	Endoskop	CARL STORZ	Calcutrip (AUTOCO N-11400)	KB01345	-	1	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 28 - Sherbimi i Urologjise
19239	KOLONA ENDOSKOPI SE	Kolona Endoskopise	CARL STORZ	Calcutript	27080	2006	1	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 28 - Sherbimi i Urologjise
19576	Fibro-Bronkoskop me burim drite	Fibro-Bronkoscopi	CARL STORZ	20045020	WX2882	2012	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
19234	VIDEO KOLONOSKOP	Endoskop	CARL STORZ	XENON 20132620	UX1843	2012	1	12 - Spitali Infektiv	12 - 50 - Shërbimi Infektiv
19265	Set Endoskopie (Burim Drite)	Endoscopi	CARL STORZ	XENON 100/20136220	NX1722		1	10 - Spitali Pediatrik	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
31218	Set Laparoscopi (Burim Drite)	Laparoscopi	CARL STORZ	XENON NOVA 300/20134020	PX 0679630		1	10 - Spitali Pediatrik	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike

#### **Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimt te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 35: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi OLYMPUS / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
30900	Fibroskopi	Fibroskopi	OLYMPUS	CV-100	11515		1	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 29 - Sherbimi i Kirurgjise Digjестive
11953	Sistem Laparoskopie (Burim Drite)	Sistem Laparoskopie	OLYMPUS	CLV-180	7E+06		1	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 29 - Sherbimi i Kirurgjise Digjестive

#### **Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimt te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 36: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILIPS / ose ekuivalent\**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
21489	Grafi Portative	Grafi	Philips	Practix 300	254	2004	1	8 - Kirurgjia e Pergjithshme	8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme
19763	Grafi Portative	Grafi Portative	Philips	Practix 160		2004	1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise(Reanimacion)

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 37: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi/Skopi te prodhuesi Philips / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19958	Grafi/Skopi	Grafi/Skopi	Philips	Duo Diagnost		2004	1	12 - Spitali Infektiv	Kabineti Grafi-Skopi
20219	Grafi/Skopi	Grafi/Skopi	Philips	Duo Diagnost		2004	1	14 - Spitali Neurologjise	14 - 58 - Shërbimi I Neurologjisë
20836	Grafi/Skopi	Grafi/Skopi	Philips	Duo Diagnost		2004	1	18 - Spitali Onkologjik	18 - 70 - Shërbimi Onkologjik
31434	Grafi/Skopi	Grafi/Skopi	Philips	Duo Diagnost		2004	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 9 - Sherbimi i Kardiokirurgjise I
21722	Grafi/Skopi	Grafi/Skopi	Philips	Duo Diagnost		2004	1	9 - Spitali Petrit Selenica	9 - 32 - Shërbimi i Imazherisë

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 38: Mirëmbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
--------------	---------------	----------------	-----------	--------	-----------	----------------	------------	------------------	----------



Dokumentat standarde të tenderit

19250	Hidroklave	Hidroklave	Hydrocllave	H-15	HSC-09121512	-	1	1 - Spitali Francez	1 - Spitali Francez
-------	------------	------------	-------------	------	--------------	---	---	---------------------	---------------------

**Loti 39: Mirëmbajtje e pajisjes intraaortik Ballon prodhuesit ARROW Teleflex / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19796	IABP (INTRAAORTIK BALLON POMP)	IABP (INTRAAORTIK BALLON POMP)	ARROW Teleflex	AUTOCAT II	60946V	2011	1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimt te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 40: Mirëmbajtje e pajisjeve Inhalator prodhuesi KOUSHIN INDUSTRIES / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
20926	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIES	COMFORT 2000 KU-400	106014	-	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike (Reanimacion)
20928	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIES	COMFORT 2000 KU-400	106013	-	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike (Reanimacion)
20925	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE	COMFORT 2000 KU-400	106018	-	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
20927	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE	COMFORT 2000 KU-400	106015	-	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
20987	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIE	COMFORT 2000 KU-400	106012	-	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
19390	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIES	COMFORT 2000 KU-400	106016	-	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 40 - Shërbimi i Onkohematologjise Pediatrike
20948	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIES	COMFORT 2000 KU-400	106017	-	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike(Reanimacion)
31060	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIES	COMFORT 2000 KU-400	106005	-	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 43 - Shërbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike
31075	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIES	COMFORT 2000 KU-400	106008	-	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 43 - Shërbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike

## Dokumentat standarde të tenderit

31073	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIES	COMFORT 2000 KU-400	106011		1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike
31064	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIES	COMFORT 2000 KU-400	106009		1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike
19541	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIES	COMFORT 2000 KU-400	106003		1	10 - Godina e Pediatrise se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme
30905	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIES	COMFORT 2000 KU-400	1E+06	-	1	10 - Spitali Pediatrik	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
19676	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIES	COMFORT 2000 KU-400	106002		1	11 - Godina e Pediatrise se vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive
19399	Inhalator (Nebulizatorr)	Inhalator	KOUSHIN INDUSTRIES	COMFORT 2000 KU-400	106001		1	11 - Godina e Pediatrise se vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive

**Kohezgjatja e sherbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 41: Mirëmbajtje e pajisjeve Inkubator prodhuesi NAKAMURA dhe ATOM / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A )	Vendodhja Godine	Shërbimi
20936	Inkubator A	Inkubator	Nakamura	H-1000	1522	-	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REANIMACIONI)
20952	Inkubator A	Inkubator	Nakamura	H-1000	1523	-	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REANIMACIONI)
20946	Inkubator B	Inkubator	ATOM MEDICAL	V-88	1E+06	2001	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REANIMACIONI)
19394	Inkubator Kirurgjikal	Inkubator	ATOM MEDICAL	V-850	10605	2001	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REANIMACIONI)
20963	Inkubator Kirurgjikal	Inkubator	ATOM MEDICAL	V-88	1E+06	2001	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REANIMACIONI)

**Kohezgjatja e sherbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 42: Mirëmbajtje e pajisjes Lithotripter prodhuesi STORZ MEDICAL / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A )	Vendodhja Godine	Shërbimi
--------------	---------------	----------------	-----------	--------	-----------	----------------	-------------	------------------	----------

## Dokumentat standarde të tenderit

19241	Lithotriptor	Lithotriptor	STROZ MEDICAL	Modulith SLX-F2	OR.547	2009	1	8 - Kirurgjia e Përgjithshme	8 - 28 - Shërbimi i Urologjisë
-------	--------------	--------------	---------------	-----------------	--------	------	---	------------------------------	--------------------------------

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 43: Mirëmbajtje e pajisjes MAMOGRAF prodhuesi IMS GIOTTO / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19853	Mamograf	Mamograf	IMS GIOTTO	6902	44397	2010	1	18 - Spitali Onkologjik	18 - 70 - Shërbimi Onkologjik

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 44: Mirëmbajtje e pajisjes Mikroskop, prodhuesi ZEISS / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19900	Mikroskop	Mikroskop	Zeiss	S7	1087-851	2005	1	1 - Spitali Francez	Salla operacioni

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 45: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19571	Monitor pacienti kardiak	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4101K	87		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Shërbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
19534	Monitor pacienti kardiak	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4101K	42		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	11 - 46 - Shërbimi i Pediatrie se Përgjithshme

Dokumentat standarde të tenderit

19580	Monitor pacienti kardiak	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4101K	86		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19775	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4113K	1629		1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion)
19753	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4113K	1628		1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion)
19775	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4113K	1726		1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion)
18773	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4113K			1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion)
19798	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-5105K	382		1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion)
20988	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4101K	19		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
20984	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4101K	93	-	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
20999	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4101K	88		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
20967	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4101K	23		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19622	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-4101K	0050AA		1	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19745	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-3763K	00675		1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion)
19766	Monitor pacienti	Monitor pacienti	NIHON-KOHDEN	BSM-3763K	00890		1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion)

**Kohezgjatja e sherbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)

**Loti 46: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti, prodhuesi DRAGER / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19809	MONITOR PACIENTI	MONITOR	DRAGER	INFINITY DELTA XL	6E+09	2010	1	15 - Spitali Neurokirurgjise	Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
19411	MONITOR PACIENTI	MONITOR	DRAGER	INFINITY DELTA XL	6E+09	2010	1	15 - Spitali Neurokirurgjise	Shërbimi Neurokirurgjise(Reanimacion)
19364	MONITOR PACIENTI	MONITOR	DRAGER	INFINITY DELTA XL	6E+09	2010	1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
19936	MONITOR PACIENTI	MONITOR	DRAGER	INFINITY DELTA XL	6E+09	-	1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)

## Dokumentat standarde të tenderit

19935	MONITOR PACIENTI	MONITOR	DRAGER	INFINITY DELTA XL	6E+09	-	1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion
19808	MONITOR PACIENTI	MONITOR	DRAGER	INFINITY DELTA XL	6E+09	-	1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimin te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 47: Mirëmbajtje e pajisjes Neuronavigator prodhuesi MEDTRONIC / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
11933	Neuronavigat or	Neuronavigat or	MEDTRONIC	STEALTH STATION S7	N00861129		1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimin te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 48: Mirëmbajtje e pajisjes EMG prodhuesi MICROMED / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
21690	NJESI QENDRORE EMG+PE	EMG	MIKROMED	MATRIX 1009	MX3-0016/02-08		1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 64 - Reparti I Konsultave Neurokirurgjike

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimin te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 49: Mirëmbajtje e pajisjes Body Box prodhuesi JAEGER / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
21530	PAJISJE PER MATJEN E RRUGEVE RESPIRATO	BODY BOX	JAEGER	MASTER SCREEN BODY	705425-08V00011	2010	1	12 - Spitali Infektiv	12 - 54 - Shërbimi I Alergologjisë

Dokumentat standarde të tenderit

	RE								
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimt te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 50: Mirëmbajtje e pajisjeve Pompa Infuzioni, prodhuesi NAKAMURA MEDICAL / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A )	Vendodhja Godine	Shërbimi
19542	Pompe infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	11 - 46 - Shërbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19557	Pompe infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	11 - 46 - Shërbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19543	Pompe infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	11 - 46 - Shërbimi i Pediatrie se Pergjithshme
20920	POMPE INFUSIONI	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06	-	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
20921	POMPE INFUSIONI	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06	-	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
20919	POMPE INFUSIONI	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06	-	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
20937	POMPE INFUSIONI	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06	-	1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
31077	POMPE INFUSIONI	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 43 - Shërbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike
31076	POMPE INFUSIONI	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 43 - Shërbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike
31078	POMPE INFUSIONI	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 43 - Shërbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike
19639	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06	-	1	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Shërbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19791	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
19367	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 39 - Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike
19323	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 40 - Shërbimi i Onkohematologjise Pediatrike
11533	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Shërbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji



## Dokumentat standarde të tenderit

11536	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
19538	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
11534	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
11538	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
11556	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
19641	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19343	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19645	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19423	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme
19331	Pompe Infuzioni	Pompe	NAKAMURA MEDICAL	FP-960	1E+06		1	11 - Godina e Pediatrie se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme

**Kohezgjatja e sherbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlloraritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 51: Mirëmbajtje e pajisjes C-Arm te prodhuesit SIEMENS / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
21449	Radioskopi Portative (C-Arm)	C-Arm	SIEMENS	ARCADIS ORBIC, 10143407	22354	2011	1	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion

**Kohezgjatja e sherbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlloraritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 52: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesit DRAGER / ose ekuivalent

Dokumentat standarde të tenderit

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19349	Respirator	Respirator	DRAGER	EVITA XL	ASBL-0350		1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
19270	Respirator	Respirator	DRAGER	EVITA XL	ASBL-0353		1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
19272	Respirator	Respirator	DRAGER	EVITA XL	ASBL-0351	2010	1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
21682	Respirator	Respirator	DRAGER	EVITA XL	ASBL - 0352		1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
19777	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	ASCD-0076		1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
19760	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	ASCD-0085	2011	1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)
21157	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	ASCD-0072		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm
21158	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	ASCD-0078		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm
21371	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	ASCD-0077		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm
21189	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	ASCD-0074		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm
19794	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	8414000-07		1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise( Reanimacion)
19788	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	8414000-07ARRD-0035		1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise( Reanimacion)
30991	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	8414000-07		1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Shërbimi i Kardiokirurgjise( Reanimacion)
19949	Respirator	Respirator	DRAGER	SAVINA	ASCE-0131		1	19 - Godina e Djegie Plastikes	19 - 77 - Shërbimi I Djegie Plastikës

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimt te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 53: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesi NEWPORT / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
20986	Respirator	RESPIRATOR	NEW PORT	eE360e	N11360117607	-	1	10 - Godina e Pediatrise se Re	Shërbimi i Kirurgjise Pediatrike

## Dokumentat standarde të tenderit

20965	Respirator	RESPIRATOR	NEW PORT	eE360e	M11360 117608	-	1	Godina e Pediatrie se Re	1Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
19762	Respirator	RESPIRATOR	NEW PORT	e360	6E+09		1	4 - Kardiokirurgjia	Sherbimi i Kardiokirurgjise
19774	Respirator	RESPIRATOR	NEW PORT	e360	6E+09		1	4 - Kardiokirurgjia	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise

### **Kohezgjatja e sherbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimt te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### **Loti 54: Mirëmbajtje e pajisjeve respirator te prodhuesit VIASYS Healthcare / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
19203	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA COMPREHENSIVE 16532-02	AKT04125		1	12 - Spitali Infektiv	12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv
19509	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA COMPREHENSIVE 16532-02	AKT04151		1	12 - Spitali Infektiv	12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv
19986	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA COMPREHENSIVE 16532-02	AKT04202		1	12 - Spitali Infektiv	12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv
19929	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA COMPREHENSIVE 16532-02	AKT04202		1	12 - Spitali Infektiv	12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv
19204	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA COMPREHENSIVE 16532-02	AKT04215		1	12 - Spitali Infektiv	12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv
19299	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA COMPREHENSIVE 16532-02	AKT004218		1	12 - Spitali Infektiv	12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv
19211	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA 16532-02	BAT 02053		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm
19215	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA 16532-02	BAT 02052		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm
19212	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA 16532-02	BAT 01916		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm
19214	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA 16532-02	BAT 02016		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm
21193	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA 16532-02	BAT 02034		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm
19218	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA 16532-02	BAT 02040		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Përgjithshëm

## Dokumentat standarde të tenderit

21173	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA 16532-02	BAT01970		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm
19217	Respirator	RESPIRATOR	VIASYS HEALTHCARE	VELA 16532-02	BAT 02029		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 55: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre prodhuesi AESCULAP / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
11705	Sharre	Sharre	AESCULAP	Microspeed Uni	4245		1	15 - Spitali Neurokirurgjise	15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion)

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 56: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre Oshilante prodhuesi DE SOUTER / ose ekuivalent

Public Health Sector

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
31059	SHARRE OSHILANTE	SHARRE	DE SOUTER	DBR-700	14/00519	2014	1	4 - Kardiokirurgjia	Shërbimi i Kardiokirurgjise(Salle Operacioni)

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### Loti 57: Mirëmbajtje e Shiringave Elektrike prodhuesi ATOM MEDICAL / ose ekuivalent

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
--------------	---------------	----------------	-----------	--------	-----------	----------------	------------	------------------	----------

## Dokumentat standarde të tenderit

19621	Shiringe elektrike	Shiringa Elektrike	ATOM MEDICAL	SP8800	OD13C0 123		1	11 - Godina e Peditrise se vjeter	11 - 46 - Sherbimi i Peditrise se Pergiithshme
20993	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
20980	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
20989	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+07		1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
11531	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
11560	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
11559	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
20992	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
20971	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Peditrike
19338	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 40 - Sherbimi i Onkohematologjise Peditrike
31444	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		1	10 - Godina e Peditrise se Vjeter	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
31412	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		1	10 - Godina e Peditrise se Vjeter	10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endo krinologji
19386	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		1	10 - Godina e Peditrise se Vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Peditrise Infektive
19387	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		1	10 - Godina e Peditrise se Vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Peditrise Infektive
31176	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		1	10 - Godina e Peditrise se Vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Peditrise Infektive
19665	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	1235N	1E+06		1	10 - Godina e Peditrise se Vjeter	11 - 48 - Sherbimi i Peditrise Infektive
21920	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	SP8800	OD1080 011		1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 40 - Sherbimi i Onkohematologjise Peditrike
21639	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	SP8800	OD10B0 036		1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 40 - Sherbimi i Onkohematologjise Peditrike
19545	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	SP8800	OD10A0 113		1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 40 - Sherbimi i Onkohematologjise Peditrike
21638	Shiringe elektrike	Shiringe Elektrike	ATOM MEDICAL	SP8800	OD10B0 005		1	10 - Godina e Peditrise se Re	10 - 40 - Sherbimi i Onkohematologjise Peditrike

**Kohezgjatja e sherbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlloragjitja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 58: Mirëmbajtje e monitoreve dhe sistemit te monitorimit te pacientit prodhuesi Philips / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
	Sistem Monitorim pacienti (Server + 19 Monitor pacienti)	Sistem	Philips	UT4800 (Monitor pacienti G60)		2012	1	4 - Kardiokirurgjia	Reanimacioni Kardiologjise

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 59: Mirëmbajtje e pajisjes Spirometer prodhuesi CHEST / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
31067	SPIROMETE R	SPIROMETE R	CHEST	CHEST GRAPH	1E+06		1	10 - Godina e Pediatrie se Re	Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

**Loti 60: Mirëmbajtje e pajisjes TREADMILL prodhuesit CARDIOLINE / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
21800	TREADMILL	TREADMILL	CARDIOLINE	CC XR 600	6E+06		1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	3 - 10 - Reparti i Hemodinamikës
31507	TREADMILL	TREADMILL	CARDIOLINE	XR600M	631200		1	24 - Qendra e Konsultave	24 - 1 - Qendra e Konsultave
21958	TreadMill	TreadMill	CARDIOLINE	CXR 600	KEY037 58		1	21 - Spitali I Urgjencë Pranimi	19 -91 - Mjekesia Interne HTA

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*



*te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### **Loti 61: Mirëmbajtje e pajisjes endoskopike prodhuesi FUJINON / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
21916	Unit Endoskopie	Endoskop	FUJINON	NDS	1E+07	-	1	3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi)	Sherbimi i Gastrohepatologjise

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimin te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### **Loti 62: Mirëmbajtje e pajisjes video EEG prodhuesi Viasys Healthcare / ose ekuivalent**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Lloji Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Vendodhja Godine	Shërbimi
20192	VIDEO EEG	EEG	VIASYS HEALTHCARE	NIKOLET ONE			1	14 - Spitali Neurologjise	14 - Spitali Neurologjise Pavion

**Kohezgjatja e shërbimit:** nga data 16.05.2018 deri ne 31.12.2018

*(Duke qene se perlllogaritja e fondit limit per kete lot eshte bere nga data 16.05.2018 – 31.12.2018 (230 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 16.05.2018, vlera e mirembajtjes perpara nenshkrimin te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per pajisjet)*

### **Loti 63: Furnizim vendosje e kokes goditese e litotripterit Storz Medical / ose ekuivalent**

**Nr. Inventari 19241**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Shërbimi
19241	Furnizim vendosje e kokes goditese e litotripterit Storz Medical Nr. Inventari 19241	STORZ MEDICAL	Modulith SLX	OR.547	2009	1	8 - 28 - Sherbimi i Urologjise

**Kohezgjatja e shërbimit:** furnizim-vendosja do te kryhet brenda 30 dite nga nenshkrimi i kontrates

**Loti 64: Furnizim Vendosje Sonde Lineare për Eko prodhuesi Philips / ose ekuivalent, Modeli EnVisor CHD nr. inventari 30988**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Shërbimi
30988	Furnizim Vendosje Sonde Lineare për Eko prodhuesi Philips, Modeli EnVisor CHD nr. inventari 30988.	Philips	EnVisor CHD			1	4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise

**Kohezgjatja e shërbimit:** furnizim-vendosja do te kryhet brenda 30 dite nga nenshkrimi i kontrates

**Loti 65: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko prodhuesi GE/ ose ekuivalent, Modeli VIVID E9 nr. inventari 21970**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Shërbimi
21970	Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko prodhuesi GE, Modeli VIVID E9 nr. inventari 21970.	GE	VIVID E9			1	19 - 91 - Mjekesia Interne HTA

**Kohezgjatja e shërbimit:** furnizim-vendosja do te kryhet brenda 30 dite nga nenshkrimi i kontrates

**Loti 66: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko Prodhuessi ESAOTE / ose ekuivalent, modeli MYLAB 50 XVISION me nr. inventari 19445**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Shërbimi
19445	Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko Prodhuessi ESAOTE, modeli MYLAB 50 XVISION me nr. inventari 19445	ESAOTE	MYLAB 50 XVISION			1	8 - 28 - Sherbimi i Urologjise

**Kohezgjatja e shërbimit:** furnizim-vendosja do te kryhet brenda 30 dite nga nenshkrimi i kontrates

**Loti 67: Furnizim Vendosje të motorit te ventilimit dhe bordit kryeso për incubator prodhuessi GE / ose ekuivalent, Modeli GIRAFFE INCUBATOR me nr. inventari 20953**

Dokumentat standarde të tenderit

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Shërbimi
20953	Furnizim Vendorsje te motorit te ventilimit dhe bordit kryeso për incubator prodhuesi GE, Modeli GIRAFFE INCUBATOR me nr. inventari 20953	GE	GIRAFFE			1	11 - 46 - Shërbimi i Pediatrie se Pergjithshme (Reanimacioni)

**Kohezgjatja e shërbimit:** furnizim-vendosja do te kryhet brenda 30 dite nga nenshkrimi i kontrates

**Loti 68:Furnizim Vendorsje TouchScreen dhe Bateri për Defibrilatorin prodhuesi Philips / ose ekuivalent, modeli MRX me nr. inventari 21975**

Nr Inventari	Emri Pajisjes	Prodhuesi	Modeli	Nr Serise	Viti Prodhimit	Sasia ( A)	Shërbimi
21975	Furnizim Vendorsje TouchScreen dhe Bateri për Defibrilatorin prodhuesi Philips, modeli MRX me nr. inventari 21975	Philips	MRX			1	3 - 11 - Reanimacioni Kardiologjise

**Kohezgjatja e shërbimit:** furnizim-vendosja do te kryhet brenda 30 dite nga nenshkrimi i kontrates.



## Shtojca 12

**TERMAT E REFERENCËS**

**Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2018” e ndare ne lote si më poshtë:**

Nr	Lotet	Vlera pa TVSH
1	Loti 1: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike prodhuesi ACL 9000/ ose ekuivalent	565.818,40
2	Loti 2: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike, prodhuesit ABX/ ose ekuivalent	569.516,80
3	Loti 3: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike prodhuesi BECKMAN COULTER/ ose ekuivalent	2.100.665,90
4	Loti 4: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike te prodhuesi DPC (Siemens)/ ose ekuivalent	909.889,20
5	Loti 5: Mirëmbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi DRAGER/ ose ekuivalent	2.103.299,40
6	Loti 6: Mirëmbajtje e pajisjeve te anestezise prodhuesi MEDEC/ ose ekuivalent	3.072.687,30
7	Loti 7: Mirëmbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi SIARE PERSEO/ ose ekuivalent	1.840.002,30
8	Loti 8: Mirëmbajtje e pajisjeve te Dializes prodhuesi FRESENIUS/ ose ekuivalent	4.267.314,20
9	Loti 9: Mirëmbajtje e pajisjes te Dializes prodhuesi HOSPAL/ ose ekuivalent	5.088.543,00
10	Loti 10: Mirëmbajtje e pajisjes EEG EMG te prodhuesi NIHON KOHDEN/ ose ekuivalent	788.111,10
11	Loti 11: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM/ ose ekuivalent	2.791.546,80
12	Loti 12: Mirëmbajtje e pajisjes Grafi prodhuesit Shimadzu/ ose ekuivalent	418.600,00
13	Loti 13: Mirëmbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSSENS/ ose ekuivalent	1.381.759,50
14	Loti 14: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator prodhuesi ACOMA/ ose ekuivalent	559.668,20
15	Loti 15: Mirëmbajtje e pajisjes Aspirator Ultrasonic prodhuesi INTEGRA LifeSciences Corporation/ ose ekuivalent	1.497.914,10
16	Loti 16: Mirëmbajtje e pajisjeve Aspirator prodhuesi MIZUHO/ ose ekuivalent	428.582,00
17	Loti 17: Mirëmbajtje e pajisjeve Autoanalizator prodhuesi OLYMPUS/ ose ekuivalent	1.595.914,80
18	Loti 18: Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	1.402.530,80
19	Loti 19: Mirëmbajtje e pajisjes CO2 Laser prodhuesi LUMENIS/ ose ekuivalent	592.344,30
20	Loti 20: Mirëmbajtje e disa pajisjeve te prodhuesi GE/ ose ekuivalent	1.199.645,50
21	Loti 21: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ ose ekuivalent	453.744,00
22	Loti 22: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	786.682,80
23	Loti 23: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	6.100.165,80
24	Loti 24: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi ESAOTE/ ose ekuivalent	832.022,70
25	Loti 25: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SIEMENS/ ose ekuivalent	2.523.960,20
26	Loti 26: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SAMSUNG MEDISON/ ose ekuivalent	2.747.428,20
27	Loti 27: Mirëmbajtje e pajisje Imazherike prodhuesi TOSHIBA/ ose ekuivalent	3.158.668,20
28	Loti 28: Mirëmbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET/ ose ekuivalent	1.045.626,00
29	Loti 29: Mirëmbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi TERUMO/ ose ekuivalent	1.346.668,40
30	Loti 30: Mirëmbajtje e pajisjeve Elektroforeze prodhuesi SEBIA/ ose ekuivalent	694.928,90
31	Loti 31: Mirëmbajtje e pajisjes neuroendoskopike prodhuesi Aesculap/ ose ekuivalent	1.484.196,90
32	Loti 32: Mirëmbajtje e pajisjes Endoskopike prodhuesi PENTAX/ ose ekuivalent	121.334,20
33	Loti 33: Mirëmbajtje e pajisjes FAKO prodhuesi ALCON/ ose ekuivalent	1.014.263,20
34	Loti 34: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi CARL STORZ/ ose ekuivalent	7.353.967,10
35	Loti 35: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi OLYMPUS/ ose ekuivalent	1.402.195,00
36	Loti 36: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent	798.895,80
37	Loti 37: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi/Skopi te prodhuesi Philips/ ose ekuivalent	6.512.289,00
38	Loti 38: Mirëmbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave/ ose ekuivalent	1.394.830,40

## Dokumentat standarde të tenderit

39	Loti 39: Mirëmbajtje e pajisjes intraaortik Ballon prodhuesit ARROË Teleflës/ ose ekuivalent	385.604,20
40	Loti 40: Mirëmbajtje e pajisjeve Inhalator prodhuesi KOUSHIN INDUSTRIES/ ose ekuivalent	604.750,50
41	Loti 41: Mirëmbajtje e pajisjeve Inkubator prodhuesi NAKAMURA dhe ATOM/ ose ekuivalent	843.329,50
42	Loti 42: Mirëmbajtje e pajisjes Lithotripter prodhuesi STORZ MEDICAL/ ose ekuivalent	3.277.060,70
43	Loti 43: Mirëmbajtje e pajisjes MAMOGRAF prodhuesi IMS GIOTTO/ ose ekuivalent	3.090.447,90
44	Loti 44: Mirëmbajtje e pajisjes Mikroskop, prodhuesi ZEISS/ ose ekuivalent	1.686.665,90
45	Loti 45: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden/ ose ekuivalent	1.154.519,50
46	Loti 46: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti, prodhuesi DRAGER/ ose ekuivalent	560.873,40
47	Loti 47: Mirëmbajtje e pajisjes Neuronavigator prodhuesi MEDTRONIC/ ose ekuivalent	3.847.118,00
48	Loti 48: Mirëmbajtje e pajisjes EMG prodhuesi MICROMED/ ose ekuivalent	511.492,40
49	Loti 49: Mirëmbajtje e pajisjes Body Box prodhuesi JAEGER/ ose ekuivalent	537.947,00
50	Loti 50: Mirëmbajtje e pajisjeve Pompa Infuzioni, prodhuesi NAKAMURA MEDICAL/ ose ekuivalent	439.415,00
51	Loti 51: Mirëmbajtje e pajisjes C-Arm te prodhuesit SIEMENS/ ose ekuivalent	1.149.802,20
52	Loti 52: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesit DRAGER/ ose ekuivalent	3.234.393,40
53	Loti 53: Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesi NEWPORT/ ose ekuivalent	1.298.120,00
54	Loti 54: Mirëmbajtje e pajisjeve respirator te prodhuesit VIASYS Healthcare/ ose ekuivalent	4.291.294,00
55	Loti 55: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre prodhuesi AESCULAP/ ose ekuivalent	989.466,90
56	Loti 56: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre Oshilante prodhuesi DE SOUTER/ ose ekuivalent	153.334,10
57	Loti 57: Mirëmbajtje e Shiringave Elektrike prodhuesi ATOM MEDICAL/ ose ekuivalent	2.099.083,50
58	Loti 58: Mirëmbajtje e monitoreve dhe sistemit te monitorimit te pacientit prodhuesi Philips/ ose ekuivalent	5.356.654,00
59	Loti 59: Mirëmbajtje e pajisjes Spirometer prodhuesi CHEST/ ose ekuivalent	260.665,90
60	Loti 60: Mirëmbajtje e pajisjes TREADMILL prodhuesit CARDIOLINE/ ose ekuivalent	806.906,70
61	Loti 61: Mirëmbajtje e pajisjes endoskopike prodhuesi FUJINON/ ose ekuivalent	1.181.919,40
62	Loti 62: Mirëmbajtje e pajisjes video EEG prodhuesi Viasys Healthcare/ ose ekuivalent	438.150,00
63	Loti 63: Furnizim vendosje e kokes goditese e litotripterit Modulith SLX-F2/ ose ekuivalent Nr. Inventari 19241	2.870.000,00
64	Loti 64: Furnizim Vendosje Sonde Lineare për Eko prodhuesi Philips/ ose ekuivalent, Modeli EnVisor CHD nr. inventari 30988.	850.000,00
65	Loti 65: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko prodhuesi GE/ ose ekuivalent, Modeli VIVID E9 nr. inventari 21970.	1.000.000,00
66	Loti 66: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko Prodhuesi ESAOTE/ ose ekuivalent, modeli MYLAB 50 XVISION me nr. inventari 19445	425.000,00
67	Loti 67: Furnizim Vendosje te motorit te ventilimit dhe bordit kryeso për incubator prodhuesi GE/ ose ekuivalent, Modeli GIRAFFE INCUBATOR me nr. inventari 20953	400.000,00
68	Loti 68: Furnizim Vendosje TouchScreen dhe Bateri për Defibrilatorin prodhuesi Philips/ ose ekuivalent, modeli MRX me nr. inventari 21975	297.000,00

**Detyrat:** Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike.

**Shpërndarja:** Ne godinat e QSUT “Nene Tereza”: ne te gjitha shërbimet ku ndodhen pajisjet mjekesore te cilat jane percaktuar ne tabelat ne shtojcen 11

**Vendi i kryerjes së shërbimeve:** Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”Tiranë.  
**Shtojca 13**

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR<sup>1</sup>**

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” .

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme :

Public Health Sector

---

---

---

---

---

---

---

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt  
< Emri >



## Shtojca 14

[ Shtojcë për t'u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data \_\_\_\_\_]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

---

---

---

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të

## Dokumentat standarde të tenderit

*shpallur fitues*] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej *[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*/pikët totale të marra *[\_\_\_\_\_]* është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_



**[Titullari i autoritetit kontraktor]**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM  
NË MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_

*(me numra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_

*(me numra dhe fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

2. \_\_\_\_\_

Dokumentat standarde të tenderit

Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

---

---

---

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera \_\_\_\_\_ / Pikët totale të marra \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_


Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera \_\_\_\_\_ / Pikët totale të marra \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

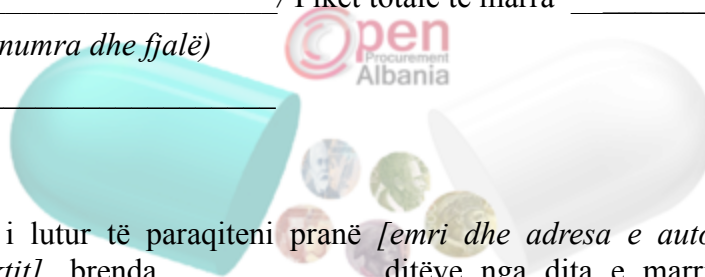

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

## **KUSHTET E PËRGJITHSHME TE KONTRATES** **Shërbimet – Procedura e Hapur**

### **Neni 1 Qëllimi**

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Shërbimeve të prokuruar me anë të procedurës së hapur.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.

Kushtet e kontratës, përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

### **Neni 2 Përkufizime**

- 2.1 “Kontratë” do të thotë marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe Kontraktuesit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjijtjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.4 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen shërbimin. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet.

- 2.7 “Shërbime” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës.
- 2.8 “Termet e References” shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

### **Neni 3 Hartimi i Kontratës**

- 3.1 Shpallja e fituesit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke materializuar të gjitha marrëveshjet midis palëve.

### **Neni 4 Praktikak Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve**

- 4.1 Autortiteti Kontraktues mund t’i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit për Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose njësi që ka marrë pjesë në pregatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe procesverbalet që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues.

### **Neni 5 Informacioni Konfidencial**

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t’i japë nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nën-kontraktuesin në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premtion ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

### **Neni 6 Prona Intelektuale**

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t’i përkasin Autoritetit Kontraktues i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjatë



kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

- 6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoriteti Kontraktues të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

## **Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit**

- 7.1 Kontraktuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithsi.
- 7.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.
- 7.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesi dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
- 7.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetences së tij në përfaqsimin e Autoritetit Kontraktues.

## **Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit**

- 8.1 Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References.
- 8.2 Kontraktuesi duhet t'i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.
- 8.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

## **Neni 9 Specifikime dhe Skicime**

- 9.1 Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të pregatisi të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithsi të

pranueshme për Autoritetet Kontraktues dhe të marri parasysh standartet më të fundit.

- 9.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjëse përsa i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

#### **Neni 10 Lejet dhe Liçensat**

- 10.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit kur palet bien dakord ndryshe.

#### **Neni 11 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor**

- 11.1 Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në oferten e Kontraktuesit.
- 11.2 Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.
- 11.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.
- 11.4 Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Autoriteti Kontraktues.

Public Health Sector

#### **Neni 12 Vendndodhja**

- 12.1 Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuar në kontratë.
- 12.2 Në se nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë vendin ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet në mënyrë të paarsyeshme.

#### **Neni 13 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale**

- 13.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 13.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

#### **Neni 14 Çmimi i Kontratës**

- 14.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues.

#### **Neni 15 Afatet e Pagesës**

- 15.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 15.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim.
- 15.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan shërbimet e kryera për të cilat duhet paguar.
- 15.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë kryer Shërbimet, dorëzimi është paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë.
- 15.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet debitohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

#### **Neni 16 Vonesa në Bërjen e Pagesës**

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

#### **Neni 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve**

- 17.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës..

#### **Neni 18 Forca Madhore**

- 18.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontrates, dëmet e likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i ndodhjes së Forcës Madhore.
- 18.2 Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje e paparashikueshme jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të

përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

- 18.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

#### **Neni 19 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit**

- 19.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 19.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates.
- 19.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t'i japi kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 19.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 19.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të përfundimit të Shërbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

#### **Neni 20 Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar**

- 20.1 Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore:
- Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.
  - Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates..
  - Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates...

## **Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet**

- 21.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.
- 21.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, t'i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.
- 21.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

## **Neni 22 Ndryshimi i Porosisë**

- 22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

## **Neni 23 Ndërprerja për Mosplotësim**

- 23.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
  - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

## **Neni 24 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit**

- 24.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

## **Neni 25 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

- 25.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.
- 25.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e

pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

## **Neni 26 Nënkontrata**

- 26.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë
- 26.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nënkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 26.3 Cdo nenkontraktor duhet të ketë të drejte të marre pjese në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për shërbimet që do të furnizojë.
- 26.4 Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizojë një pjesë të punimeve me nën-kontraktues, duhet të paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e kërkuar për nenkontraktuesin si dhe punimet konkrete që do të japë me nensipermarrje.
- 26.5 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e nenkontraktorit.

## **Neni 27 Transferimi i të Drejtave**

- 31.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

## **Neni 28 Sigurimi i Kontrates**

- 28.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar.
- 28.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 28.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes së Shërbimeve.

## **Neni 29 Baza Ligjore**

- 29.1 Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.



### **Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve**

- 30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.
- 30.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

### **Neni 31 Përfaqësimi i Palëve**

- 31.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.
- 31.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 31.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

### **Neni 32 Lajmërimet**

- 32.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 32.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

### **Neni 33 Llogaritja e Afateve**

- 33.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

## Shtojca 17

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### **KUSHTET E VEÇANTA** **Shërbimet – Procedura e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

#### **Neni 1 Përkufizime**

1.1 Autoriteti Kontraktor është \_\_\_\_\_

1.2 Kontraktuesi është \_\_\_\_\_

#### **Neni 2 Sigurimi i kontratës**

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej 10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 3 Fillimi i Kontratës**

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

#### **Neni 4 Vendndodhja e Shërbimeve**

4.1 Shërbimet do të kryhen në: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 5 Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor**

5.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

**Neni 6 Kërkesat e Raportimit**

6.1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin Kontraktor sipas formularit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_

**Neni 7 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale**

7.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon: \_\_\_\_\_

**Neni 8 Kushtet e Pagesës**

8.1 Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_

8.2 Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e arritjes së marrveshjes për pagesën ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë cilado që të jetë më vonë. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

8.3 Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

**Neni 9 Pagesa Paraprake**

9.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse është lënë e paplotësuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

9.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit të kontrates.

9.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: \_\_\_\_\_

---

**Neni 10 Zbritja e garancisë së kontratës**

10.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

---

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

**Shtojca 18**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR**

**Seksioni I Autoriteti Kontraktor**

**I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Adresa në Internet \_\_\_\_\_

**I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:**



**Seksioni 2 Objekti i Kontratës**

**Public Health Sector**

**2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit** \_\_\_\_\_

**2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”**

Konkurs Projektimi      Shërbime Konsulence      Shërbime të tjera

**2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuader**

Po      Jo

**Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër**

**Me 1 Operator Ekonomik**

**Me disa operatorë ekonomikë**

**Të gjitha kushtet janë të përcaktuara**

Po

Jo

**2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës**

1. Fondi limit \_\_\_\_\_

2. Burimi i Financimit \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

**2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:**

Kohëzgjatja në muaj ose ditë \_\_\_\_\_

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

**2.6 Ndarja në LOTE:**

Po

Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:



**2.7 Opsionet:**

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

**2.8 Kontrate me nenkontraktim:**

Po

Jo

**Seksioni 3 Procedura**

**3.1 Lloji i procedurës:**

E hapur

**3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë

etj. pikë

**3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:**

Numri i ofertave të rregullta:

**3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po Jo

**3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit**

Po Jo

Public Health Sector

**Seksioni 4 Informacion mbi kontratën**

**4.1 Numri i Kontratës: \_\_\_\_\_ Data e Kontratës //**

**4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Adresa e Internetit \_\_\_\_\_

**4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve**

Emri \_\_\_\_\_



## Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

### 4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_  
Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

#### 4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_  
Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

### 4.4 Informacione shtesë

\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //



## Shtojca 19

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

### 1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja në Internet \_\_\_\_\_

2. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

4. Numri i referencës së procedurës/lotit \_\_\_\_\_

5. Fondi limit \_\_\_\_\_

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit):

Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

Vlera e nenkontraktimit \_\_\_\_\_ me Tvsh Monedha \_\_\_\_\_

7. Data e lidhjes së kontratës \_\_\_\_\_

### 8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontraktorit

Emri \_\_\_\_\_

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa \_\_\_\_\_

Nr. NIPT \_\_\_\_\_

### Shtojca 20

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Ne Emer te: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës ]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin e plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

## Shtojca 21

### FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

*Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor*

#### Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

## Seksioni II. Informacion për Procedurën

### 1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

### 2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

### 3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

### 4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.



### 5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

### 6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

## Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

### 1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkëlqen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

## 2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.*

## 3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj** . Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*


Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet t'i referoheni Formularit të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

**Nr. Faks:**

**E-mail:**

**Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit**



**Shtojca 22**



**DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR**  
( KU TE GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)  
**PER PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr \_\_

**DATA:**

Kjo kontratë lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formulari i Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formulari i çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

**Neni 1   Objekti**

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuar dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

---

**Neni 2 Çmimi**

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njësisive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

**Nënshkrimet dhe Datat**

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

Public Health Sector

## Shtojca 23

### **DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR ( KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

**Emri i Autoritetit Kontraktor,**

Dhe

**Emri i Kontraktuesit**

Bien dakord si vijon:

**Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin:** < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

#### **Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

#### **Neni 2 Detyrimet e Palëve**

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Ofertë" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

#### **Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër**

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

#### **Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës**

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- 4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.
- 4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

### Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

---

#### Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
<b>Emri :</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

Public Health Sector

---

**Shtojca 24**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja në Internet \_\_\_\_\_

**1. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**2. Numri i Referencës:** \_\_\_\_\_

**3. Objekti i kontratës** \_\_\_\_\_

**4. Fondi limit** \_\_\_\_\_

**5. Arsytet e Anulimit:**

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar, neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

**Etj.** \_\_\_\_\_

**6. Informacione shtesë**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi \_