



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës

Specifikime teknike shoqëruar me ilustrime përkatëse për pajisjet e listuara si vijon:

Nr.	Emërtimi	Njësia	Sasia
1	Shtrat pacienti	copë	177
2	Komodinë pacienti	copë	177
3	Shtrat reanimacioni	copë	7
4	Shtrat vizite	copë	14
5	Tavolina pune me komodinë	copë	30
6	Karrike të thjeshta	copë	50
7	Dollap pacienti	copë	40
8	Stola pritje tre vendëshe	copë	20
9	Kosha për mbetje urbane	copë	120
10	Perde	m ²	500



Ilustrimi nr.1 - Shtrat Pacienti / Dyshek

1. Shtrat Pacienti

Specifikime Teknike

Lëvizja e prapme dhe lëvizja e këmbëve të kontrollohen nga 2 manivelat në fund të këmbëve.

Kokën dhe tabelat e këmbëve të jenë bërë prej plastike PP

2 copa binarë anësor të shkrirë të jenë bërë prej alumini

4 copa hedhje sipërfaqe të jetë bërë nga ABS plastike

Shasia e metalit të jetë poliesteri e ngjyrosur elektrostatisht

Këmbët e kokës dhe këmbës së shtratit të jenë të shkëputshme.

Shasia e metalit të jetë poliesteri e ngjyrosur elektrostatisht dhe i mbuluar me ABS plastike.

Sistemi kryq i frenave: Të ketë levat frenuese në rrotat kryq të krevatit

Të ketë 4 vrima serumi IV në 4 qoshet e shtratit të pacientit dhe një pol të rregullueshme IV.

Të ketë 4 bumpers në 4 qoshet e shtratit të pacientit.

Lëvizja e pasme kontrollohet nga foleja e majtë, ose e djathtë, ose ekuivalent.

Lëvizja e këmbës kontrollohet nga fiksimi i duhur.

Këmbët e zbrërthyer mund të montohen lehtësisht.

2. DIMENSIONET:

Gjatësia e plotë: 210 - 220 cm

Gjerësia e plotë: 100 - 105 cm

Madhësia e dyshekut: 190 - 200 cm

Gjerësia e dyshekut: 80 - 90 cm

Kapaciteti Pesha: 220 - 250 kg

3. LEVIZJET KENDORE:

Lëvizja e pasme: 0 ° -70 °

Lëvizja këmbë: 0 ° -30 °

Vaskulare

Lëvizja e gjurit

4. DYSHEKU

Veshje e papërshkueshme nga uji dhe i zipuar,

CNC prerë,

I përshtatshëm për të gjitha lëvizjet

Shkumë densitet prej 28 kg / m³

5. SISTEMI I LEVIZJES DHE FRENIMIT

Ø125 mm, rotativ me kthesë 360 ° me mekanizëm kryq të frenimit.

Të jetë i pajisur me aksesori - Tryezë shtrati



Ilustrimi Nr.2 - Komodinë Pacienti

2. Komodinë Pacienti

Specifikime Teknike

Komodina të ketë sirtar, derë, tavolinë që zgjatet mbi krevat

Dimensionet rreth 40 x 65 x 67 cm


Struktura të jetë material druri

Pjesa e mësipërme të jetë material MDF, ose ekuivalent

Sirtar i rrëshqitshëm

Tavolinë të rrotullueshme, e zgjatshme me lartësi të rregullueshme në lartësinë afërsisht 85/105 cm.

Me katër rrota 2 prej të cilave me frena

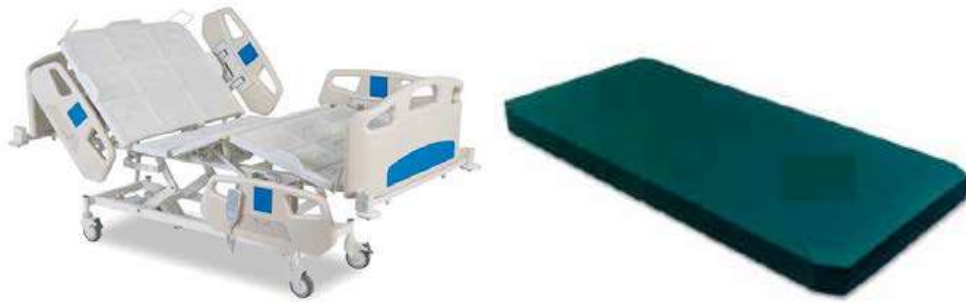

Ilustrimi Nr.3 - Shtrat Reanimacioni / Dyshek

3. Shtrat Reanimacioni **Specifikime Teknike**

Krevati duhet të sigurojë lëvizje të paktën në tre seksione të bazamentit të krevatit përkatësisht zonës së sipërme të krahavorit, pjesës së barkut dhe këmbëve, rregullim të lartësisë, pozicioneve vasculare të cilët kontrollohen nga minimumi 3 motorë

Pozicionet të kontrollohen nga panelet e kontrollit të vendosura në anët e jashtme dhe të brendshme të kufizueseve anësore

CPR elektrike dhe karakteristikat e mbylljes së funksionit në kontrollin e mjekut (në anën e jashtme të kufizueseve anësore)

Autoregression backrest (min 11 cm)

Kreu dhe fundi i këmbëve të krevatit të jenë prej polipropilenit (PP) i cmontueshëm (opcion me panele me ngjyra)

Binarët e ndarjes plastike PP me lëvizje të butë me treguesin e këndit

Minimumi 4 pjesë të pavarura dhe të ndashme ABS

Kornizë çeliku të veshur me pluhur elektrostatische antibakteriale ABS .

Me rrota me rrotullim 360 ° me sistemin e frenimit qendror dhe bllokimin e drejtimit

Adaptorë aksesorë në qoshe, mbajtëse serumi e rregullueshme me lartësi

Mbajtësit e qeseve të urinës dhe grepa rrip në të dyja anët

Aksesorë plastike mbrojtëse në qoshet

Opsionet alternative të ngjyrave për binarët anësorë

Dyshek me shkumë të dendur me mbulim antibakterial, të papërshkueshëm nga uji dhe me zippered



Ilustrimi Nr.4 - Shtrat Vizite

4. Shtrat Vizite **Specifikime Teknike**

Shtrat vizitash me përmasa gjatësi rreth 180-195 cm, gjerësi rreth 60 cm dhe lartësi rreth 70-76 cm (nga pjesa e dyshekut në pjesën e trupit deri në tokë).

Dysheku të jetë i ndarë në dy pjesë: pjesa e kokës e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe lehtësisht të pastrueshme me përmasa 50-55 cm dhe gjerësi rreth 60 cm me formë të harkuar në pjesën e kokës duke imituar jastëkun me lartësi max 12 cm.

Pjesa fikse e trupit dhe këmbëve me dimensione rreth 128cm dhe gjerësi rreth 60cm.

Kjo pjesë të jetë e veshur me të njëjtin material si pjesa e kokës me lartësinë 5-6 cm.

Skeleti i shtratit të vizitave të jetë formuar nga skeleti i sipërm me profil katror 40 x 40 mm dhe spesor 1.5 mm i lyer me bojë të bardhë elektrostatische dhe i pjekur në temperaturë 180 gradë. Skeleti i sipërm të ketë katër këmbëza me të njëjtin profil të lyera njësoj si skeleti i sipërm me gjatësi afërsisht 12 cm. Në katër këmbëzat duhet të futen këmbët e inoksit të shtratit të cilat të jenë prej profili katror 35 x 35 mm me spesor 1.35 mm. Pjesa e dukshme e këmbës së inoksit të ketë gjatësinë 54 cm. Në pjesën e poshtme të cdo këmbë të ketë mbështetëse plastike e cila bën kontaktin me tokën. Në pjesën e kokës ose në pjesën e këmbëve të pacientit të vendoset një tub inoksi fi afërsisht 25 mm dhe spesor afërsisht 1,35 mm i cili shërben për mbajtjen e letrës rulo universale. Mekanizmi ngritës i pjesës së sipërme (kokës) së dyshekut të jetë në përputhje me dimensionet e shtratit.



Ilustrimi Nr. 5 - Tavolinë pune me komodinë

5. Tavolina Pune me Komodinë

Specifikime Teknike

Tavolina

Tavolinë pune me përmasat rreth: 140 x 80 x 72 cm dhe komodinë Syprina melaminë me trashësi minimumi 2.5 cm.

Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave.

Këmbët duhet të jenë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës.

Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC.

Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide.

Pjesa ballore duhet të jetë e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë

Në pjesën e brendshme në njërin krah duhet të ndohet posti i tastierës e fiksuar me shina rrëshqitëse, në krahun tjetër ndodhen dy sirtare me gjerësi 45 cm ku sirtari i parë të jetë i mbyllur me çelës.

Montimi i tastierës duhet të jetë i thjeshtë dhe me mundësi zgjedhje të krahut të punës.

Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësore.

Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas.

Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.

Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë.

Të gjitha pjesët e tavolinës me të cilën përdoruesi vjen në kontakt gjatë përdorimit, duhet të jenë të dizajnuara në mënyrë që të shmangen lëndimet fizike dhe dëmtimet.

Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Sirtarieria / Komodina

Përmasat rreth: 45 x 53 x 60 cm (lartësi së bashku me rrotat)

Struktura e sirtarierës do jetë melaminë me trashësi 1.6 - 1.8 cm.

Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave.

Syprina dhe kapakët ballore të sirtareve duhet të jenë prej materiali melamine me spesor.

Bordet anësore, fiankeve të jenë të rrethuara me material plastik PVC.

Sirtariera duhet të ketë 4 rrota sferike në fund dhe të mund të lëvizë nën tavolinë.

Sirtari i parë nga lart duhet të jetë më i vogël dhe i përshtatur për të mbajtur sende të imëta, pjesa tjetër të ndahet në 3 sirtarë të barabartë.

Sirtarët duhet të jenë të paisur me kyç që të realizojë mbyllje qendrore.

Aksesorët e përdorur duhet të jenë cilësorë, në mënyrë që të sigurojnë një qëndrueshmëri të lartë të sirtarierës.

Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.



Ilustrimi Nr.6 - Karrike kë thjeshta

6. Karrike të thjeshta

Specifikime Teknike

Karrige zyre të thjeshta, komferte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme.

Pesha e përafërt 7 kg

Lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm

lartësia e ndenjësës jo më e vogël se 45cm,

Thellësia rreth 43cm

Gjerësia rreth 53cm

Konstruksioni metalik të sigurojë qëndrueshmëri



Ilustrimi Nr.7 - Dollap Pacienti

7. Dollap Pacienti

Specifikime Teknike

Struktura të jetë material druri

Dimensionet : 90 x 40 x 185 cm

Me 2 ndarje të pavarura
Me dy dyer



Ilustrimi Nr.8 - Stola pritjeje tre vendëshe

8. Stola Pritje tre Vendëshe **Specifikime Teknike**

Set Karrige Vizitorësh

Të përbëra nga 3 (tre) karrige të lidhura bashkë, me material inoks/kromuar dhe me ndenjësë inoks/kromuar të lyera metalizato, me mbajtëse anësore.



Ilustrimi Nr.9 - Kosha për mbetje urbane

9. Kosha për Mbetje Urbane **Specifikime Teknike**

Kosh inoksi me volum mbi 8 L



Ilustrimi nr.10 - Perde

10. Perde **Specifikime Teknike**

Perde-Roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare Copa të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.